



PHC735

PHC735

مقدمة

المحس عبارة عن قطب كهربائي لأس الهيدروجيني، إلكترونات قابل لإعادة الماء وجسم زجاجي ومتضمن بـ درجة حرارة مدمج، يحتوي المحس على وصلة دائنة حلقية عالية التدفق تقيس الأس الهيدروجيني في مياه الصرف أو التطبيقات "القدرة".

تحذير

خطر التعرض الكيميائي. التزم بإجراءات الأمان

المعملية وارتد جميع معدات الحماية الشخصية المناسبة للمواد الكيميائية التي يتم التعامل معها. اطلع على صحف بيانات سلامة المواد (MSDS/SDS) (الحالية للتعرف على بروتوكولات السلامة).

دليل المستخدم

دليل المستخدم مع جميع التعليمات موجود على موقع الشركة المصنة.

العناصر الازمة:

مقياس متافق؛ محايل معيارية الأس الهيدروجيني؛ دوارق، مياه DI، قطعة قماش خالية من الوبير، محلول ماء

1 توصيل المحس

2 المعايرة


يمكن أن تسبب فقاعات الهواء تحت طرف المحس عند غمرها استقراراً بطيئاً أو خطأ في الفناس، في حالة وجود فقاعات، قم بغير المحس برفق حتى تتم إزالة الفقاعات.

3 الفناس

4 التخزين

المعلومات الفنية

نطاق الأس الهيدروجيني	0 إلى 14
الميل	-59 مللي فولت/الأس الهيدروجيني (85 إلى 115 درجة فهرنهايت)
درجة الحرارة	من 10 إلى 100 درجة مئوية (من 14 إلى 212 درجة فهرنهايت)
أدنى عمق للينة	14 مم (0.55 بوصة)
محلول الماء	KCl مثبت
محلول التخزين	KCl مثبت

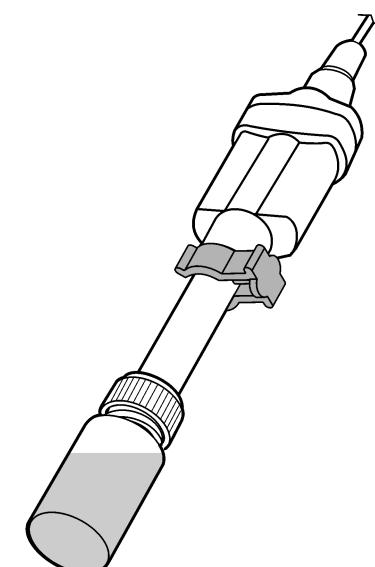

الصيانة والتخزين للحصول على تفاصيل الصيانة والتخزين، راجع النسخة الموسعة من هذا الدليل على موقع الشركة المصنة على الويب.

الضمان

سنة واحدة ضد عيوب التصنيع. لا يغطي هذا الضمان سوء الاستخدام أو البلى.

TH

AR

PHC735

はじめに

このプローブは、再充填可能な電解質、ガラス製本体を備え、温度センサーを内蔵しているpH電極です。このプローブは、廃水や「汚染」アプリケーションのpHを測定できるハイフロー型アニラーリングジャンクションを備えています。

警告

危険物による人体被害の危険。検査室の安全手順に従い、取り扱う薬品に適した個人用保護具をすべて装着してください。安全手順に関する現在の安全性データシート(MSDS/SDS)を参照してください。

使用者マニュアル

すべての手順を記載した取扱説明書はウェブサイトにあります。

用意するもの:

互換性のある測定器、pH標準液、ビーカー、DI水(純粋)、糸くずの出ない布、補充液

1 プローブの接続

2 校正

プローブを浸した際に先端に生じる気泡によって、測定が安定するまでに時間がかかる場合、測定エラーが発生する場合があります。気泡が生じた場合は、気泡がなくなるまでプローブをそっと振ってください。

3 測定

4 保管

技術情報

pH 范围	pH 0 至 14
斜率	-59 mV/pH (25 °C 时 85% 至 115%)
温度	-10 至 100 °C (14 - 212 °F)
最小試样深度	14 mm (0.55 in.)
充填溶液	饱和 KCl
存放溶液	饱和 KCl

維护和存放

有关维护和存放的详细信息，请访问制造商网站，参见本手册的扩展版本。

保修

1 年制造故障保修。本保修不涵盖非正常使用或磨损。

メンテナンスおよび保管

メンテナンスおよび保管の詳細については、メーカーの Web サイトでこのマニュアルの拡張版を参照してください。

保証

製造上の不備については、1 年間の保証が付帯されます。この保証は、誤った使用法により生じた結果や損耗には適用されません。

유지 관리 및 보관

유지 관리 및 보관에 대한 자세한 정보는 제조업체의 웹 사이트에서 이 설명서의 확장된 버전을 참조하십시오.

보증

제조상의 결함에는 1년 보증이 지원됩니다. 이 보증은 사용상의 결함이나 마모에는 적용되지 않습니다.

JA

PHC735

소개

프로브는 리필 가능한 전해질, 유리 본체 및 통합 온도 센서로 구성된 pH 전극입니다. 프로브는 고유수 고리 형태의 정션으로 폐수 및 더러운 용수의 pH를 측정합니다.

경고

화학물질에 노출될 위험이 있습니다. 실험실의 안전절차를 준수하고, 취급하는 화학물질에 맞는 개인보호장비를 안전하게 착용하십시오. 최신 물질안전보건자료(MSDS/SDS)에서 안전 규정을 참조하십시오.

사용자 매뉴얼

모든 지침이 포함된 사용자 매뉴얼은 제조업체의 웹사이트에 있습니다.

준비 항목:

호환 미터: pH 표준 용액, 비커, 초순수, 보풀이 없는 천, 보충 용액

1 프로브 연결

2 校正

프로브를 담갔을 때 프로브 뒷 아래에 기포가 있으면 안정화 속도가 느려지거나 측정 오류가 발생할 수 있습니다. 기포가 있는 경우 프로브를 가볍게 흔들어 기포를 제거하십시오.

3 측정

4 보관

기술 정보

pH 범위	pH 0~14
기울기	-59 mV/pH(25°C에서 85~115%)
온도	-10~100 °C(14~212 °F)
최소 샘플 심도	14 mm (0.55 in.)
보충 용액	포화 KCl
저장 용액	포화 KCl

유지 관리 및 보관

유지 관리 및 보관에 대한 자세한 정보는 제조업체의 웹 사이트에서 이 설명서의 확장된 버전을 참조하십시오.

보증

제조상의 결함에는 1년 보증이 지원됩니다. 이 보증은 사용상의 결함이나 마모에는 적용되지 않습니다.

KO

PHC735

はじめに

トイロブニイネンテッタノトコト。pH 価格のためのアセキド、ガラス本体を備え、温度センサーを内蔵しているpH電極です。このプローブは、廃水や「汚染」アプリケーションのpHを測定できるハイフロー型アニラーリングジャンクションを備えています。

警告

化学物質による人体被害の危険。検査室の安全手順に従い、取り扱う薬品に適した個人用保護具をすべて装着してください。安全手順に関する現在の安全性データシート(MSDS/SDS)を参照してください。

사용자 매뉴얼

모든 지침이 포함된 사용자 매뉴얼은 제조업체의 웹사이트에 있습니다.

준비 항목:

호환 미터: pH 표준 용액, 비커, 초순수, 보풀이 없는 천, 보충 용액

1トイロブ 연결

2 校正

フローブを浸した際に先端に生じる気泡によって、測定が安定するまでに時間がかかる場合、測定エラーが発生する場合があります。気泡が生じた場合は、気泡がなくなるまでプローブをそっと振ってください。

3 측정

4 보관

기술 정보

pH 범위	pH 0~14
기울기	-59 mV/pH(25°C에서 85~115%)
온도	-10~100 °C(14~212 °F)
최소 샘플 심도	14 mm (0.55 in.)
보충 용액	포화 KCl
저장 용액	포화 KCl

유지 관리 및 보관

유지 관리 및 보관에 대한 자세한 정보는 제조업체의 웹사이트에서 이 설명서의 확장된 버전을 참조하십시오.

보증

제조상의 결함에는 1년 보증이 지원됩니다. 이 보증은 사용상의 결함이나 마모에는 적용되지 않습니다.

PT-BR

PHC735

介绍

此取样针是一种带有可再充填电解液和集成温度传感器的 pH 电极，取样针的主体采用玻璃材质。此取样针具有高流速环孔接头，可用于测定废水或“污水”中的 pH 值。

Perigo de exposição a produtos químicos. Obedeça aos procedimentos de segurança laboratoriais e use todos os equipamentos de proteção individual adequados aos produtos químicos que estão sendo manipulados. Consulte as planilhas de dados de segurança (MSDS/SDS) atuais para verificar os protocolos de segurança.

Manual do usuário

Um manual do usuário com todas as instruções está no site do fabricante.

Ferramentas necessárias:

Medidor compatível; soluções pH padrão, bêqueres, água desionizada, pano sem fiapos, solução de preenchimento

1 Conectar a sonda

2 Calibração

As bolhas de ar na ponta da sonda quando submersa podem causar baixa estabilização ou erros na medição. Se houver bolhas, agite cuidadosamente a sonda até removê-las.

3 Medição

4 Armazenamento

Informações técnicas

Faixa de pH	pH 0 a 14
Inclinação	-59 mV/pH (85 a 115% a 25 °C)
Temperatura	-10 a 100 °C (14 a 212 °F)
Mínima profundidade da amostra	14 mm (0.55 pol.)
Solução de preenchimento	KCl saturado
Solução de armazenamento	KCl saturado

Manutenção e armazenamento

Para informações sobre manutenção e armazenamento, consulte a versão expandida deste manual no site do fabricante.

Garantia

1 ano para defeitos de fabricação. Esta garantia não cobre desgaste ou uso indevido.




TH

AR

PHC735

مقدمة

المحس عبارة عن قطب كهربائي لأس الهيدروجيني به إلكترونات قابل لإعادة الماء وجسم زجاجي ومتضمن بـ درجة حرارة مدمج. يحتوي المحس على وصلة دائنة حلقية عالية التدفق تقيس الأس الهيدروجيني في مياه الصرف

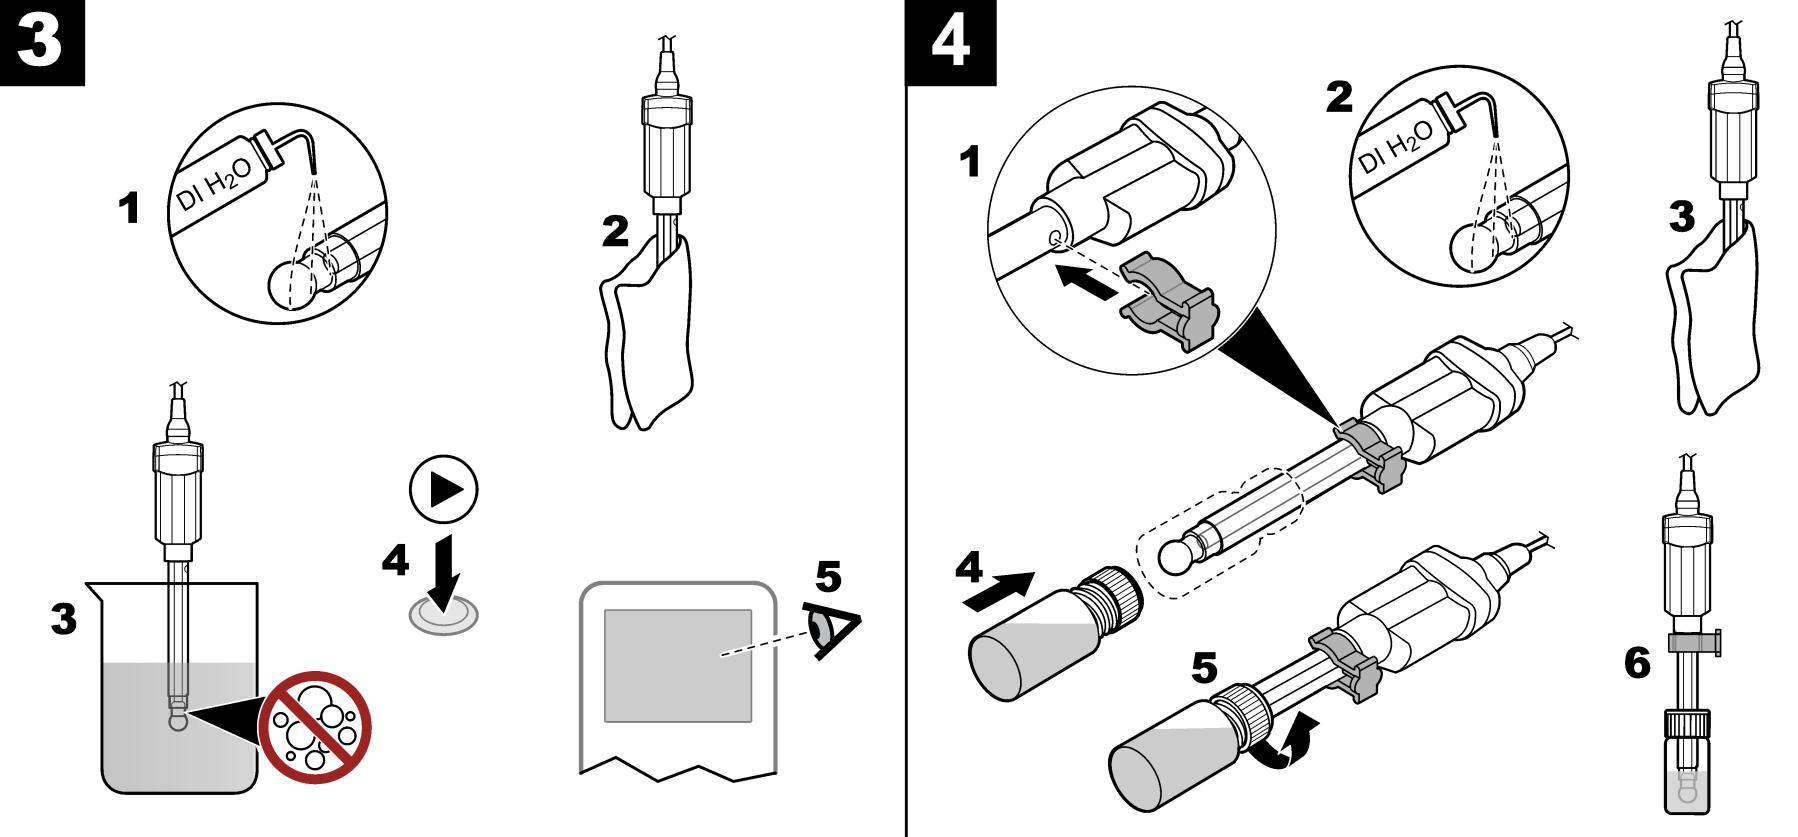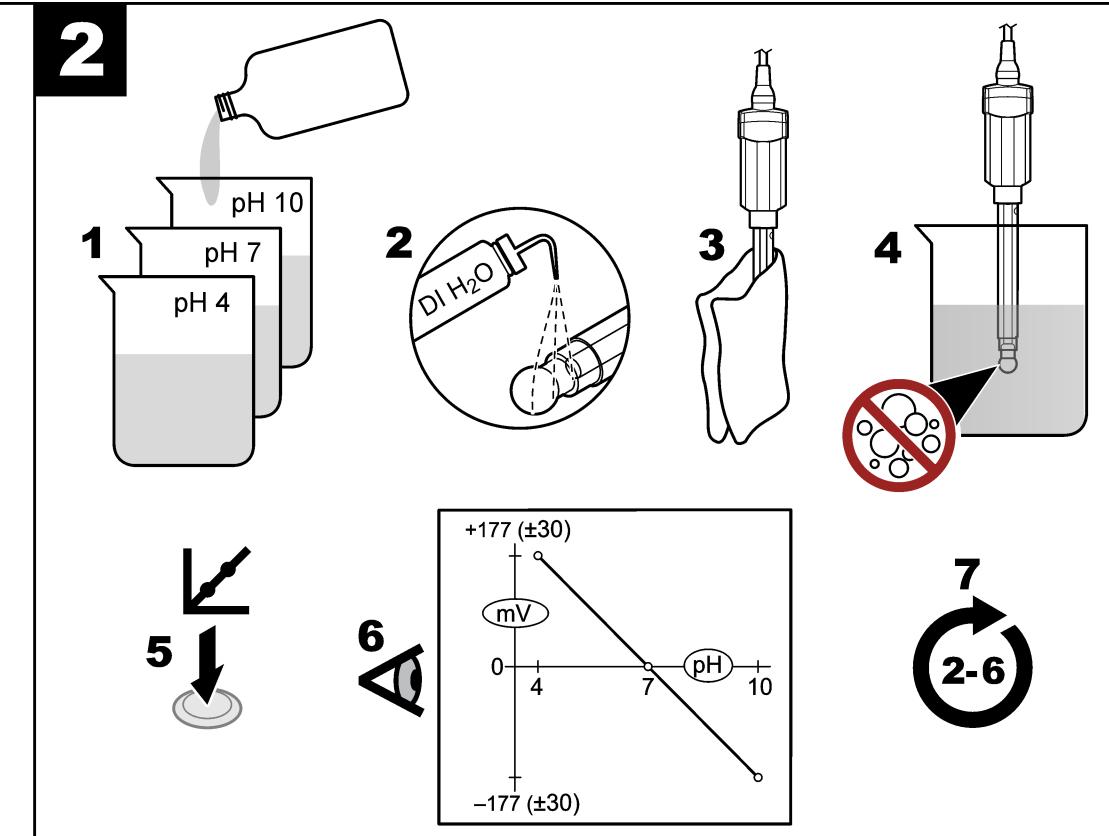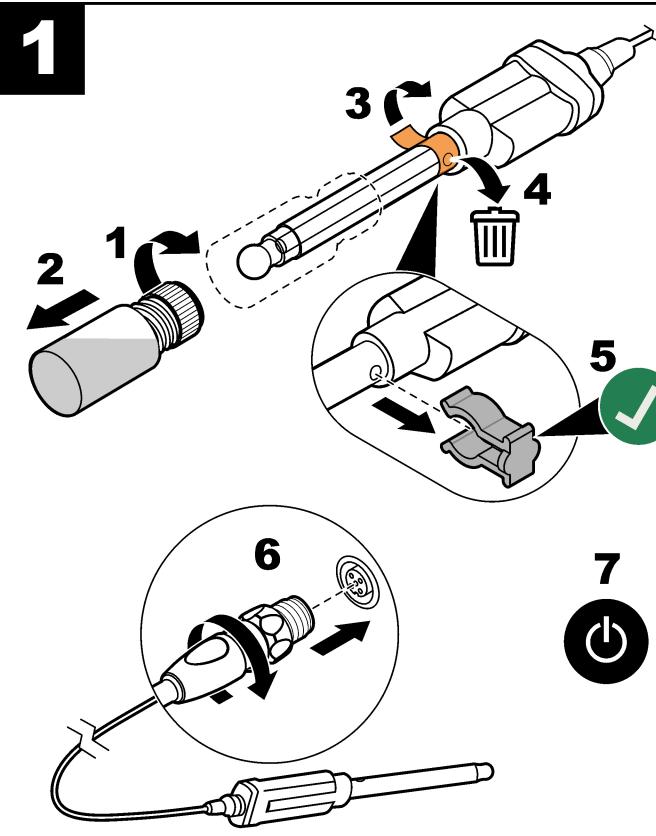

PHC735
Introduction
The probe is a pH electrode with refillable electrolyte, a glass body and an integrated temperature sensor. The probe has a high-flow annular ring junction that measures pH in wastewater or "dirty" applications.

Warning
⚠ Chemical exposure hazard. Obey laboratory safety procedures and wear all of the personal protective equipment appropriate to the chemicals that are handled. Refer to the current safety data sheets (MSDS/SDS) for safety protocols.

User manual
A user manual with all instructions is on the manufacturer's website.

Items to collect:

Compatible meter, pH standard solutions, beakers, DI water, no-lint cloth, filling solution

1 Connect the probe

2 Calibration

Air bubbles under the probe tip when submerged can cause slow stabilization or error in measurement. If bubbles are present, gently shake the probe until bubbles are removed.

3 Measurement

4 Storage

Technical information

pH range	pH 0 to 14
Slope	-59 mV/pH (85 to 115% at 25 °C)
Temperature	-10 to 100 °C (14 to 212 °F)
Minimum sample depth	14 mm (0.55 in.)
Filling solution	Saturated KCl
Storage solution	Saturated KCl

Maintenance and storage

For maintenance and storage details, refer to the expanded version of this manual on the manufacturer's website.

Warranty

1 year for manufacturing faults. This warranty does not cover improper use or wear.

PHC735
Introduction
La sonde est une électrode de pH avec électrolyte rechargeable, corps en verre et capteur de température intégré. La sonde dispose d'une jonction à anneau annulaire haut débit mesurant le pH dans les eaux usées ou les applications « souillées ».

Avertissement

⚠ Risque d'exposition chimique. Respectez les procédures de sécurité du laboratoire et portez tous les équipements de protection individuelle adaptés aux produits chimiques que vous manipulez. Consultez les fiches de données de sécurité (MSDS/SDS) à jour pour connaître les protocoles de sécurité applicables.

Manuel d'utilisation

Un manuel d'utilisation contenant toutes les instructions se trouve sur le site du fabricant.

Eléments à réunir :

Instrument de mesure compatible ; solutions étalons de pH, bêchers, eau déionisée, chiffon non pelucheux, solution de remplissage

1 Branchement de la sonde

2 Etalonnage

Lorsque la sonde est immergée, la présence de bulles d'air sous sa pointe peut ralentir la stabilisation ou entraîner une erreur de mesure. Si des bulles sont présentes, agitez doucement la sonde jusqu'à ce qu'elles disparaissent.

3 Mesure

4 Stockage

Données techniques

Plage de pH	pH 0 à 14
Pente	-59 mV/pH (de 85 à 115 % à 25 °C)
Température	-10 à 100 °C (14 à 212 °F)
Profondeur minimale d'immersion	14 mm (0,55 po)
Solution de remplissage	KCl saturée
Solution de stockage	KCl saturée

Maintenance et stockage

Pour plus d'informations concernant la maintenance et le stockage, veuillez vous reporter à la version longue de ce manuel, disponible sur le site Internet du fabricant.

Garantie

Garantie d'un an pour les défauts de fabrication. La garantie ne couvre ni les dégâts causés par une mauvaise utilisation ni l'usure.

FR

PHC735
Introducción
La sonda consta de un electrodo de pH con electrolito rellenable, un cuerpo de vidrio y un sensor de temperatura integrado. La sonda dispone de una unión anular de gran flujo que mide el pH en aguas residuales o en aplicaciones "sucias".

Advertencia

⚠ Peligro por exposición química. Respete los procedimientos de seguridad del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

Manual de usuario

En el sitio web del fabricante podrá encontrar el manual del usuario que contiene todas las instrucciones.

Recopilación de elementos:

Medidor compatible, soluciones patrón de pH; básculas, agua desionizada; paño que no suelta pelusa; solución de llenado

1 Conexión de la sonda

2 Calibración

Si se producen burbujas de aire bajo la punta de la sonda cuando ésta se sumerja, se puede provocar una estabilización lenta o errores de medición. En caso de que se produzcan burbujas, agite suavemente la sonda hasta que éstas desaparezcan.

3 Medición

4 Almacenamiento

Información técnica

Rango de pH	pH de 0 a 14
Pendiente	-59 mV/pH (de 85 a 115 % a 25 °C)
Temperatura	-10 a 100 °C (14 a 212 °F)
Profundidad mínima de muestra	14 mm (0,55 pulg.)
Solución de llenado	KCl saturado
Solución de almacenamiento	KCl saturado

Mantenimiento y almacenamiento

Si desea obtener información detallada acerca del mantenimiento y almacenamiento, consulte la versión ampliada de este manual en el sitio web del fabricante.

Garantía

1 año

por defectos de fabricación. Esta garantía no cubre los problemas ocasionados por un uso inadecuado o por el desgaste del instrumento.

ES