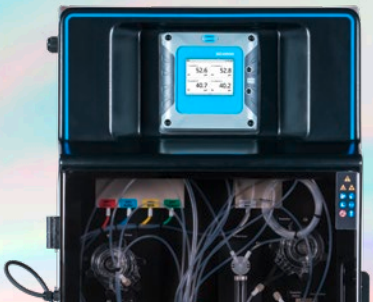

Máxima percepção com o mínimo de esforço

Eleve sua análise com a série EZ sc atualizada

Comparação:

EZ sc vs. EZ

NOVO





Recurso	EZ sc	EZ
Operação simplificada para maior eficiência O design familiar da interface se alinha com o SC4500, reduzindo a curva de aprendizado e integrando-se aos fluxos de trabalho existentes.	✓	✗
Processos operacionais amigáveis Fluxos de trabalho guiados reduzem a dependência de manuais, permitindo a execução mais rápida de tarefas e o acesso personalizado do usuário para uma operação segura e precisa.	✓	✗
Adaptável a necessidades futuras Adaptável a faixas de amostras variadas para atender aos requisitos específicos do cliente e oferecer a capacidade de modificar as faixas conforme necessário.	✓	✗
Manutenção preditiva para maior tempo de atividade Indicadores integrados, semelhantes aos contadores de reagentes, para notificá-lo quando a tubulação, os consumíveis, as peças de reposição ou outros componentes precisarem ser substituídos. O analisador possui um alarme para lembrá-lo quando for necessário agir.	✓	✗
Análise de precisão por meio de sistemas avançados Os sistemas de fornecimento de reagentes de alta qualidade garantem um fluxo de amostra consistente, proporcionando resultados de alta precisão.	✓	✓
Serviço protegido Um portfólio completo de planos de serviço para ajudá-lo a proteger seu investimento e sua tranquilidade.	✓	✓

NOVO





	EZ sc	EZ
Especificações técnicas		
Processo de diluição	Dispensador padrão (todas as unidades)	Microbomba
Dimensões (A x L x P)	691 mm x 461 mm x 311 mm (27,2 pol. x 18,15 pol. x 12,24 pol.)	691 mm x 465 mm x 330 mm (27,2 pol. x 18,31 pol. x 12,99 pol.)
Bomba para módulo de filtragem	Não (bomba integrada no painel de filtragem)	Sim
Saída de comunicação analógica	Padrão 4x 4-20 mA, Saída opcional de 8 x mA	1,2,4,8 x 4-20 mA
Saída de comunicação digital	Modbus (TCP/IP, RTU), PROFITNET, PROFIBUS DP, ETHERNET IP	Modbus (TCP/IP, RS485)
Número de fluxos de amostra	Padrão 1, acessório para 2,4,8	1,2,4,8, em configuração
Substituição de reagentes		
Cronograma de substituição de reagentes	28 dias*	28 dias*
Cronograma de manutenção		
Limpe os componentes do analisador	7 dias após a instalação e depois em intervalos de 30 dias	
Substitua a tubulação	Intervalos de 90 dias	
Substitua o tubo rígido	Conforme necessário	
Substituir os bicos de pato da microbomba	Anualmente	
Substitua os fusíveis	Conforme necessário	
Substitua a válvula do dispensador e a seringa	Anualmente	

*Salvo indicação em contrário

World Headquarters: Loveland, Colorado USA | hach.com

United States **800-227-4224** fax: 970-669-2932 email: orders@hach.com
Outside United States **970-669-3050** fax: 970-461-3939 email: intl@hach.com

©Hach Company, 2025. All rights reserved. In the interest of improving and updating its equipment, Hach Company reserves the right to alter specifications to equipment at any time.

DOC063.90.30859.Jul25