
Certificado de análise
Dados técnicos para validação de cloro livre com reagente em pó (0.02 – 2.00 mg/L)

Este Certificado de Análise segue os procedimentos do método USEPA Hach 8000 e ISO 8466.

Número de Catálogo	2105569
Data do certificado	19 de agosto de 2015
Número do lotes	50

Sensibilidade (0.010 mudança na absorbância)	0.02 mg/L Cl_2
Reagente Branco	0.01 mg/L Cl_2
Acuracidade	1.5 %
Intervalo de confiança (95%)	0.3 %
Desvio-padrão do método	0.03 mg/L Cl_2
Coeficiente de Variação do método	1.5 %
Limite de detecção do método	0.02 mg/L Cl_2
Limite de Quantificação	0.05 mg/L Cl_2

Valor Nominal mg/L Cl_2	**Valor Média Obtido mg/L Cl_2**
2.00	1.97

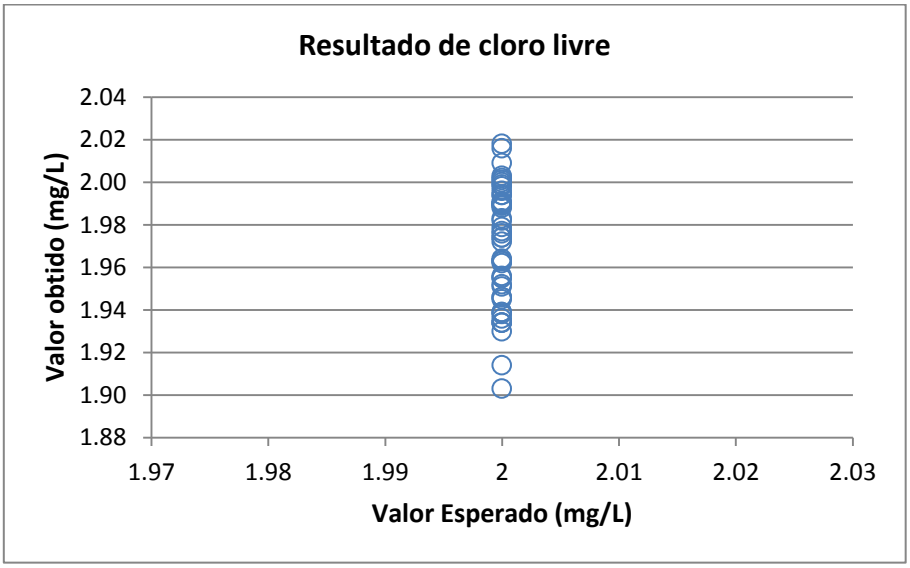

HACH®
Be Right™

Scott Als, Controle Químico Qualidade

Scott Als