



DOC022.61.90323

DR 3900

MANUAL DEL USUARIO

02/2025 Edición 13

Índice de contenidos

Sección 1 Especificaciones	9
Sección 2 Información general	11
2.1 Información de seguridad	11
2.1.1 Etiquetas de precaución	11
2.1.2 Módulo RFID (no disponible en todos los modelos)	12
2.1.3 Seguridad química y biológica	12
2.2 Información general del producto	13
Sección 3 Instalación	15
3.1 Desembalaje del instrumento	15
3.2 Entorno operativo	15
3.3 Vista frontal y trasera	16
3.4 Conexiones eléctricas	17
3.5 Interfaces	18
3.6 Compartimento de cubetas, adaptadores de cubetas y protector de luz	18
3.6.1 Compartimentos y adaptadores de cubetas	18
3.6.2 Instalación del adaptador de cubetas	20
3.6.3 Uso del protector de luz para las mediciones	20
3.7 Trayectoria del haz	22
Sección 4 Inicio	23
4.1 Encendido del instrumento, proceso de arranque	23
4.2 Selección del idioma	23
4.3 Autocomprobación	23
4.4 Modo de hibernación	24
4.5 Apagado del instrumento	24
Sección 5 Programas estándar	25
5.1 Información general	25
5.1.1 Consejos de uso de la pantalla táctil	25
5.1.2 Uso del teclado alfanumérico	25
5.1.3 Menú Principal	26

Índice de contenidos

5.2 Configuración del instrumento.....	27
5.2.1 ID del usuario	27
5.2.1.1 Pestaña RFID del usuario (no disponible en todos los modelos).....	28
5.2.2 ID de la muestra	29
5.2.2.1 ID de muestra con método de escáner 1	30
5.2.2.2 ID de muestra con método de escáner 2	31
5.2.3 ID de muestra e ID de usuario con el kit de ID de muestras RFID opcional (no disponible en todos los modelos).....	31
5.2.4 Configuración de seguridad	31
5.2.4.1 Asignación de un nivel de seguridad de usuario.....	33
5.2.4.2 Desactivación de contraseña	35
5.2.5 Fecha y hora	35
5.2.6 Ajustes de sonido	36
5.2.7 PC e impresora	37
5.2.7.1 Configuración de la impresora.....	38
5.2.7.2 Impresión de datos	39
5.2.7.3 Impresión de datos de manera continua	39
5.2.7.4 Configuración de red	40
5.2.8 Gestión de energía	43
5.3 Almacenamiento, recuperación, envío y borrado de datos	43
5.3.1 Registro de datos	43
5.3.1.1 Almacenamiento de datos automático y manual.....	44
5.3.1.2 Recuperación de datos almacenados de un registro de datos	44
5.3.1.3 Envío de datos del registro de datos	45
5.3.1.4 Eliminación de datos almacenados de un registro de datos	47
5.3.2 Gráficos de control para datos del registro ACA	47
5.3.3 Almacenamiento, recuperación, envío y eliminación de datos de barrido de longitud de onda y cinéticas en el tiempo	49
5.3.3.1 Almacenamiento de datos de barrido de longitud de onda o cinéticas en el tiempo	49
5.3.3.2 Recuperación de datos almacenados del barrido de longitud de onda y cinéticas en el tiempo	49
5.3.3.3 Envío de datos de barrido de longitud de onda o cinéticas en el tiempo	50
5.3.3.4 Eliminación de datos almacenados del barrido de longitud de onda y cinéticas en el tiempo	51
5.3.4 Análisis de datos	51
5.3.4.1 Tendencias	52
5.3.4.2 Ratios	54
5.3.4.3 Chequeo de interferencias (no disponible en todos los modelos).....	57

5.4 Programas almacenados	57
5.4.1 Selección de un método o test almacenado; introducción de datos básicos específicos del usuario	58
5.4.2 Opciones de programas almacenados	58
5.4.3 Uso de los temporizadores de programa	60
5.4.4 Ajuste del factor de dilución	60
5.4.5 Ejecución de un ajuste del patrón	61
5.4.6 Ajuste de la fórmula química	61
5.4.6.1 Cambio de la configuración predeterminada de la fórmula química	62
5.4.7 Ejecución de un blanco de reactivo	62
5.4.8 Para realizar una determinación múltiple	63
5.4.9 Análisis de muestras	63
5.4.10 Actualización/edición de test (no disponible en todos los modelos)	64
5.4.10.1 Consejos generales para actualizaciones y ediciones de programas	64
5.4.10.2 Actualización manual de datos de test	64
5.4.10.3 Programación de un nuevo test	65
5.4.11 Adición de programas almacenados a la lista Programas Favoritos	65
5.5 Programas de códigos de barras	66
5.5.1 Realizar una prueba del código de barras	66
5.5.2 Selección de la fórmula de evaluación química	67
5.5.2.1 Cambio de la configuración predeterminada de la fórmula química	67
5.5.3 Ajustes de datos específicos de la muestra y del test	67
5.5.4 Blanco de la muestra	69
5.5.5 Actualización y edición de tests de código de barras	69
5.5.5.1 Actualización de test de códigos de barras con el embalaje del test (no disponible en todos los modelos)	69
5.5.5.2 Actualización manual de un test de código de barras	70
5.5.5.3 Comprobación/revisión manual de los datos de un test	72
5.5.5.4 Actualización a través de Internet	73
5.5.5.5 Programación de un nuevo test	73

Índice de contenidos

Sección 6 Programas avanzados	75
6.1 Programas del usuario	75
6.1.1 Programación de un método de usuario	76
6.1.1.1 Configuración de Longitud de onda única	77
6.1.1.2 Configuración de Longitud de onda múltiple	78
6.1.1.3 Configuración de la calibración para modos de longitud de onda única y múltiple	80
6.1.1.4 Almacenamiento de un programa del usuario	83
6.1.1.5 Parámetros y funciones adicionales definidos por el usuario	83
6.1.2 Tipo de programa "Programación libre"	85
6.1.2.1 Proceso de medida	86
6.1.2.2 Introducción de un nuevo elemento de una secuencia de medición	86
6.1.2.3 Introducción de la fórmula de calibración (fórmula de evaluación)	89
6.1.2.4 Introducción de variables	92
6.1.2.5 Memorización de un programa del usuario de programación libre	92
6.1.3 Selección de un programa del usuario	92
6.1.4 Adición, edición y borrado de programas del usuario de la lista de favoritos	93
6.1.4.1 Agregar a Favoritos	93
6.1.4.2 Edición	93
6.1.4.3 Borrar un programa	94
6.2 Favoritos	94
6.2.1 Recuperación de un programa favorito	94
6.2.2 Borrado de un programa favorito	94
6.3 Adición de patrón: supervisión y comprobación de resultados	95
6.3.1 Realización de una adición de patrón	97
6.4 Longitud de onda única (medidas de absorbancia, concentración y transmitancia)	99
6.4.1 Configuración del modo Longitud de onda única	100
6.4.2 Toma de mediciones de longitud de onda única (medición puntual)	101
6.5 Modo Long. de onda múltiple: mediciones con más de una longitud de onda	101
6.5.1 Ajuste del modo de medición a distintas longitudes de onda	102
6.5.2 Realización de una medición en modo Long. de onda múltiple	104
6.6 Modo Barrido de longitud de onda: registro de espectros de absorbancia y transmisión	104
6.6.1 Configuración del barrido de longitud de onda	105
6.6.2 Realizar un barrido de longitud de onda	108
6.6.2.1 Exploración del gráfico del barrido de longitud de onda o un análisis de barrido de longitud de onda	108
6.6.3 Trabajo con barridos de referencia	109
6.7 Cinéticas en el tiempo de absorbancia/transmitancia	110
6.7.1 Parámetros de configuración de Cinéticas en el tiempo	110
6.7.2 Medición de cinética en el tiempo	112
6.7.3 Análisis de los datos de de cinética en el tiempo	112
6.7.3.1 Exploración de un escaneado de tiempo o un análisis de escaneado de tiempo	113

6.8 Pruebas del sistema	113
6.8.1 Información del instrumento.....	114
6.8.2 Actualización del software del instrumento.....	114
6.8.3 Pruebas ópticas	115
6.8.3.1 Kit de verificación.....	115
6.8.3.2 Test de soluciones	116
6.8.3.3 Comprobación de longitud de onda	118
6.8.3.4 Comprobación de la luz difusa.....	118
6.8.3.5 Comprobación de la absorbancia	119
6.8.4 ACA: Aseguramiento Calidad Analítica	120
6.8.4.1 Configuración del estándar ACA.....	121
6.8.4.2 Adición ACA.....	122
6.8.4.3 Determinación múltiple	123
6.8.4.4 Dilución	124
6.8.4.5 Realización de una medida ACA	124
6.8.4.6 Set de chequeo de pipetas	124
6.8.5 Backup de instrumento	124
6.8.6 Menú Servicio	126
6.8.7 Tiempos de servicio	126
6.8.8 Tiempo de funcionamiento de las lámparas	126
6.9 Barra de herramientas	127
6.9.1 Inicio de sesión	127
6.9.2 ID de la muestra.....	127
6.9.3 Temporizador.....	128
6.9.4 ACA.....	128
6.9.5 Tendencias	128
6.9.6 Link2SC	128
6.9.7 Sitio web de DR3900	129
Sección 7 Mantenimiento.....	131
7.1 Requisitos de limpieza.....	131
7.1.1 Espectrofotómetro.....	131
7.1.2 Pantalla	131
7.1.3 Cubetas.....	132
7.2 Sustitución de la lámpara	132
7.3 Cambio del compartimento de cubetas reemplazable.....	134
Sección 8 Solución de problemas	137
Sección 9 Piezas de repuesto	141
9.1 Accesorios	141
9.2 Piezas de repuesto	142
Sección 10 Garantía, responsabilidad y reclamaciones	143
Apéndice A Guía de ayuda	145
A.1 Visualización de la Guía de ayuda de los programas almacenados	145

Índice de contenidos

A.2 Visualización de la Guía de ayuda de los programas de códigos de barras	146
Índice	149

Sección 1 Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de funcionamiento	
Modo de pantalla	Transmitancia (%), absorbancia y concentración
Fuente de luz	Lámpara halógena
Rango de longitud de onda	320–1100 nm
Exactitud de longitud de onda	± 1.5nm (rango de longitud de onda 340–900nm)
Reproducibilidad de longitud de onda	± 0,1nm
Resolución de longitud de onda	1 nm
Calibración de longitud de onda	Automática
Selección de longitud de onda	Automática, mediante selección de un método
Velocidad de barrido	≥ 8nm/s (en fases de 1nm)
Ancho de banda espectral	5 nm
Rango de medida fotométrico	± 3,0 Abs (rango de longitud de onda de 340 a 900 nm)
Exactitud fotométrica	5 m de abs a 0,0-0,5 Abs 1 % a 0,50-2,0 Ext
Linealidad fotométrica	< 0.5% a 2 Abs ≤1 % a 2 Abs con vidrio neutro a 546 nm
Luz difusa	< 0.1%T a 340 nm con NaNO ₂
Registro de datos	2000 mediciones (resultado, fecha, hora, ID de muestra, ID del usuario)
Programas del usuario	100
Especificaciones físicas y ambientales	
Anchura	350 mm (13,78 pulg.)
Altura	151 mm (5,94 pulg.)
Profundidad	255 mm (10,04 pulg.)
Masa	4200 g (9,26 libras)
Requisitos medioambientales de funcionamiento	10–40 °C (50–104 °F), humedad relativa máxima 80 % (sin formación de condensación)
Requisitos ambientales de almacenamiento	–40–60 °C (–40–140 °F), humedad relativa máxima 80 % (sin formación de condensación)
Datos técnicos adicionales	
Conector de alimentación por medio de fuente de alimentación externa	Entrada: 100–240 V ± 10 VAC/50–60 Hz Salida: 15 V/40 VA
Interfaces	Utilice únicamente un cable blindado con una longitud máxima de 3 m: 2x USB tipo A 1x USB tipo B Use únicamente cables con cubierta (por ejemplo, STP, FTP, S/FTP) con una longitud máxima de 20 m: 1x Ethernet
Clasificación del alojamiento	IP40

Especificaciones

Especificaciones de funcionamiento	
Clase de protección	Clase I
Altitud	2000 m
Grado de contaminación	2
Categoría de sobrevoltaje	II
Condiciones ambientales	Sólo para uso en interiores
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa

Sección 2 Información general

2.1 Información de seguridad

Lea todo el manual del usuario con detenimiento antes de desembalar el dispositivo, configurarlo y ponerlo en funcionamiento. Preste especial atención a todas las indicaciones de peligro y advertencia. De lo contrario, podría provocar lesiones graves a los usuarios y averías al equipo.

A fin de garantizar que no se deteriore la protección que ofrece este instrumento, evite instalarlo de maneras distintas a las especificadas en estas instrucciones de uso.

⚠ PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente o potencial que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Señala una situación de peligro inminente o potencial, que de no evitarse, podría causar lesiones graves y la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Señala una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones leves o menos graves.

AVISO

Indica una situación que, de no evitarse, puede ocasionar daños en el dispositivo. Información que se debe recalcar de manera especial.

Nota: Información complementaria de algunos elementos del texto principal.

2.1.1 Etiquetas de precaución

Lea todas las etiquetas y rótulos adosados al instrumento. De no acatarse lo indicado en dichas etiquetas y rótulos, podrían ocurrir lesiones personales y/o daños al instrumento. En el caso de los símbolos adheridos al instrumento, se pueden encontrar las notas de advertencia correspondientes en el manual del usuario.

	Es posible que este símbolo esté adherido al dispositivo y hace referencia al funcionamiento o a las notas de seguridad en el manual del usuario.
	Los equipos eléctricos marcados con este símbolo no se podrán desechar por medio de los sistemas europeos públicos o domésticos de eliminación de desechos después del 12 de agosto de 2005. En conformidad con las provisiones aplicables, los consumidores en los Estados Unidos deben devolver el equipamiento eléctrico antiguo al fabricante para su eliminación desde esta fecha, sin cargo para el usuario. Nota: Para la devolución a efectos del reciclaje, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor del equipo a fin de obtener instrucciones sobre la correcta eliminación de instrumentos viejos, accesorios eléctricos suministrados por el fabricante y todos los elementos auxiliares.

2.1.2 Módulo RFID (no disponible en todos los modelos)

La tecnología RFID es una aplicación de radio. Las aplicaciones de radio están sujetas a las condiciones de autorización nacionales. En caso de duda, póngase en contacto con el distribuidor.

El DR3900 contiene un módulo RFID para recibir y transmitir información y datos. El módulo RFID funciona con una frecuencia de 13,56 MHz.

ADVERTENCIA

El espectrofotómetro no se puede utilizar en entornos peligrosos. El fabricante y sus proveedores rechazan toda garantía expresa o indirecta en aplicaciones de actividades de alto riesgo.

Tenga en cuenta la siguiente información de seguridad, además de cualquier directriz local que sea aplicable.

Información de seguridad para el uso correcto del instrumento:

- No utilice el instrumento en hospitales o establecimientos similares que estén en las proximidades de equipos médicos, como marcapasos o audífonos.
- No utilice el instrumento cerca de sustancias altamente inflamables, como combustibles, productos químicos muy inflamables y explosivos.
- No utilice el dispositivo cerca de gases, vapores o polvo combustibles.
- No haga vibrar ni sacuda el instrumento.
- El instrumento puede provocar interferencias en las proximidades inmediatas de televisores, radios y ordenadores.
- No abra el instrumento.
- La garantía se anula si el instrumento no se utiliza según las pautas presentadas en este documento.

2.1.3 Seguridad química y biológica

PELIGRO

Daño potencial con el contacto con sustancias químicas/biológicas. Trabajar con muestras químicas, estándares y reactivos puede resultar peligroso.

Asegúrese de conocer los procedimientos de seguridad necesarios y el manejo correcto de los productos químicos antes de usarlos y de leer y seguir las hojas de datos de seguridad relevantes.

Con el funcionamiento normal de este dispositivo, puede resultar necesario el uso de productos químicos que supongan un riesgo para la salud o de muestras biológicamente peligrosas.

- Antes de manipular estas sustancias, lea todas las notas de peligro y la información de seguridad impresas en los contenedores de las soluciones originales y en la hoja de datos de seguridad.

- Deshágase de todas las soluciones que haya utilizado de acuerdo con las normativas y leyes nacionales.
- Seleccione el tipo de equipo de protección más conveniente para la concentración y cantidad del material peligroso que se utilice.

2.2 Información general del producto

El DR 3900 es un espectrofotómetro VIS con un rango de longitud de onda de entre 320 y 1100 nm. El instrumento se entrega con una serie completa de programas y admite varios idiomas.

El espectrofotómetro DR 3900 contiene los siguientes programas y tipos de operaciones:

- Programas almacenados (test previamente instalados)
- Programas de códigos de barras
- Programas del usuario
- Favoritos
- Longitud de onda única
- Long. de onda múltiple
- Barrido de longitud de onda
- Cinéticas en el tiempo

El espectrofotómetro DR 3900 ofrece lecturas digitales en unidades de concentración directas, absorbancia o porcentaje de transmitancia.

Al seleccionar un método programado o creado por el usuario, los menús y mensajes sirven para dirigir al usuario a través del test.

Este sistema de menús también puede crear informes, evaluaciones estadísticas de curvas de calibración generadas y documentar comprobaciones de diagnóstico de instrumento.

Información general

ADVERTENCIA

Peligro eléctrico y de incendio.

Utilice únicamente la fuente de alimentación de sobremesa LZV844 suministrada.

Las tareas que se describen en esta sección del manual sólo pueden ser realizadas por expertos cualificados, que deben cumplir todas las normativas de seguridad válidas en la región.

3.1 Desembalaje del instrumento

El espectrofotómetro DR 3900 se suministra en un embalaje con los siguientes artículos:

- Espectrofotómetro DR 3900
- Funda guardapolvo
- Funda guardapolvo USB, incluida de serie
- Cable de alimentación de sobremesa con cable de alimentación para EE.UU.
- Adaptador de cubetas A.
- Protector de luz, incluido de serie en el DR 3900
- Pestaña RFID del usuario (no disponible en todos los modelos)
- Instrucciones de funcionamiento básicas del DR 3900, instrucciones de funcionamiento de LINK2SC

Para más información, la documentación y los manuales de usuario detallados están disponibles en el sitio web del fabricante.

Nota: Si falta algún elemento, o alguno está dañado, póngase en contacto inmediatamente con su fabricante o con un representante.

3.2 Entorno operativo

Cumpla con los siguientes puntos para permitir que el instrumento funcione normalmente y tenga una larga vida útil.

- Ubique el instrumento firmemente en una superficie plana y tenga la precaución de retirar cualquier objeto de debajo del dispositivo.
- La temperatura ambiental debe oscilar entre 10 y 40 °C (50–104 °F).

AVISO


Proteja el instrumento de las temperaturas extremas de los radiadores, la luz directa del sol u otras fuentes de calor.

- La humedad relativa debe ser inferior al 80 %; el vaho no debe condensarse en el instrumento.
- Deje al menos 15 cm de espacio libre en la parte superior y en los lados para permitir que la circulación evite el sobrecalentamiento del dispositivo.

- No utilice ni almacene el dispositivo en lugares con mucho polvo o humedad.
- Mantenga la superficie del instrumento, el compartimento de cubetas y todos los accesorios limpios y secos en todo momento. Limpie inmediatamente cualquier salpicadura o material derramado en el instrumento (consulte [Sección 7](#)).


3.3 Vista frontal y trasera

Figura 1 Vista frontal

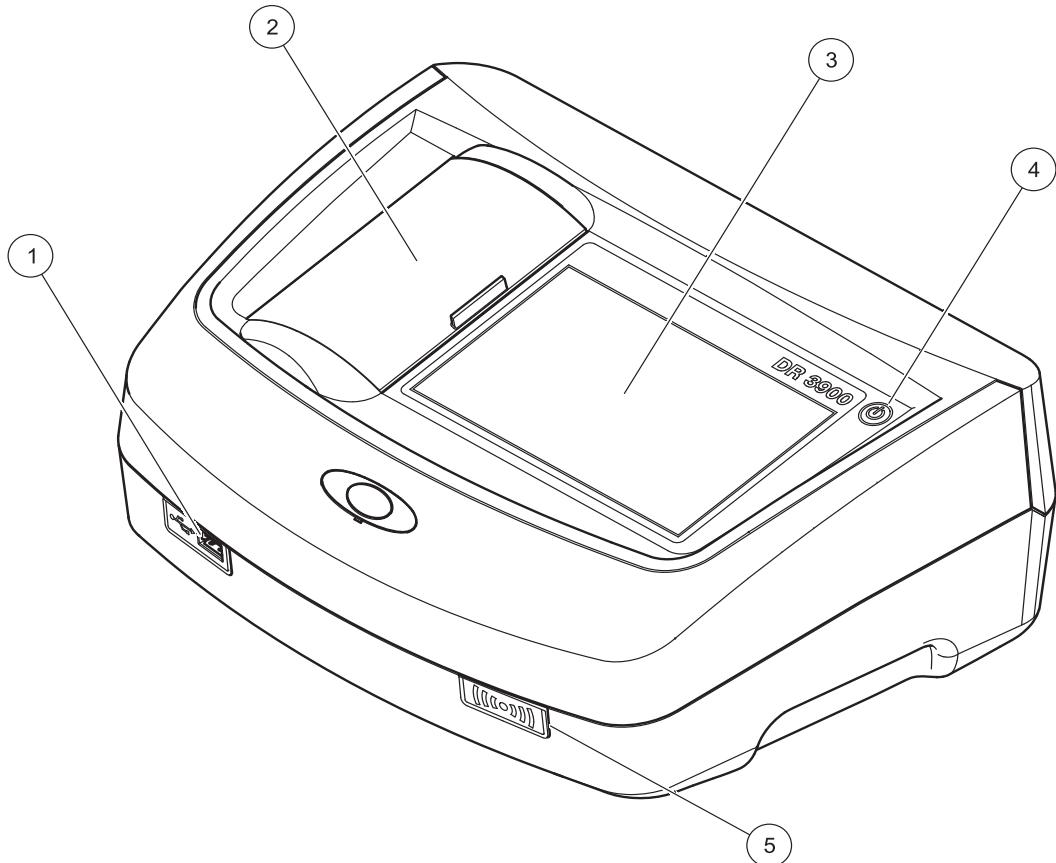

1	Puerto USB de tipo A	4	Interruptor de encendido/apagado
2	Cubierta del compartimento de cubetas	5	Módulo RFID (no disponible en todos los modelos)
3	Pantalla táctil		

Figura 2 Vista posterior

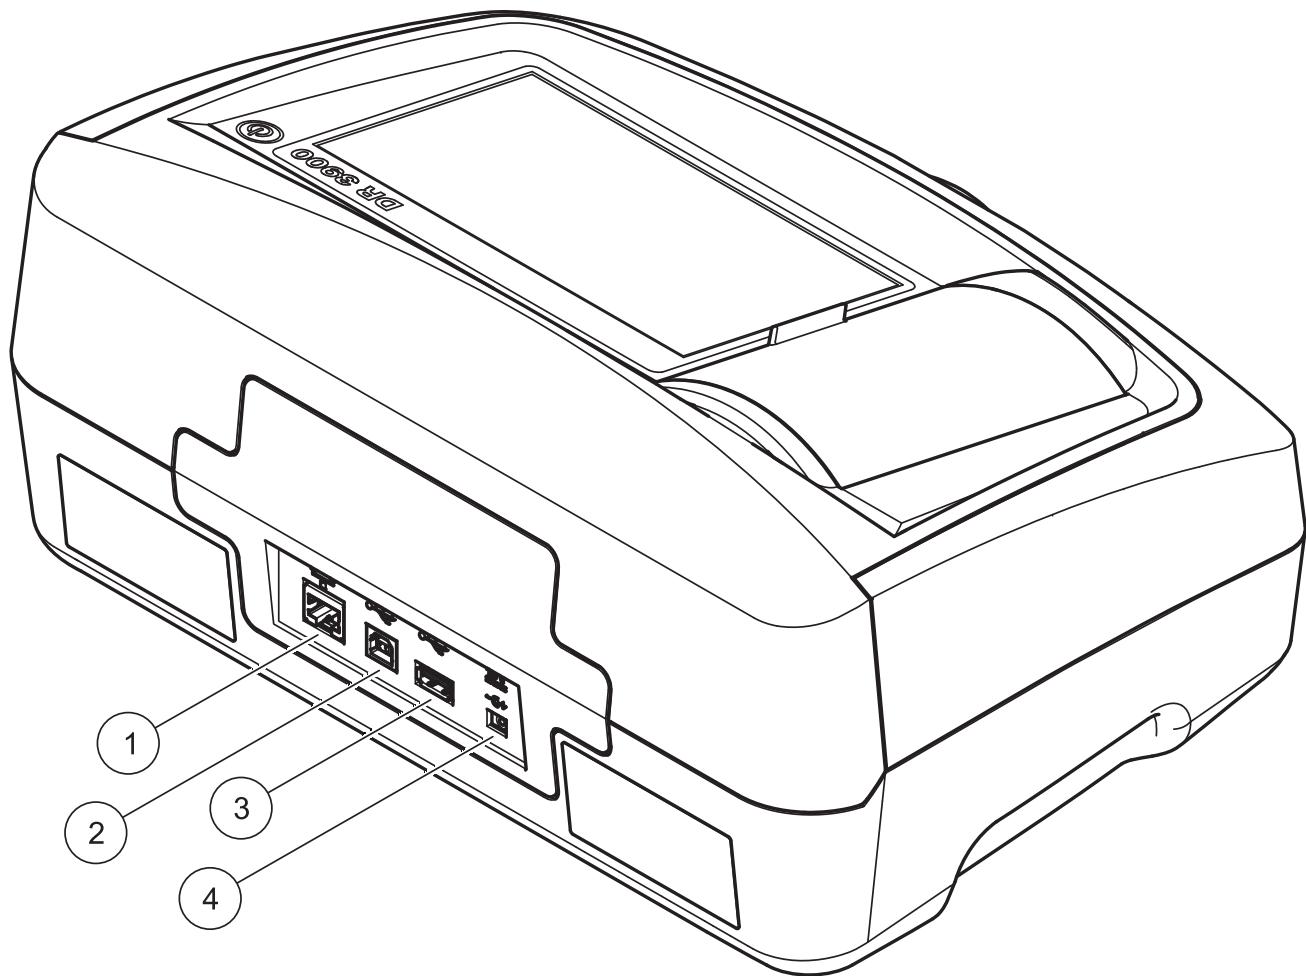

1 Puerto Ethernet	3 Puerto USB de tipo A
2 Puerto USB de tipo B	4 Conexión de fuente de alimentación de sobremesa

3.4 Conexiones eléctricas

ADVERTENCIA

Peligro eléctrico y de incendio.
Utilice únicamente la fuente de alimentación de sobremesa LZV844 suministrada.

1. Conecte el cable de alimentación eléctrica a la fuente de alimentación de sobremesa.
2. Enchufe el cable de la fuente de alimentación de sobremesa a la parte posterior del instrumento (Figura 2, página 17).
3. Introduzca el enchufe del cable de alimentación eléctrica en una toma eléctrica (100-240 V~/50–60 Hz).
4. Presione el botón de encendido situado junto a la pantalla para encender la fuente de alimentación (Figura 1, página 16).

3.5 Interfaces

El DR 3900 cuenta con tres puertos USB y un puerto Ethernet de serie que están situados en la parte delantera y posterior del instrumento ([Figura 1](#) y [Figura 2](#), [página 17](#)).

Los puertos USB de tipo A se utilizan para las comunicaciones con la impresora, la memoria USB o el teclado. La memoria USB se puede utilizar para actualizar el software del instrumento.

El puerto USB de tipo B se utiliza para las comunicaciones con el PC. El software opcional Hach Data Trans (consulte [Sección 9, página 141](#)) debe estar instalado en el PC para transferir los datos.

Se puede utilizar un concentrador USB para conectar varios accesorios a la vez.

Nota: *Los cables USB no deben exceder los 3 m.*

Estos puertos USB permiten que los datos sean exportados a una impresora o una PC y también permite la actualización del instrumento (ver [sección 6.8.2, página 114](#)). El puerto Ethernet permite la transferencia de datos en tiempo real en redes locales, sistemas LIMS o controladores SC. Utilice únicamente un cable blindado (por ejemplo, STP, FTP, S/FTP) con una longitud máxima de 20 m para el puerto Ethernet.

3.6 Compartimento de cubetas, adaptadores de cubetas y protector de luz

3.6.1 Compartimentos y adaptadores de cubetas

El DR 3900 cuenta con dos compartimentos de cubetas ([Figura 3](#)). Sólo se puede utilizar un tipo de cubeta a la vez para una medición.

Compartimento de cubetas (1) para:

- Cubetas redondas de 13 mm



Nota: *El compartimento de cubetas (1) contiene detección de códigos de barra para cubetas.*

Compartimento de cubetas (2) para:

En el compartimento de cubetas (2) se pueden utilizar los siguientes tipos de cubetas.

- Sin el adaptador de cubetas A, se pueden utilizar cubetas de 50 mm, cubetas rectangulares de 1 pulgada y cubetas de flujo de 1 pulgada directamente en el compartimento de cubetas.
- Con el adaptador de cubetas A, se pueden utilizar cubetas rectangulares de 10 mm, cubetas redondas de 1 pulgada y viales AccuVac®.

Nota: *Estas cubetas se deben introducir utilizando el adaptador de cubetas A.*

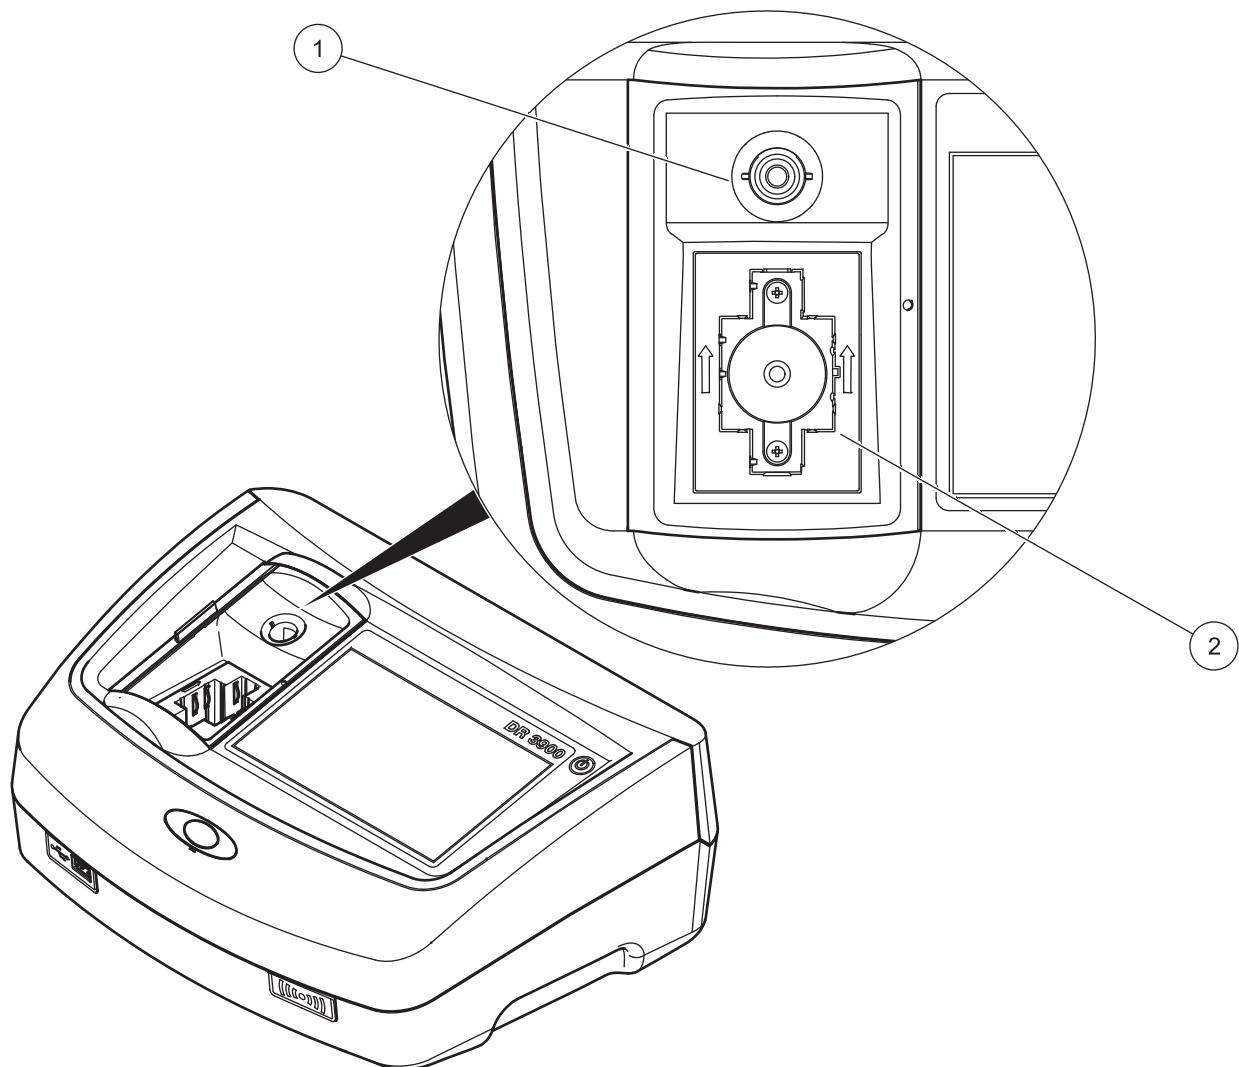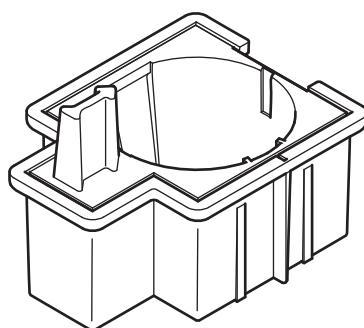Figura 3 Compartimentos de cubetas**1** Compartimento de cubetas para cubetas redondas (1)**2** Compartimento de cubetas para cubetas rectangulares (2)**Figura 4** Adaptador de cubetas


Adaptador de cubetas A: cubeta redonda de 1 pulgada/cubetas rectangulares de 10 mm

3.6.2 Instalación del adaptador de cubetas

1. Abra el compartimento de cubetas.
2. Coloque el adaptador de cubetas en el compartimento de cubetas (2) de forma que la flecha del adaptador de cubetas señale a la parte posterior ([Figura 5](#)).

Nota: La flecha en la parte superior del adaptador de cubetas indica la dirección de la trayectoria de la luz.

Figura 5 **Instalación de un adaptador de cubetas**

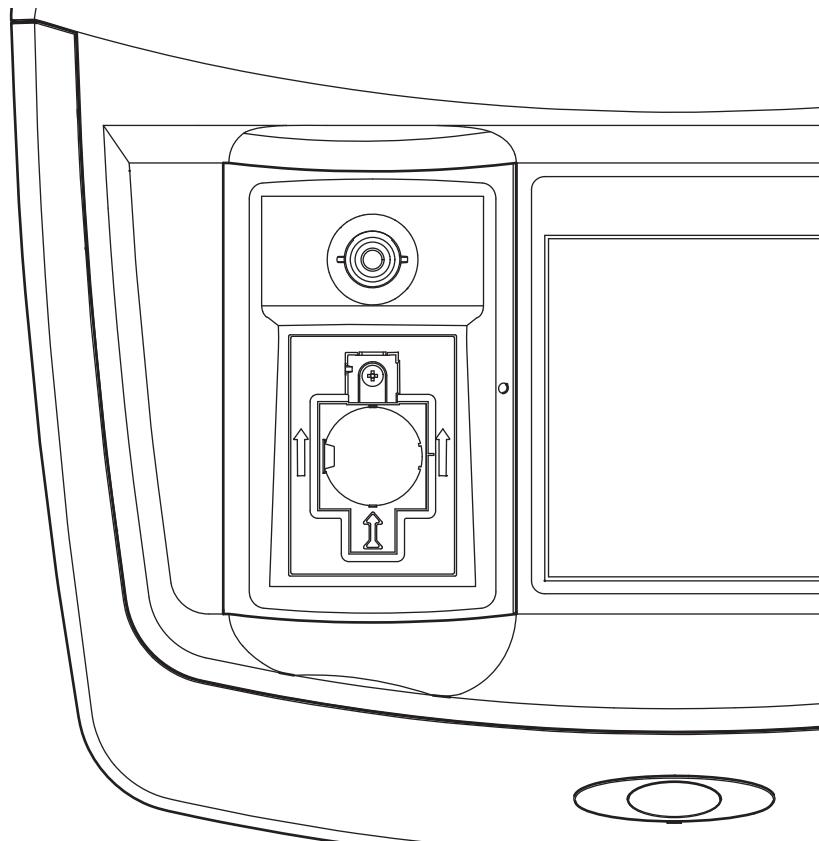


3.6.3 Uso del protector de luz para las mediciones

El protector de luz ([Figura 6](#)) previene la exposición perjudicial a la luz cuando se utilizan cubetas redondas de 13 mm en el compartimento de cubetas (1).

Introduzca el protector de luz en el compartimento de cubetas (2) antes de realizar las mediciones en el compartimento de cubetas (1).

El instrumento es suministrado con el protector de luz instalado. Retire el protector de luz antes de utilizar el compartimento de cubetas (2).

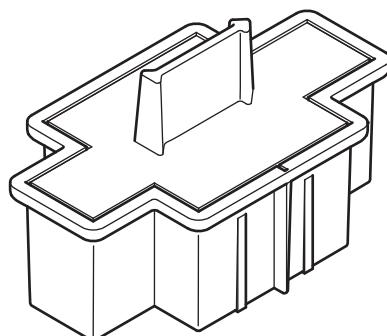
Figura 6 Protector de luz**Instalación del protector de luz**

1. Abra el compartimento de cubetas.
2. Coloque el protector de luz en el compartimento de cubetas (2) de forma que la flecha del protector de luz señale a la parte posterior.

3.7 Trayectoria del haz

Figura 7 muestra la trayectoria del haz del DR 3900.

Figura 7 **Trayectoria del haz**

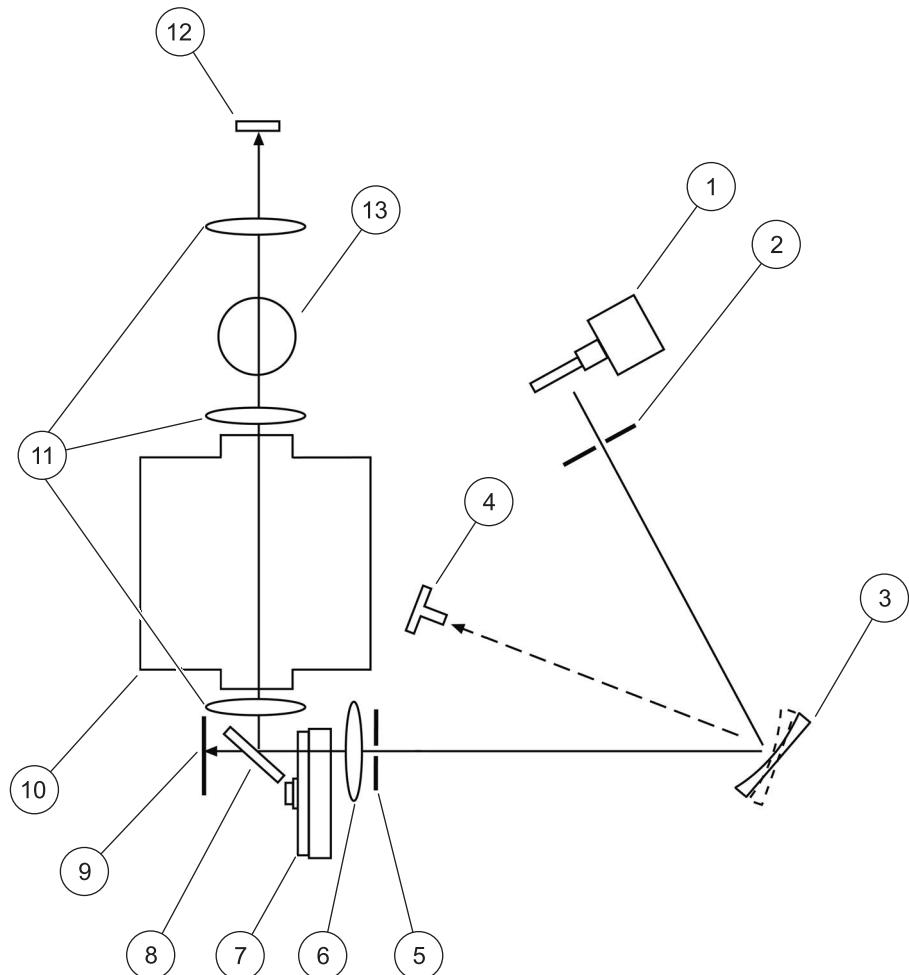

1 Lámpara halógena	8 Espejo separador
2 Abertura de entrada	9 Elemento de referencia
3 Rejilla	10 Compartimento de cubetas (2) para cubetas rectangulares
4 Indicador de ángulo de rejilla	11 Lente
5 Abertura de salida	12 Elemento de medición
6 Lente	13 Compartimento de cubetas (1) para cubetas redondas
7 Rueda de filtros	

4.1 Encendido del instrumento, proceso de arranque

1. Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación eléctrica.
2. Para encender el instrumento, utilice el botón de encendido situado junto a la pantalla.
3. El instrumento se inicia automáticamente con un proceso de arranque que dura aproximadamente 45 segundos. En la pantalla aparece el logotipo del fabricante. Al final del proceso de arranque, se oye una melodía de arranque.

Nota: Espere aproximadamente 20 segundos antes de volver a encenderlo para no dañar el sistema electrónico y mecánico del instrumento.

4.2 Selección del idioma



El software del espectrofotómetro DR 3900 incluye varias opciones de idioma. La primera vez que se enciende el instrumento aparece automáticamente la pantalla de selección del idioma después del proceso de arranque.


1. Seleccione el idioma deseado.
2. Pulse **OK** para confirmar la selección. A continuación se inicia automáticamente la autocomprobación.

Cambio del ajuste del idioma

El instrumento funcionará en el idioma seleccionado hasta que se cambien las opciones.

1. Encienda el instrumento.
2. Durante el proceso de arranque, toque en cualquier punto de la pantalla y mantenga el contacto hasta que aparezca la opción para seleccionar un idioma (aproximadamente 45 segundos).
3. Seleccione el idioma deseado.
4. Pulse **OK** para confirmar la selección. A continuación se inicia automáticamente la autocomprobación.

4.3 Autocomprobación

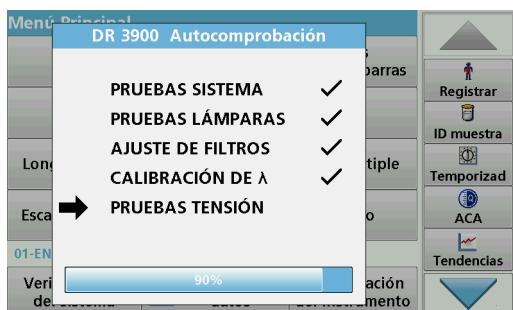

Cada vez que se enciende el instrumento, se inicia un programa de chequeo.

Este procedimiento, que dura unos dos minutos, comprueba el sistema, la lámpara, el ajuste de los filtros, la calibración de las longitudes de onda y la tensión eléctrica. Cada test que funciona correctamente se marca de la manera correspondiente.

Una vez completados los diagnósticos, aparece el Menú Principal.

Nota: En caso de que aparezcan más mensajes de error durante el programa de chequeo, consulte [Sección 8, página 137](#).

4.4 Modo de hibernación



El instrumento se puede poner en el modo de hibernación.

1. Pulse brevemente el botón de encendido que hay junto a la pantalla.
Aparecerá el mensaje "Modo de hibernación". A continuación, la pantalla se apagará automáticamente.
2. Para encenderla, pulse el botón de encendido situado junto a la pantalla.
La autocomprobación se inicia automáticamente.
A continuación, el instrumento está listo para su uso.

4.5 Apagado del instrumento

1. Pulse el botón de encendido al costado de la pantalla por aproximadamente 5 segundos.

Sección 5 Programas estándar

5.1 Información general

5.1.1 Consejos de uso de la pantalla táctil

Toda la pantalla es táctil. Para elegir una opción, dé un golpecito con la uña, la punta del dedo, una goma de borrar o un lápiz especial. No toque la pantalla con objetos puntiagudos, como la punta de un bolígrafo.

- No coloque nada encima de la pantalla, pues se podría rayar.
- Pulse sobre botones, palabras o iconos para seleccionarlos.
- Utilice la barra de desplazamiento para moverse rápidamente por la lista. Pulse y mantenga pulsada la barra de desplazamiento y después mueva la punta del dedo hacia arriba o hacia abajo para moverse por la lista.
- Para seleccionar un elemento en una lista, pulse ese elemento una vez. Cuando lo haya seleccionado correctamente, se visualizará como texto inverso (texto claro sobre fondo oscuro).

5.1.2 Uso del teclado alfanumérico



Este teclado alfanumérico se emplea para introducir letras, números y símbolos al programar el instrumento. Las opciones no disponibles están desactivadas. Los iconos de la derecha e izquierda de la pantalla se describen en la [Tabla 1](#).

El teclado central cambia para reflejar el modo de introducción elegido. Pulse una tecla repetidamente hasta que aparezca en la pantalla el carácter deseado. Para introducir un espacio utilice el subrayado de la tecla **YZ_**.

Pulse **Cancelar** para cancelar una introducción o pulse **OK** para confirmar la introducción.

Nota: También es posible utilizar un teclado USB (con la configuración del teclado de EE.UU.) o un escáner de códigos de barras USB de mano (consulte [Sección 9, página 141](#)).

Tabla 1 Teclado alfanumérico

Icono / tecla	Descripción	Función
ABC/abc	Alfabético	Cambia el modo de introducción de caracteres entre mayúsculas y minúsculas.
# %	Símbolo	Se puede introducir puntuación, símbolos, subíndices y superíndices.
123	Numérico	Para introducir números normales.
CE	Borrar programa introducido	Borra la introducción.
Flecha izquierda	Atrás	Borra el carácter actual y retrocede una posición.
Flecha derecha	Siguiente	Se desplaza al siguiente espacio en una entrada.

Programas estándar

5.1.3 Menú Principal



En el Menú Principal pueden seleccionarse diversos modos operativos. En la siguiente tabla se describe brevemente cada opción del menú.

Hay una barra de herramientas en la parte derecha de la pantalla. Púlsela para activar las diversas funciones.

Tabla 2 Opciones del Menú Principal

Opción	Función
Programas almacenados / Programas de códigos de barras (Programas de HACH-LANGE)	Los programas almacenados son métodos preprogramados que utilizan productos químicos de HACH y test de pipetas de HACH-LANGE. Los procedimientos de trabajo de los test de HACH-LANGE están incluidos en los paquetes de cada test. Par más información, así como instrucciones de procesos paso a paso e ilustradas para realizar análisis utilizando programas HACH, se encuentran disponibles en el sitio web del fabricante.
Programas del usuario	Los Programas del usuario hacen posible la realización de análisis personalizados: <ul style="list-style-type: none">Los usuarios pueden programar métodos desarrollados por ellos mismosLos métodos existentes de HACH y LANGE se pueden almacenar como programas del usuario. Los test de HACH-LANGE se pueden modificar para adaptarlos a los requisitos de los usuarios.
Favoritos	Enumera los métodos y tests creados por el usuario para dar respuesta a sus propias necesidades.
Longitud de onda única	Las medidas de la longitud de onda única son: Medidas de absorbancia: La luz absorbida por la muestra se mide en unidades de absorbancia. Medida de transmitancia (%): Mide el porcentaje de luz original que atraviesa la muestra y alcanza el detector. Medidas de concentración: Introduciendo un factor de concentración se pueden convertir los valores medidos de absorbancia en valores de concentración.
Long. de onda múltiple	En este modo, la absorbancia (Abs) o el porcentaje de transmitancia (%T) se miden hasta con cuatro longitudes de onda; además, se calculan las diferencias y relaciones de absorbancia. Asimismo, se realizan conversiones simples en concentraciones.
Barrido de longitud de onda	El barrido de longitud de onda muestra cómo se absorbe la luz de una muestra en un espectro de longitud de onda definido. Esta función se puede utilizar para determinar la longitud de onda a la cual se puede medir el valor de absorbancia máximo. El comportamiento de la absorbancia se muestra de manera gráfica durante el barrido.
Cinéticas en el tiempo	Las cinéticas en el tiempo registran la absorbancia o la transmitancia (%) a una longitud de onda en un periodo de tiempo definido.
Pruebas del sistema	El menú "Pruebas del sistema" incluye varias opciones, como pruebas ópticas, pruebas de salida, historial de la lámpara, actualización del instrumento, tiempos de servicio, configuración del aseguramiento de la calidad analítica y backup del instrumento.
Recuperación de datos de mediciones	Los datos almacenados se pueden abrir, filtrar, enviar y borrar.
Configuración del instrumento	En este modo, se pueden introducir configuraciones específicas del usuario o del método: ID del usuario, ID de muestra, fecha y hora, sonido, PC e impresora, contraseña, modo de ahorro de energía y datos almacenados.

5.2 Configuración del instrumento



1. En el Menú Principal, seleccione **Configuración del instrumento**.

Aparecerá una selección de funciones para configurar las funciones del instrumento.

5.2.1 ID del usuario

Utilice esta opción para introducir en el instrumento hasta 30 grupos de iniciales de usuarios (de hasta diez caracteres cada uno). Esta característica ayuda a registrar al usuario que mide cada muestra.



1. Pulse **ID del usuario** en "Configuración del instrumento".
2. Press **Opciones>Nuevo** para ingresar un nuevo ID de operador.

Nota: Si todavía no se ha introducido ningún ID de usuario, el teclado alfanumérico aparece inmediatamente.

3. Utilice el teclado alfanumérico para introducir un nuevo ID del usuario.
4. Pulse **OK** para confirmar la introducción.



5. Elija un icono para el ID del usuario con la **flecha izquierda** y la **flecha derecha**.
6. Pulse **Contraseña de usuario** para proteger el ID del usuario con una contraseña.
7. Utilice el teclado alfanumérico para introducir una contraseña de usuario.
8. Pulse **OK** para confirmar la introducción.



9. Pulse **Cancelar** para borrar toda la introducción del ID del usuario.
- Pulse **Atrás** para acceder a la pantalla de introducción del ID del usuario.
- Pulse **OK** para confirmar la introducción. Aparece la siguiente pantalla.



10. Con **Atrás** el dispositivo vuelve al menú "Configuración del instrumento".

Pulse **Salir sesión** para salir de la sesión de un ID del usuario activo.

Pulse **Registrar** para activar un ID del usuario seleccionado. Pulse **Opciones** para introducir, cambiar o borrar ID de usuario adicionales. Aparece la siguiente pantalla.



11. Pulse **Nuevo** para introducir otro ID del usuario.

Pulse **Borrar** para borrar un ID del usuario.

Pulse **Edición** para editar un ID del usuario.


Pulse **Iniciar Pestaña RFID** para escribir el ID del usuario en una pestaña RFID de usuario opcional (no disponible en todos los modelos). Consulte [sección 5.2.1.1](#) para obtener más información.

5.2.1.1 Pestaña RFID del usuario (no disponible en todos los modelos)



1. Defina un ID del usuario (consulte [sección 5.2.1](#)).

2. Pulse **Iniciar Pestaña RFID**.

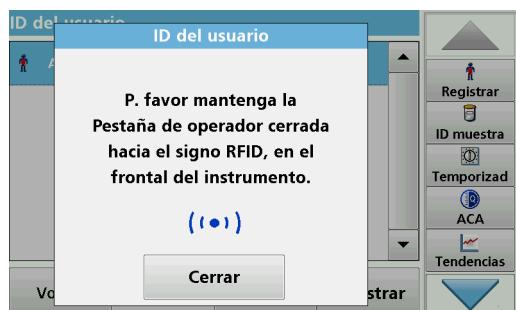

3. Siga las instrucciones en pantalla y mantenga la pestaña RFID del usuario en la parte frontal derecha del módulo RFID.

Un sonido indica que el proceso de escritura se ha realizado correctamente.

4. La pestaña RFID del usuario se puede volver a escribir en cualquier momento. Para ello, confirme el mensaje "Sobrescribir ID de usuario" con **OK** e introduzca la contraseña si el ID del usuario antiguo está protegido con una.

Si la pestaña RFID del usuario se sobrescribe correctamente, en la pantalla aparecerá brevemente un mensaje para confirmarlo.

El usuario inicia la sesión y el ID del usuario aparece en la barra de herramientas.

5.2.2 ID de la muestra

Utilice esta opción para introducir hasta 100 etiquetas de identificación de la muestra (hasta 20 caracteres cada una) en el instrumento. Se puede utilizar un ID de prueba para especificar la ubicación de prueba u otra información específica de prueba, por ejemplo.



1. Pulse **ID muestra** en la barra de herramientas de la derecha.

2. Pulse **Nuevo** para introducir un nuevo ID de muestra.

Nota: Si todavía no se ha introducido un ID de muestra, el teclado alfanumérico aparece inmediatamente.

3. Con el teclado alfanumérico, introduzca un nuevo ID de la muestra.

Nota: Si tiene conectado un escáner USB portátil de códigos de barras (consulte sección 5.2.2.1, página 30), también puede escanear los ID de muestra.

4. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

5. Asigne la fecha y hora actuales, un número secuencial o un color al ID de muestra.



6. Para numerar secuencialmente los ID de muestra (por ejemplo, Entrada (01), etc.) pulse **Agregar número**.

- Utilice las teclas de flecha para especificar el primer número de la secuencia.
- Utilice la tecla existente entre las teclas de flecha para introducir el primer número de la secuencia directamente con el teclado alfanumérico.

7. Pulse **OK** para regresar al menú "Configuración del instrumento".

El ID de la muestra está activado. Cada ID de muestra se numera automáticamente en orden ascendente después de una medición. El número aparece entre paréntesis tras el ID de la muestra.



Programas estándar



8. Pulse **Atrás** para que el instrumento regrese al menú "Configuración del instrumento".
Pulse **Apagado** para desactivar el ID de muestra activo.
Pulse **Seleccionar** para activar el ID de muestra seleccionado.
Utilice **Opciones** para introducir, cambiar o borrar ID de muestra adicionales. Aparece la siguiente pantalla:



9. Pulse **Nuevo** para introducir otro ID de muestra.
Pulse **Borrar** para borrar un ID de muestra.
Pulse **Edición** para editar un ID de muestra.
Pulse **Iniciar Pestaña RFID** para escribir el ID de muestra en una pestaña RFID de una ubicación opcional (no disponible en todos los modelos).

5.2.2.1 ID de muestra con método de escáner 1

1. Conecte el escáner al puerto USB.

Un sonido indica que la conexión se ha realizado correctamente.

2. Pulse **ID de prueba>Opciones y Nuevo**.
3. Lea el código de barras con el escáner.



4. El ID de muestra puede tener asignada la fecha y hora actuales, un número secuencial y un color.
Seleccione las opciones deseadas o un color.
5. Pulse **OK** para confirmar la introducción.



6. Pulse otra vez **Nuevo** y repita el proceso para cada código de barras.

5.2.2.2 ID de muestra con método de escáner 2

1. Lea el ID de muestra en la pantalla con el escáner de códigos de barra y realice la medida.

El código de barras se almacena junto con la medición, pero no se incorpora a la lista de ID de muestra.

Nota: Para borrar un ID de muestra de la lista, selecciónelo y pulse **Borrar**.

Nota: Se puede introducir o cambiar un ID de muestra en el modo de medición. En la pantalla de resultados, pulse

Opciones>Más>Configuración del instrumento. Si el ID de muestra ya está asignado, seleccione el símbolo de ID de muestra en la pantalla de resultados.

5.2.3 ID de muestra e ID de usuario con el kit de ID de muestras RFID opcional (no disponible en todos los modelos)

El Kit de ID de muestras RFID opcional consta de lo siguiente:

- Un localizador RFID LOC 100
- Una pestaña RFID de usuario
- Cinco pestañas RFID de localización y
- Tres etiquetas de RFID de frascos de muestras cada uno, en negro, rojo, verde, azul y amarillo

Las pestañas RFID de usuario y de localización se pueden sobrescribir y medir en el módulo RFID en el DR 3900 todas las veces que sean necesarias.

Encontrará más información en el manual de usuario del Localizador RFID LOC 100.


5.2.4 Configuración de seguridad

El menú "Seguridad" contiene varios ajustes de seguridad para controlar el acceso a algunas funciones.

Todas las funciones se pueden asignar a tres niveles de seguridad diferentes:

- **no protegido:** todos los usuarios pueden realizar cambios aquí
- **una llave:** todos los usuarios asignados a este nivel de seguridad pueden realizar cambios en las funciones no protegidas y las funciones con una tecla.
- **dos llaves:** todos los usuarios asignados a este nivel de seguridad pueden realizar cambios en todas las funciones.

Programas estándar

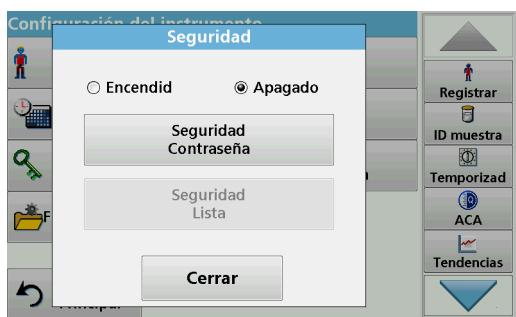


1. Pulse **Seguridad** en el menú "Configuración del instrumento".


2. Para abrir la **lista de seguridad**, asigne una contraseña de administrador de seguridad. Pulse **Contraseña de seguridad**.




3. Utilice el teclado alfanumérico para ingresar una nueva contraseña de seguridad (hasta 10 caracteres) y pulse **Aceptar** para confirmar.

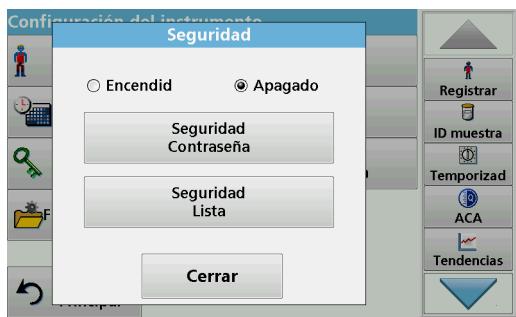


4. Presione **Lista de seguridad** para obtener acceso a múltiples funciones con nivel de seguridad 1 o 2.



5. Seleccione la función deseada y pulse **Config.**

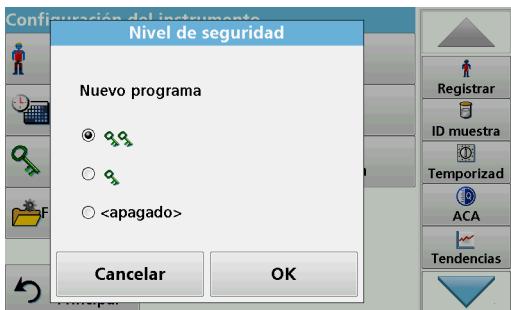

6. Seleccione el nivel de seguridad requerido (dos claves, una clave o apagar) y confirme usando **Aceptar**.
7. Confirme la **lista de seguridad** pulsando **OK** para volver al menú "Seguridad".

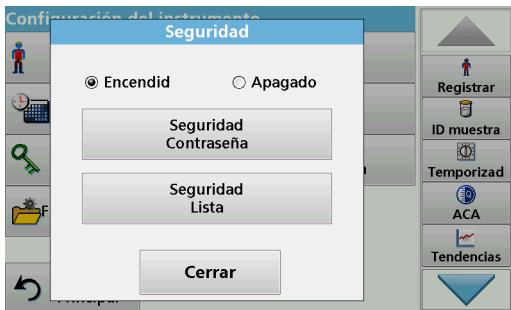

8. Pulse **Encendido** para activar la nueva configuración de la lista de seguridad.
9. Pulse **OK** para regresar al menú "Configuración del instrumento".

Nota: El teclado alfanumérico para introducir la contraseña aparecerá cuando el usuario intente acceder a una configuración bloqueada.

5.2.4.1 Asignación de un nivel de seguridad de usuario

Todos los usuarios con un ID de usuario pueden tener asignado un nivel de seguridad. Este nivel de seguridad está conectado con la contraseña de usuario. La configuración se debe coordinar con el administrador de seguridad y el usuario.



1. Seleccione **ID de operador** desde "Configuración del instrumento".
2. Introduzca la contraseña de seguridad y confirme pulsando **OK**.
3. Configure un ID de usuario (consulte [sección 5.2.1](#)).




4. Pulse **Contraseña de usuario**.
5. Introduzca la contraseña deseada y confirme con **OK**.

Programas estándar



6. Pulse **Nivel de seguridad<Apagado>**
7. Introduzca la contraseña de seguridad y confirme con **OK**.
Aparece el nivel de seguridad actual del usuario seleccionado.

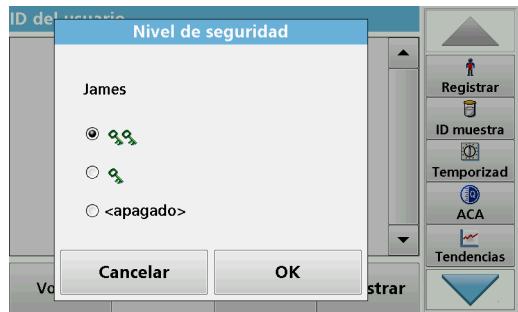

8. Seleccione el nivel de seguridad deseado de este ID de usuario y confirme con **OK**.



9. Pulse **OK**.




Aparece el ID de usuario con el nivel de seguridad seleccionado.

10. Para activar el ID de usuario seleccionado, pulse **Registrar**.
11. Introduzca la contraseña de usuario.
12. Confirme con **OK** y regrese a "Configuración del instrumento".

5.2.4.2 Desactivación de contraseña




1. Pulse **Seguridad** en el menú "Configuración del instrumento".
2. Introduzca la contraseña de seguridad y confírmelo con **OK**.

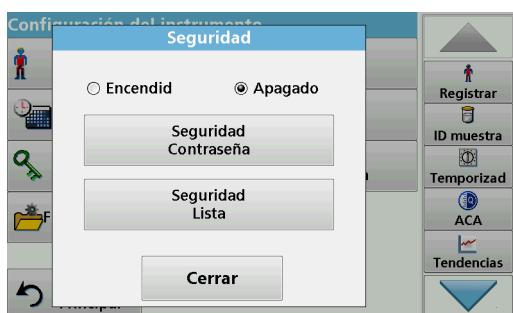


3. Pulse **Apagado** para desactivar la configuración de la Lista de seguridad.
4. Pulse **OK** para regresar al menú "Configuración del instrumento".

Nota: Utilice esta función para borrar la anterior contraseña o para introducir una nueva.


5.2.5 Fecha y hora

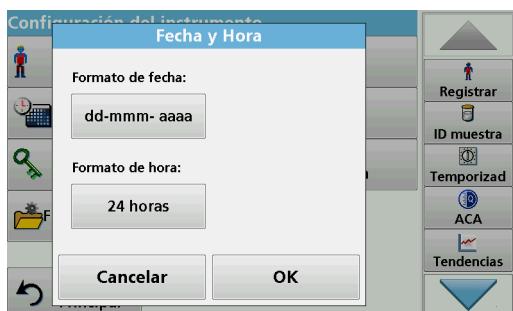


1. Pulse **Fecha y hora** en "Configuración del instrumento".

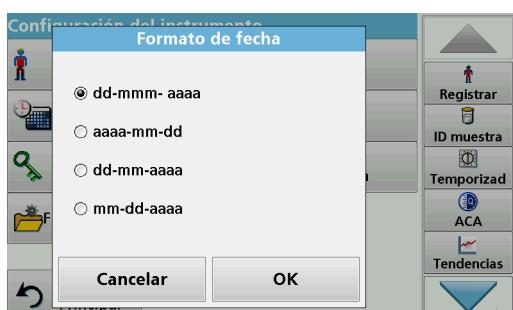


2. Seleccione un **formato de fecha**.
3. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

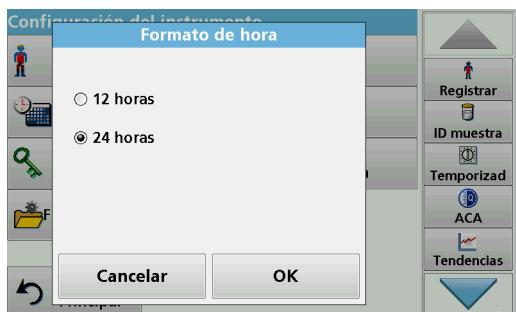

4. Seleccione un **Formato de hora**.
5. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

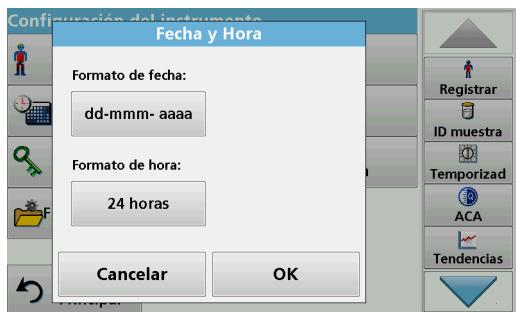


6. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

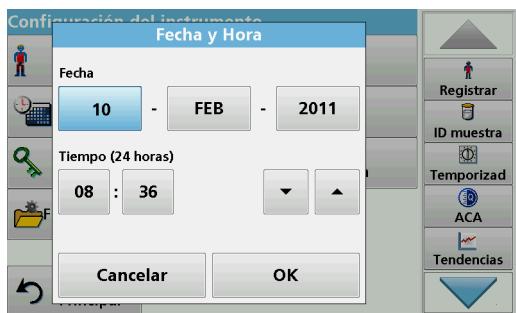

7. Introduzca la fecha y hora actuales. Cambie la información con las teclas de flecha.
8. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

El instrumento regresa a "Configuración del instrumento".

5.2.6 Ajustes de sonido

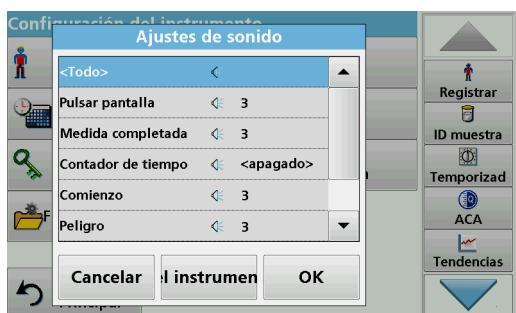

1. Pulse **Ajustes de sonido** en "Configuración del instrumento".

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Todo:**Activa o desactiva un sonido con un volumen variable para cada función, a excepción del temporizador.
- **Pulsar pantalla:**Activa o desactiva un sonido breve con volumen variable cada vez que se toca la pantalla.
- **Medida completada:**Activa o desactiva un sonido breve con volumen variable cuando se ha realizado la medida.
- **Temporizador:**Define un sonido largo o breve con volumen variable cuando termina el temporizador.
- **Comienzo:** Activa o desactiva una melodía de inicio con volumen variable cuando se inicia el programa de análisis.

- **Peligro:** Activa o desactiva un sonido breve con volumen variable si hay un mensaje de error.
- **RFID hecho:** Activa o desactiva un sonido breve con volumen variable cuando se ha realizado una transferencia RFID.
- **Apagado:** Activa o desactiva un sonido breve con volumen variable cuando se apaga.



2. Seleccione la acción deseada.
3. Pulse **Config.** y complete los ajustes deseados.
4. Pulse **OK** para confirmar la introducción.
5. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

El instrumento regresa a "Configuración del instrumento".

5.2.7 PC e impresora

El DR 3900 dispone de un puerto Ethernet y dos puertos USB en la parte posterior del instrumento, además de un puerto USB en la parte delantera (consulte [Figura 1](#) y [Figura 2, página 17](#)).

Estas interfaces se pueden utilizar para exportar datos y gráficos a una impresora, actualizar datos y transferir datos a un PC y en una red. Estas interfaces se pueden utilizar para la conexión de una memoria USB, un teclado USB externo o un escáner USB portátil de código de barras.

Nota: También se pueden conectar diversos accesorios simultáneamente utilizando un concentrador USB.

Se utiliza una memoria USB para actualizar los datos (consulte [sección 6.8.2, página 114](#)).

Nota: El cable USB blindado no debe medir más de 3 m.

Tabla 3 Conector USB


Interfaces	Descripción
USB (Tipo A)	Este puerto USB se puede utilizar para conectar una impresora, una memoria USB y un teclado.
USB (Tipo B)	Este puerto USB sólo sirve para conectar el DR 3900 a un PC (con la instalación del software correspondiente).
Ethernet	El puerto Ethernet sirve para transferir datos a un PC sin el software instalado o en una red local. Utilice únicamente un cable blindado (por ejemplo, STP, FTP, S/FTP) con una longitud máxima de 20 m para el puerto Ethernet.




1. Pulse **PC e Impresora** en "Configuración del instrumento".

Se abrirá una lista con información sobre las conexiones.

5.2.7.1 Configuración de la impresora

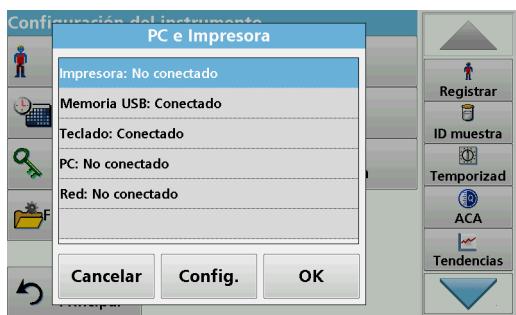


2. Pulse **Impresora**.
3. Pulse **Config.** para visualizar la pantalla Configuración impresora.

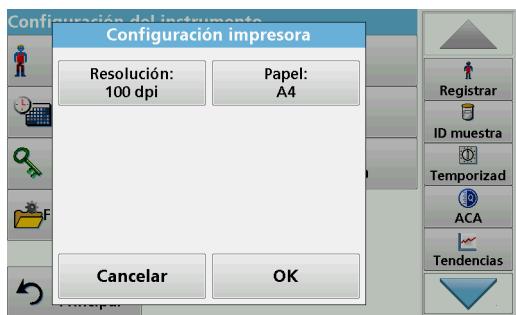

Configuración impresora:

- Resolución: Tamaño de la fuente
- Papel: Tamaño del papel

Nota: Si se conecta una impresora térmica adicional, la función "Auto Send": Encendido/Apagado estará disponible.




4. Pulse **Resolución** para seleccionar la calidad de la impresión.

Escoja entre:

- 100 ppp,
- 150 ppp y
- 300 ppp.

5. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

Nota: Pulse de nuevo **OK** para volver al menú "Configuración del instrumento".

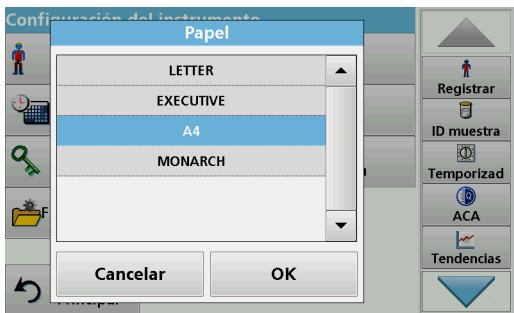

6. Pulse **Papel** para seleccionar el tamaño del papel.

Escoja entre:

- Carta,
- Monarca
- Ejecutivo,
- A4.

7. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

*Nota: Pulse de nuevo **OK** para volver al menú "Configuración del instrumento".*

5.2.7.2 Impresión de datos



1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.
 2. Seleccione el origen de datos, donde se almacenan los datos que se van a imprimir.
- Aparecerá una lista. Los datos se pueden filtrar. Consulte [sección 5.3.1.2, página 44](#) para obtener más información.
3. Pulse el icono **Impresora** para enviar los datos (tabla, curva) inmediatamente a la impresora.
 4. Seleccione **Un solo punto, Datos filtrados** o **Todos los datos**, y pulse **OK** para confirmar.

En la pantalla aparece Enviando datos... hasta que se imprimen los datos.

5.2.7.3 Impresión de datos de manera continua

Si se van a imprimir automáticamente todas las mediciones tras realizarlas, se recomienda utilizar una impresora de forma continua (por ejemplo, la impresora térmica de papel de 4 pulgadas). Consulte la [Sección 9, página 141](#).

1. Conecte la impresora térmica a un puerto USB de tipo A.
 2. Pulse **PC e Impresora** en el menú "Configuración del instrumento".
- Se abrirá una lista con información sobre las conexiones.
3. Seleccione **Impresora**.
 4. Pulse **Config.** para visualizar la pantalla Configuración impresora.
 5. Seleccione **Auto-Send: Encendido** para enviar todos los datos de medición automáticamente a la impresora térmica.

5.2.7.4 Configuración de red

AVISO

La seguridad de la red y del punto de acceso es responsabilidad del cliente que utiliza el instrumento inalámbrico. El fabricante no se hará responsable de ningún daño, incluyendo, sin limitación, daños indirectos, especiales, fortuitos o circunstanciales provocados por el incumplimiento o la violación de la seguridad en la red.

El DR3900 permite la comunicación en redes locales. Para establecer la comunicación Ethernet en redes, se necesita una configuración especial. El fabricante recomienda contar con la ayuda de un administrador de red. Utilice únicamente un cable blindado (por ejemplo, STP, FTP, S/FTP) con una longitud máxima de 20 m para el puerto Ethernet. En esta sección, se describen las opciones de ajuste del fotómetro en relación con la comunicación de red.



Hay que configurar los parámetros de conexión para la transferencia de datos a un PC o la conexión a una red.

1. Pulse **PC e Impresora** en "Configuración del instrumento".
2. Pulse **Red>Config..**
3. Pulsar **Encendido**.



4. Pulse Dirección IP.

Se utiliza una dirección IP para enviar datos de un remitente a un destinatario predefinido.

- Si la IP del DR3900 se emite automáticamente en la red, no es necesario realizar más ajustes. Opcionalmente, se puede asignar un nombre de host.
- Si la dirección del instrumento es fija, hay que configurar la conexión.



5. Seleccione **Fijado** para configurar la dirección IP.




- Pulse **Dirección IP** e introduzca la dirección.



En conjunción con la dirección IP de un instrumento, la máscara de subred establece las direcciones IP que se encuentran en la red local.

- Pulse **Máscara sub-red** e introduzca la dirección.

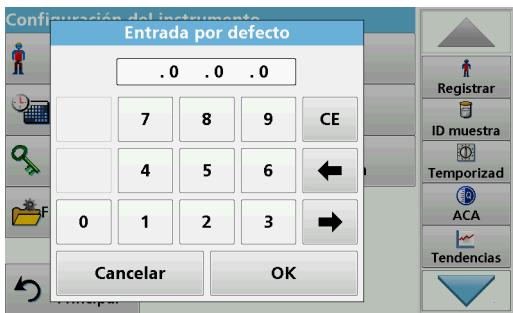

Un gateway permite la comunicación de datos en redes que se basan en diversos protocolos.

- Pulse **Entrada por defecto** e introduzca la dirección.
- Pulse **OK** para confirmar la introducción.



- Pulse **Servidor de red: <Apagado>** para determinar el lugar de destino para la transferencia de datos.

Programas estándar



- 11.** Seleccione **Unidad de red** y ejecute Configurar unidad de red.

Como alternativa, seleccione **FTP** y ejecute Configurar FTP. Los procedimientos son totalmente idénticos. A modo de ejemplo, aquí vamos a describir Configurar unidad de red.



El sitio de destino puede estar definido por una dirección IP o un nombre de servidor.

- 12.** Pulse **Dirección IP** e introduzca la dirección IP o seleccione **Nombre del servidor** e introduzca el nombre del servidor.



- 13.** Pulse **Carpeta de datos** e introduzca el nombre de la carpeta de destino.

Nota: Debe existir una carpeta con el nombre seleccionado en el sistema de destino. Asimismo, esta carpeta se debe compartir con el usuario utilizando la contraseña correspondiente.

- 14.** Pulse **OK** para confirmar la introducción.




El **usuario** y la **contraseña** deben ser idénticos a los del sistema de destino.

- 15.** Pulse **Usuario** e introduzca el nombre de usuario.

- 16.** Pulse **OK** para confirmar.


- 17.** Pulse **Contraseña** e introduzca la contraseña.

- 18.** Pulse **OK** para confirmar la introducción.

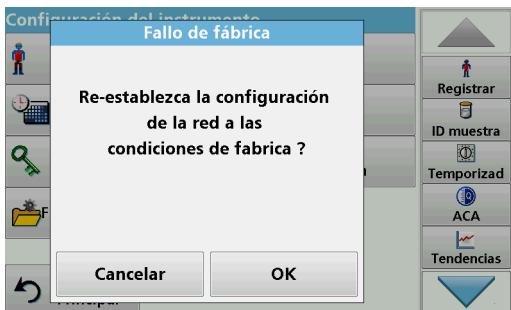


19. Pulse **Defecto de fábrica** para restablecer los valores por defecto de fábrica de la configuración de red.

5.2.8 Gestión de energía

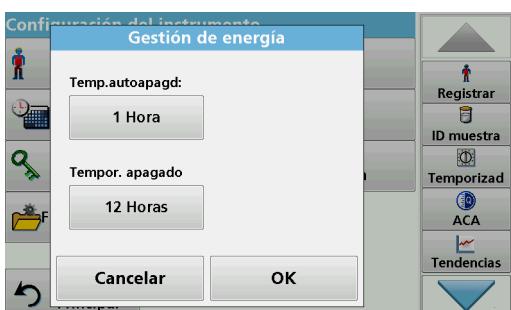

1. Pulse **Gestión de energía** en "Configuración del instrumento".
2. Seleccione **Temporizador de autoapagado** y pulse **OK**.

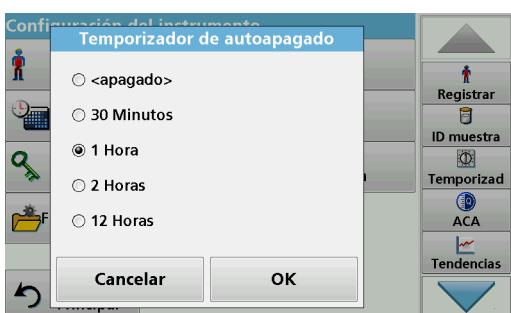

3. Seleccione el intervalo de tiempo deseado tras el cual el instrumento activará el modo de ahorro de energía si no se está utilizando (consulte [sección 4.4, página 24](#)) y confirme con **OK**.



4. Seleccione **Temporizador apagado** y pulse **OK**.
5. Seleccione el intervalo de tiempo deseado tras el cual el instrumento se apagará automáticamente si no se está utilizando y confirme con **OK**.
6. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

El instrumento regresa a "Configuración del instrumento".

5.3 Almacenamiento, recuperación, envío y borrado de datos

5.3.1 Registro de datos

En el registro de datos se pueden almacenar hasta 2000 mediciones que guardan los siguientes programas:

- Programas almacenados,
- Programas de códigos de barras,
- Programas del usuario,
- Favoritos,
- Longitud de onda única y
- Long. de onda múltiple.

Se memorizará un registro completo del análisis, que incluye fecha, hora, resultados, ID de la muestra e ID del usuario.

5.3.1.1 Almacenamiento de datos automático y manual

El parámetro de almacenamiento de datos indica si los datos se deben almacenar de forma automática o manual (en cuyo caso el usuario debe decidir los datos que va a almacenar).




1. Pulse **Ajuste del registro** en el menú "Configuración del instrumento".
 - Cuando se activa el ajuste **Auto memorizado: Encendido**, el instrumento almacena automáticamente todos los datos de las mediciones.
 - Cuando se activa el ajuste **Auto memorizado: Apagado**, el instrumento no almacena automáticamente ningún dato de las mediciones. Sin embargo, esta configuración puede cambiarse en la pantalla de resultados, a través de **Opciones>Almacenamiento automático: Encendido**. En ese momento, se almacenará la medición que aparece actualmente en la pantalla.
2. Especifique el formato de salida de los datos que se van a exportar utilizando **Formato envío datos**. Seleccione **xml** o **csv**.
3. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

El instrumento regresa a "Configuración del instrumento".

Nota: Cuando la memoria del instrumento (registro de datos) está llena, los datos más antiguos se borran automáticamente, lo que permite memorizar datos nuevos.

5.3.1.2 Recuperación de datos almacenados de un registro de datos

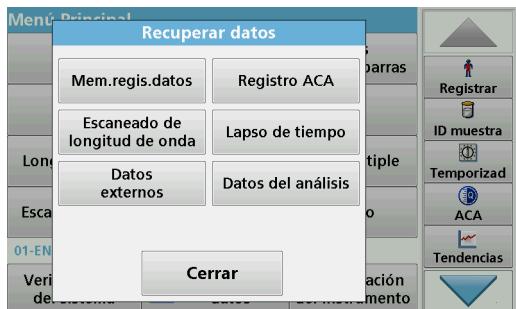


1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.



2. Pulse **Mem.regis.datos** .

Aparecerá un listado de los datos almacenados.

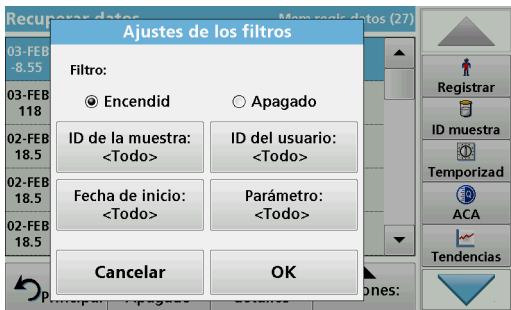

3. Pulse **Filtro: Encendido/Apagado**.

La función **Ajustes de los filtros** se utiliza para buscar elementos específicos.

4. Active **Encendido**. Ahora los datos se pueden filtrar utilizando los siguientes criterios de selección.

- ID de la muestra
- ID del usuario
- Fecha de inicio
- Parámetro

o cualquier combinación de los cuatro.

5. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Se enumerarán los elementos seleccionados.



6. Pulse **Ver detalles** para obtener más información.




5.3.1.3 Envío de datos del registro de datos

Los datos se envían desde el registro de datos interno como un archivo XML (Lenguaje de marcas extensible) o como un archivo CSV (Valor separado por comas) a un directorio con el nombre DataLog que se encuentra en un dispositivo de almacenamiento

Programas estándar

masivo USB o en una unidad de red. El archivo se puede procesar utilizando un programa de hojas de cálculo. El nombre de archivo tiene el formato:
DLAño-Mes-Día_Hora_Minuto_Segundo.csv o
DLAño-Mes-Día_Hora_Minuto_Segundo.xml.

Para enviar datos a una impresora, consulte [sección 5.2.7.2, página 39](#).

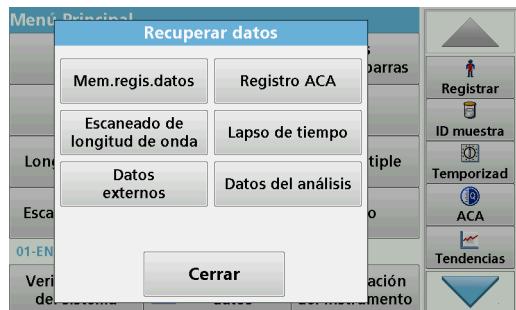


1. Enchufe el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB de tipo A en el DR3900, o conecte el DR3900 a una unidad de red (consulte [sección 5.2.7.4, página 40](#)).

2. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.

3. Seleccione la categoría de los datos que se van a transferir (por ejemplo, **Mem. regis. datos**). Aparecerá un listado de los datos de mediciones seleccionados.



4. Pulse **Opciones** y, a continuación, el icono **PC e Impresora**.

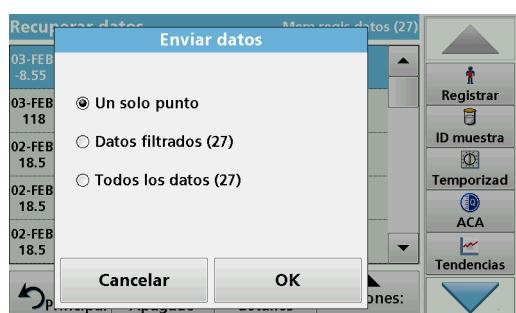

5. Seleccione los datos que se van a enviar. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Un solo punto:** sólo se enviará esta medición seleccionada
- **Datos filtrados:** sólo se enviarán las mediciones que se correspondan con los filtros definidos
- **Todos los datos:** se enviarán todos los datos de la categoría de datos seleccionada.

6. Pulse **OK** para confirmar.

Nota: El número que aparece entre paréntesis indica el número total de datos que fueron asignados a esta selección.


5.3.1.4 Eliminación de datos almacenados de un registro de datos



1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.
2. Pulse **Mem.regis.datos>Opciones>Borrar**.
3. Seleccione **Un solo punto, Datos filtrados o Todos los datos** y pulse **OK** para confirmar.

Nota: El número que aparece entre paréntesis indica el número total de datos que fueron asignados a esta selección.

5.3.2 Gráficos de control para datos del registro ACA

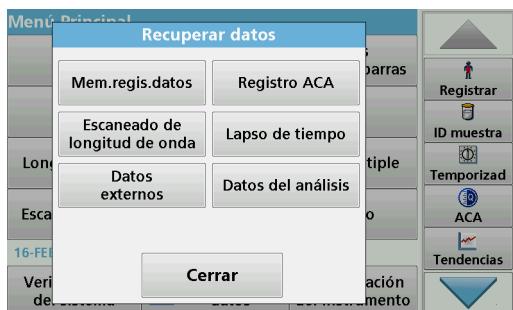


1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.



2. Pulse **Registro ACA**.

Aparecerá un listado de los datos almacenados.

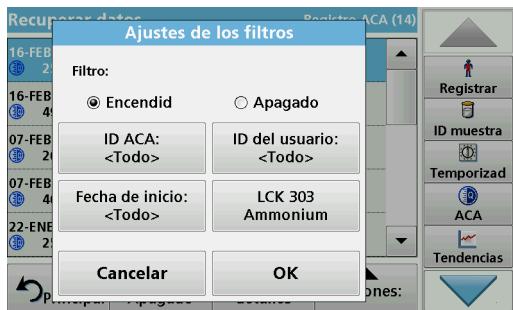

3. Pulse **Filtro: Encendido/Apagado**.
4. Active **Encendido**.
5. Seleccione el parámetro deseado.


Programas estándar




6. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Se enumerarán los elementos seleccionados.

7. Pulse **Opciones>Gráfico de control**.

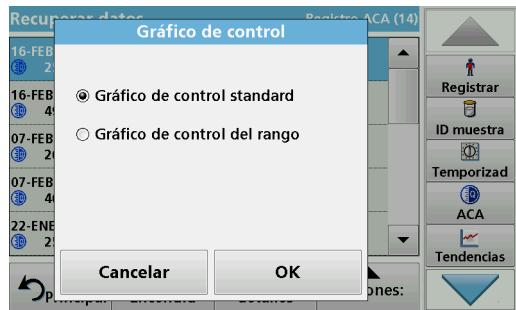


8. Pulse **Gráfico de control standard** para elegir el gráfico de control del patrón seleccionado.

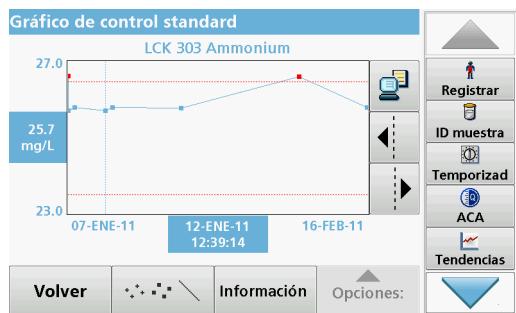

Las concentraciones de patrón medidas se muestran de manera gráfica con los límites de control y la fecha.



9. Pulse **Gráfico de control del rango** para seleccionar el gráfico de control del rango en porcentaje para las determinaciones múltiples.

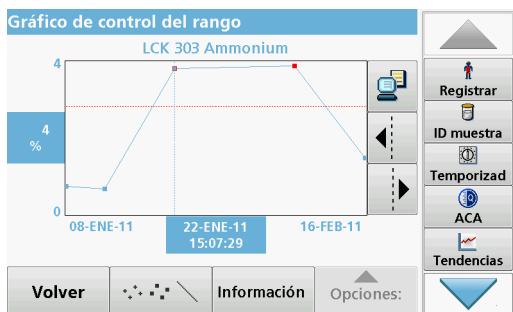

El rango en porcentaje se muestra de manera gráfica con los límites de control y la fecha.

5.3.3 Almacenamiento, recuperación, envío y eliminación de datos de barrido de longitud de onda y cinéticas en el tiempo

El instrumento puede almacenar 20 conjuntos de datos para el barrido de longitud de onda y otros 20 conjuntos de datos para las cinéticas en el tiempo. Los datos se deben almacenar manualmente después de ser mostrados.

5.3.3.1 Almacenamiento de datos de barrido de longitud de onda o cinéticas en el tiempo



1. Pulse el ícono Carpeta en el menú "Opciones" después de realizar una medición.



Aparecerá la lista Memorizar datos.

2. Pulse **Memorizar** para guardar el barrido actual en la línea numerada seleccionada.

Nota: Los barridos se pueden sobrescribir.


5.3.3.2 Recuperación de datos almacenados del barrido de longitud de onda y cinéticas en el

Programas estándar

tiempo



1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal.
 - a. Seleccione **Barrido de longitud de onda** o **Cinéticas en el tiempo** para recuperar los datos.
 - b. Si ya hay un programa ejecutándose, pulse **Opciones>Más>Recuperar datos**.
2. Seleccione los datos deseados.

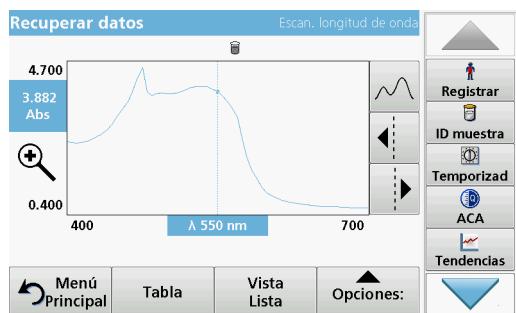

3. Pulse **Gráfico** para mostrar los detalles.

Nota: Pulse **Ver resumen** para volver a la lista "Recuperar datos".



4. Pulse **Tabla** para ver los detalles.

Nota: Pulse **Ver resumen** para volver a la lista "Recuperar datos".

5.3.3.3 Envío de datos de barrido de longitud de onda o cinéticas en el tiempo

Existen dos formas de recuperar datos enviados a una memoria USB, una impresora o un PC con Hach Data Trans.



Opción 1:

1. Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal y, a continuación, **Barrido de longitud de onda** o **Cinéticas en el tiempo**.
2. Pulse **Opciones** y, a continuación, el icono **PC e Impresora** para enviar los datos a una memoria USB, una impresora o un PC con Hach Data Trans.
 - Si hay una impresora conectada, seleccione el modo de enviarle los datos (gráfico, tabla o ambos).


- Si la memoria USB está conectada, los archivos se enviarán automáticamente a esta tarjeta como archivos xml o csv en la carpeta "WLData" (datos de un barrido de longitud de onda) o "TCData" (datos de una cinética en el tiempo).

El nombre del archivo se indicará como: "ScanData_X.csv" (datos de barrido de longitud de onda) o "TCData_X.csv" (datos de cinéticas en el tiempo).

X = número de barridos (1–20).

Para otros procesos, use un programa de hojas de cálculo.

Nota: Aparece el mensaje "Datos ya existentes. ¿Sobrescribir?" si los datos ya están almacenados. Pulse **OK** para sobrescribir los datos almacenados.

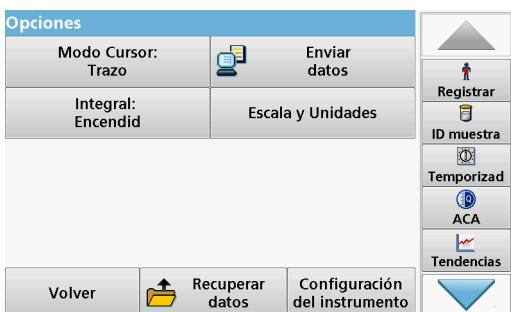

Opción 2:

- Pulse **Barrido de longitud de onda** o **Cinéticas en el tiempo** y, a continuación, **Opciones>Más>Enviar datos** para enviar los datos a la memoria USB o a la impresora.
 - Si hay una impresora conectada, seleccione el modo de enviarle los datos (gráfico, tabla o ambos).
 - Si la memoria USB está conectada, los archivos se enviarán automáticamente a esta tarjeta como archivos xml o csv en la carpeta "WLData" (datos de un barrido de longitud de onda) o "TCData" (datos de una cinética en el tiempo).

El nombre del archivo se indicará como: "ScanData_X.csv" (datos de barrido de longitud de onda) o "TCData_X.csv" (datos de cinéticas en el tiempo).

X = número de barridos (1–20).

Para otros procesos, use un programa de hojas de cálculo.

5.3.3.4 Eliminación de datos almacenados del barrido de longitud de onda y cinéticas en el tiempo



- Pulse **Recuperar datos** en el Menú Principal y, a continuación, **Barrido de longitud de onda** o **Cinéticas en el tiempo**.

Aparecerá un listado de los datos almacenados.

- Seleccione cualquier dato para su eliminación.
- Pulse **Borrar** en el menú "Opciones" y pulse **OK** para confirmar.

5.3.4 Análisis de datos

Es necesario utilizar la función de ID de muestra de una manera coherente para todas las funciones de análisis de datos. En estas funciones, sólo se pueden utilizar datos que tengan ID de muestra idénticos.


Programas estándar

Utilice la función **Tendencias** para ver una curva de variación en el tiempo de las mediciones almacenadas para cada parámetro y ubicación. La concentración del parámetro correspondiente se muestra de manera gráfica a lo largo del tiempo.

Utilice la función **Ratio** para supervisar las relaciones de los parámetros en una ubicación en particular y verlas en forma de gráfico.

Utilice la función **Chequeo de interferencias** para ver análisis con los mismos ID de muestra y niveles no favorables de **interferencias de iones**.


5.3.4.1 Tendencias

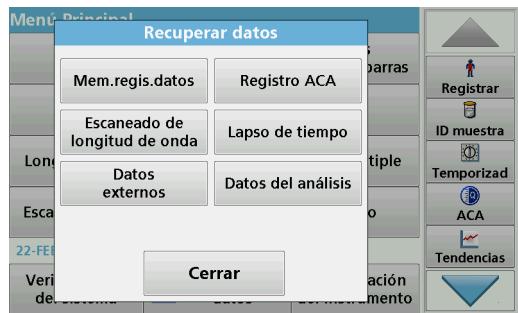

1. Pulse **Recuperar datos>Análisis de datos**.



2. Elija **Tendencias** y pulse **OK** para confirmar.
Como alternativa, seleccione **Tendencias** en la barra de herramientas.

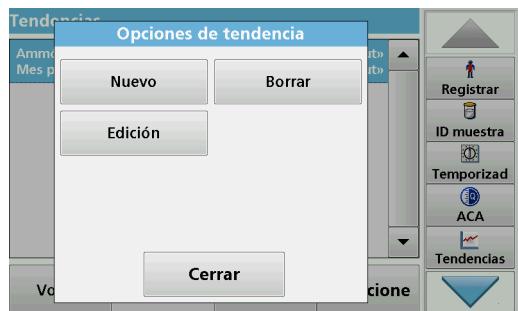

3. Pulse **Opciones>Nuevo**.




4. Seleccione el parámetro deseado y pulse **Siguiente** para confirmar.
5. Seleccione el ID de muestra deseado y pulse **Siguiente** para confirmar.
6. Seleccione el ID de usuario deseado y pulse **Siguiente** para confirmar.




7. Seleccione el intervalo de análisis de datos deseado o la fecha inicial y final, y pulse **Siguiente** para confirmar.



8. Defina un límite de control máximo y mínimo, y pulse **Siguiente** para confirmar.

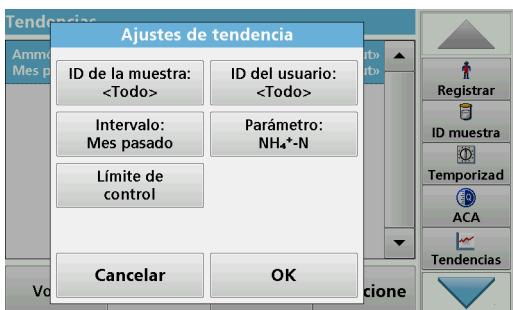

9. Todas las funciones seleccionadas se muestran en **Ajustes de tendencia**. Pulse **OK** para confirmar.
10. Seleccione la tendencia deseada con los ajustes creados en la lista. Pulse **Seleccionar**.




La tendencia se puede mostrar en varios formatos, como una línea o un punto.

11. Seleccione **Información** para ver un resumen de la información de los parámetros.
12. Seleccione **Opciones>Agregar datos** para agregar más lecturas a la tendencia.
13. Seleccione **Opciones>Índice:Apagado** para activar la función Índice.

El ratio se corresponde a la primera fila de mediciones seleccionada.

5.3.4.2 Ratios

La función Ratio se basa en la clasificación precisa de muestras por sus ubicaciones utilizando los accesorios opcionales "Localizador RFID LOC 100" y "Kit de identificación de muestras RFID". La ubicación precisa de la muestra, la fecha y la hora se adjuntan automáticamente. El análisis del ratio calcula un ratio entre dos o tres parámetros. El último parámetro definido está representado por 1. El primer y segundo parámetro se calculan como un ratio en función del mismo (por ejemplo, 4:2:1).

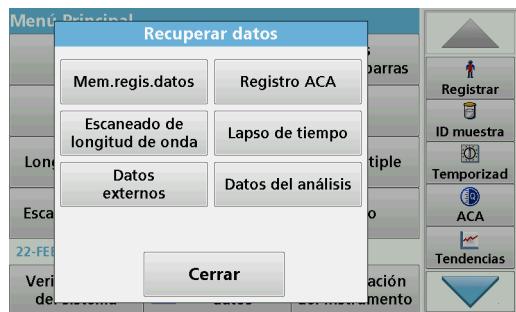

1. Seleccione **Recuperar datos>Análisis de datos**.



2. Seleccione **Ratios**.

Si ya se ha realizado un análisis de ratio, aparecerá una lista de los análisis definidos.

3. Pulse Opciones>Más.

4. Pulse Nuevo para definir un nuevo análisis de ratio.

5. Seleccione el ID de muestra deseado y pulse Siguiente para confirmar.

6. Seleccione el parámetro I que posea la mayor concentración y pulse Siguiente para confirmar.

Programas estándar



Parámetro II	
Ammonium	NH ₄ ⁺ -N
Chloride I	Cl ⁻
COD	COD
Phosphate Trace	PO ₄ ³⁻ -P
Nitrate	NO ₃ ⁻ -N
Aluminum	Al ³⁺

Botones: Cancelar, Atrás, Siguiente


7. Seleccione el parámetro II que posea la concentración media y pulse **Siguiente** para confirmar.



Parámetro III	
<apagado>	
Ammonium	NH ₄ ⁺ -N
Chloride I	Cl ⁻
COD	COD
Phosphate Trace	PO ₄ ³⁻ -P
Nitrate	NO ₃ ⁻ -N

Botones: Cancelar, Atrás, Siguiente

8. Seleccione el parámetro III que posea la menor concentración y pulse **Siguiente** para confirmar.

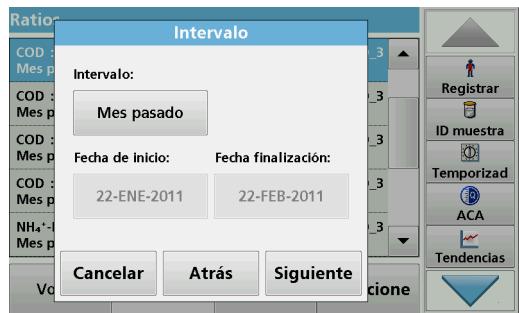

Intervalo:

Mes pasado

Fecha de inicio: 22-ENE-2011 Fecha finalización: 22-FEB-2011

Botones: Cancelar, Atrás, Siguiente

9. Seleccione el intervalo de análisis de datos deseado.

Es posible seleccionar un intervalo fijo y un intervalo personalizado específico con fechas de inicio y finalización.

10. Pulse **OK** para confirmar.



Límites de control


Encendido Apagado

Límite I ratio super: 15.0 Límite II ratio super: 27.0

Límite I ratio infer: 7.00 Límite II ratio infer: 15.0

Botones: Cancelar, Atrás, Siguiente

11. Elija un límite de control máximo y mínimo para los primeros y segundos parámetros y pulse **Siguiente** para confirmar.

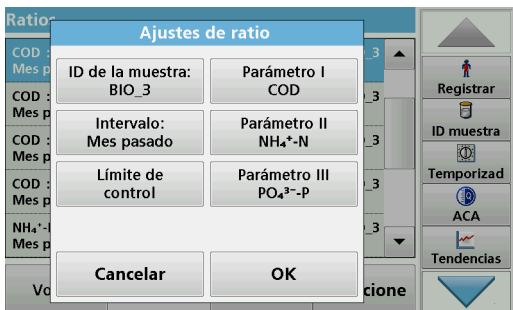

12. Todas las funciones seleccionadas se muestran en **Ajustes de ratio**. Pulse **OK** para confirmar.



13. Seleccione el ratio con los ajustes definidos en el directorio de ratio. Pulse **Seleccionar**.

Se muestra una tabla con los valores definidos.

Los valores fuera de los límites definidos se muestran en rojo.


5.3.4.3 Chequeo de interferencias (no disponible en todos los modelos)

El DR 3900 analiza automáticamente los iones de interferencia. Las interferencias típicas (por ejemplo, cloruro en nitrato) se reconocen a partir de concentraciones definidas y aparece una advertencia. Esta comprobación sólo se realiza para los test de códigos de barras que están indicados con ID de muestras idénticos.

Ejemplo:

Análisis de amonio con el test de código de barras LCK303 y grabación de las mediciones. De acuerdo con la tabla de interferencias de iones LCK303, los concentrados de nitrato > 50 mg/l interfieren con el análisis.

El instrumento muestra una advertencia si el mismo ID de muestra tiene un valor > 50 mg/l de nitrato.

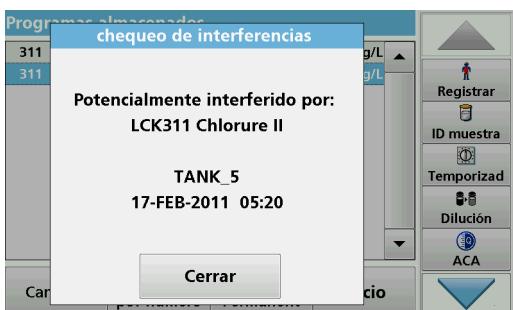

1. Seleccione **Recuperar datos>Análisis de datos>Chequeo de interferencias** para activar una verificación.

5.4 Programas almacenados

Es posible recuperar más de 200 procesos programados previamente mediante el menú **Programas almacenados**. El

menú **Programas almacenados** no incluye comprobaciones de códigos de barra.

5.4.1 Selección de un método o test almacenado; introducción de datos básicos específicos del usuario



1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal para visualizar una lista alfabética de los programas almacenados con números de programa.

Aparecerá la lista "Programas almacenados".

2. Seleccione el test adecuado.

Nota: Seleccione el programa por su nombre o desplácese por la lista utilizando las teclas de flecha. Marque el programa o seleccione **Seleccionar por número**. para buscar un número de programa específico. Pulse **OK** para confirmar.

3. Pulse **Inicio** para ejecutar el programa. Aparece la ventana de medición correspondiente.

Nota: Todos los datos correspondientes (longitud de onda, factores y constantes) ya están predeterminados.

4. Siga las instrucciones de procedimiento para manejo de productos químicos. Más información disponible en el sitio web del fabricante.

Nota: Para ver las instrucciones de los procedimientos en la pantalla, presione el ícono de información. Esta opción no está disponible para todas las comprobaciones.

5.4.2 Opciones de programas almacenados

1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal. Seleccione el proceso deseado y pulse **Inicio**.
2. Presione **Opciones** para ingresar los datos específicos. A continuación, se describen las opciones [Tabla 4](#).

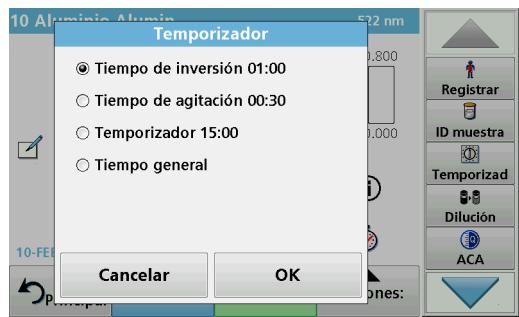


Tabla 4 Opciones de programas almacenados

Opciones	Descripción
Más	Para otras opciones
Memorizar: Encendido/Apagado	Con el ajuste Memorizar: Encendido , todos los datos de mediciones se memorizan de forma automática. Con el ajuste Memorizar: Apagado , no se almacenan dichos datos.
% Trans/Conc/Abs	Para cambiar a las lecturas de transmitancia (%), concentración o absorbancia.
Icono Enviar datos / Enviar datos	Para enviar datos a una impresora, unidad de red, PC o memoria USB (USB de tipo A o puerto Ethernet)
Icono del temporizador	Funciona como un cronómetro. Garantiza que las fases del análisis están correctamente calculadas (p. ej., se pueden especificar con exactitud los tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.). Cuando ha transcurrido el tiempo especificado, se emite un sonido. El uso del temporizador no influye en el programa de medición.
Factor de dilución: Encendido/Apagado	Se puede introducir un factor de dilución para tener en cuenta ciertas propiedades. El número introducido en el mensaje que solicita el factor de dilución se multiplicará por el resultado para compensar el ajuste. Por ejemplo, si la muestra se ha diluido por un factor de 2, ingrese 2. Se desactivará la configuración predeterminada del factor de dilución. Nota: Cuando hay una dilución en curso, la pantalla muestra el icono de dilución.
Adición de patrón	Esta opción permite verificar la exactitud de las mediciones. Las instrucciones de los procedimientos de los parámetros de prueba contienen una explicación detallada de la forma de utilizar esta función.
Ajuste del patrón	Las instrucciones de los procedimientos de los parámetros del test indican si es necesario un ajuste del patrón y, en ese caso, cómo proceder.
Fórmula química	Algunas de las pruebas y métodos almacenados permiten seleccionar la fórmula química y el rango de medida.
Blanco de reactivo	Algunos de los tests y métodos incluyen la función "Blanco de reactivo". Permite la adición o sustracción del valor de blanco de reactivo a las lecturas posteriores. El valor de blanco de reactivo cambia la curva de calibración en el eje y sin modificar la forma o pendiente de la curva. El efecto corresponde a un corte del eje y de la línea recta de calibración. Esto queda aclarado mediante la siguiente fórmula: concentración = [factor de conc. x Abs] - (blanco de reactivo)
Guardar como programa del usuario	Para almacenar los parámetros como un Programa del usuario, consulte sección 6.1, página 75 .
Determinación múltiple	Esta opción permite la determinación múltiple de una muestra.
Recuperar datos	Para recuperar datos de mediciones guardados o cinéticas en el tiempo, consulte sección 5.3, página 43 .
Modo Configuración del instrumento	Datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27 .

5.4.3 Uso de los temporizadores de programa

Algunas metodicas no necesitan el uso de temporizadores. Otras metodicas requieren varios temporizadores. Estos temporizadores están preprogramados en cada **Programa almacenado**, junto con una descripción de la actividad que se va a llevar a cabo durante el periodo prefijado.



1. Pulse el icono del **temporizador**.

2. Pulse **OK** para iniciar el temporizador.

El temporizador realizará una cuenta atrás en la pantalla.

3. Para comenzar la siguiente actividad prefijada para el Programa almacenado, pulse el icono del temporizador y **OK**.

Nota: Presione **Cerrar** para visualizar la pantalla de medición mientras el temporizador está funcionando. La hora se mostrará en la parte inferior izquierda en lugar de la fecha.

Nota: Pulse **Cancelar** para detener el temporizador a mitad de la cuenta atrás.


Nota: El temporizador emitirá una señal acústica cuando se haya alcanzado el tiempo prefijado.



También está disponible un temporizador para uso general en muchos programas. Toque el icono del temporizador y seleccione **Temporizador general**. Introduzca la duración del intervalo de tiempo y pulse **OK** para iniciar el temporizador. El temporizador emitirá una señal acústica cuando se haya alcanzado el tiempo prefijado.

5.4.4 Ajuste del factor de dilución

La función Factor de dilución se utiliza para calcular la concentración original de una muestra que se ha diluido con una proporción conocida.

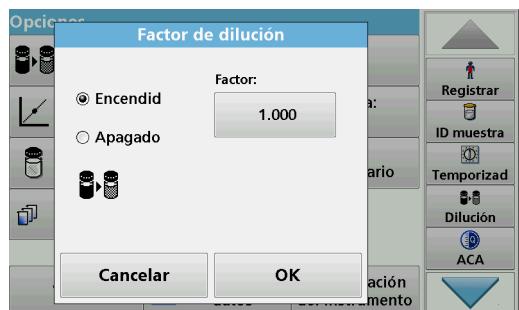


1. Pulse **Opciones>Más...>Factor de dilución**.

El número introducido en el mensaje que solicita el factor de dilución se multiplicará por el resultado para compensar el ajuste.

Por ejemplo, si la muestra se ha diluido por un factor de 2, introduzca 2. Se desactivará la configuración predeterminada del factor de dilución.

2. Pulse **OK** para confirmar. Pulse de nuevo **OK**.

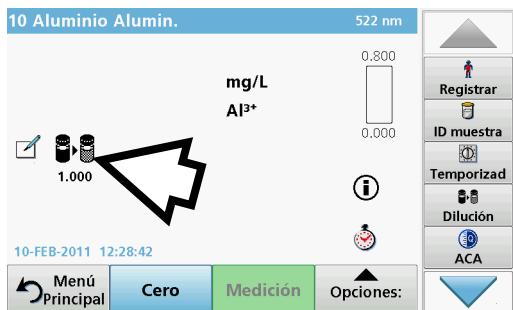


Nota: Cuando hay una dilución en curso, la pantalla muestra el ícono de dilución.

Nota: Si utiliza muestras sin diluir, vuelva a desactivar el factor de dilución.

5.4.5 Ejecución de un ajuste del patrón

La función Ajuste del patrón permite el ajuste de la curva de calibración para un programa almacenado en función del análisis de una solución patrón conocida. La sección Prueba de exactitud de las metódicas escritas a menudo sugiere una concentración de solución patrón para este propósito.

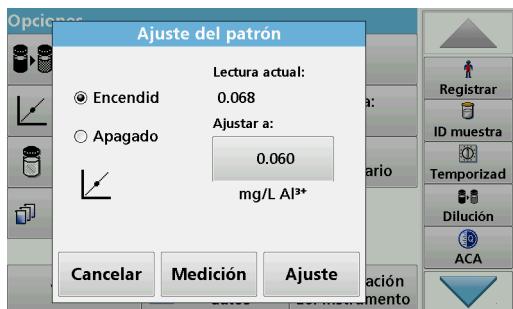

1. Siga la metódica completa con un patrón conocido para la muestra.
 2. Tras medir la concentración, pulse **Opciones>Más>Ajuste patrón**.
 3. Pulse **Encendido**.
- En "Lectura actual" aparecerá la concentración. La casilla de la derecha mostrará el valor predeterminado del patrón para el test, según se menciona en la metódica.
4. Para definir la concentración de patrón, pulse el botón e introduzca el nuevo valor. Pulse **OK** para confirmar.

5. Pulse **Ajuste** para activar el Ajuste del patrón. Aparecerá el ícono de Ajuste del patrón.

Nota: El ajuste debe encontrarse entre ciertos límites, que varían según el programa. El porcentaje de tolerancia se muestra en Ajuste.



5.4.6 Ajuste de la fórmula química


Algunos programas almacenados permiten seleccionar entre diversas fórmulas químicas.

Pulse la unidad (p. ej., mg/l) o la representación química de la fórmula de evaluación (p. ej., Al³⁺). Aparecerá una lista de fórmulas de evaluación disponibles. Seleccione la que desee pulsando la entrada correspondiente en la lista.

Nota: Al salir de un programa, el formulario de evaluación vuelve a la configuración estándar.

Programas estándar

5.4.6.1 Cambio de la configuración predeterminada de la fórmula química

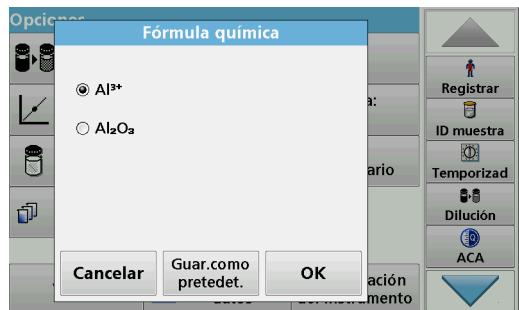

1. En la pantalla de resultados, pulse **Opciones>Más>Fórmula química**.
2. Aparecerá una lista de fórmulas de evaluación disponibles. Seleccione la nueva configuración predeterminada.
3. Pulse **Guardar como predet.**

El resultado actual y el resto de las medidas aparecerán en la nueva fórmula química.

5.4.7 Ejecución de un blanco de reactivo


Algunos de los tests y métodos incluyen la función "Blanco de reactivo". Esto permite que se mida el valor de blanco de reactivo y que se tome en cuenta en el cálculo del resultado de la medición.

Medición y análisis de un blanco de reactivo:

1. Prepare el test correspondiente a las especificaciones o instrucciones del procedimiento. Utilice agua destilada en lugar de una muestra para determinar el valor del blanco de reactivo.
2. Seleccione el test. Introduzca la solución cero en el compartimento de cubetas si así lo exigen las instrucciones del procedimiento. Pulse **Cero**.
3. Coloque la cubeta preparada dentro del compartimento portacubetas. Pulse **Medición**. Aparecerá el resultado.
4. Pulse **Opciones>Más>Blanco reactivo**.
5. Pulse **Encendido** para seleccionar la función Blanco de reactivo.
6. La concentración que aparece en el botón es la medición del blanco de reactivo. Si desea utilizar este valor para más análisis de este parámetro, pulse **OK**.
7. Para cambiar el valor mostrado en el botón, púlselo. Utilice el teclado alfanumérico para introducir el nuevo valor.
8. A continuación, pulse **OK**.

Nota: La función "Blanco de reactivo" se desactiva cuando se sale del programa de medición. Para utilizar el mismo valor de blanco de reactivo para otros test con el mismo lote de reactivos, introduzca el valor por el paso 7.


Nota: Los resultados calculados con el valor de blanco de reactivo deben encontrarse entre los límites del rango de medida del test o método.

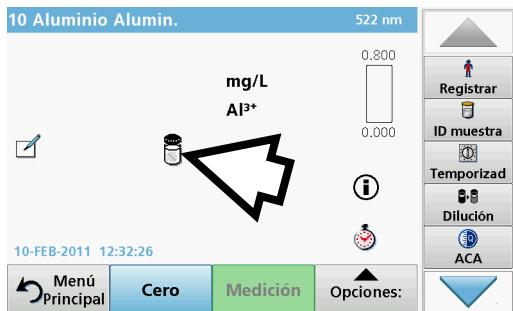

Nota: El ícono de blanco de reactivo aparece en la pantalla de resultados (véase flecha) cuando la función está activa.

5.4.8 Para realizar una determinación múltiple

Una muestra se puede medir varias veces utilizando las funciones de determinación múltiple.

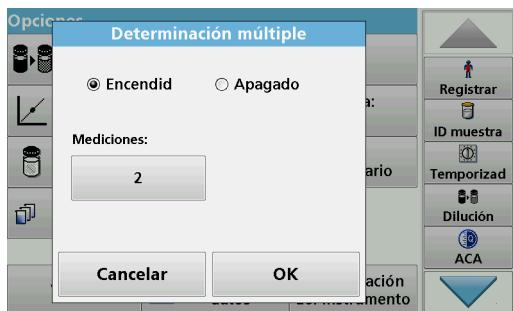

1. Antes de leer la concentración, pulse **Opciones>Más> Determinación múltiple**.
2. Pulse **Encendido**.
El número de determinaciones múltiples se muestra bajo "Mediciones".
3. Para cambiar el valor mostrado en el botón, púlselo. Utilice el teclado alfanumérico para introducir el nuevo valor. Pulse **OK** para confirmar.
4. El ícono de determinación múltiple aparece en la pantalla.



5.4.9 Análisis de muestras



1. Pulse **Programas almacenados** y seleccione un programa.
Nota: Si están disponibles, las instrucciones de procedimiento se indican en la pantalla a través del ícono de información.
2. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas.
3. Pulse **Cero**.



4. Saque la cubeta de solución cero del compartimento de la cubeta. Coloque la cubeta de muestra dentro del compartimento de cubetas.

5. Pulse **Medición**. Aparecerá el resultado.

Nota: Para definir una dilución simple, pulse la tecla **Dilución** en la barra de herramientas.

6. Para el almacenamiento de los datos, consulte sección 5.3.1, página 43.

5.4.10 Actualización/edición de test (no disponible en todos los modelos)

5.4.10.1 Consejos generales para actualizaciones y ediciones de programas

Para la actualización manual de test y la nueva programación de un test, consulte sección 5.4.10.2, página 64 y sección 5.4.10.3, página 65.

Nota: La modificación de un test requiere en muy pocos casos una actualización de las especificaciones del mismo.


Para actualizar y editar test de códigos de barras, consulte sección 5.5.5, página 69.

5.4.10.2 Actualización manual de datos de test

Al seleccionar un test, el instrumento ajusta de forma automática los factores y la longitud de onda de la medición.

Los tests se revisan continuamente para simplificar la manipulación y garantizar que cumplen los requisitos legales actuales. Esto puede llevar a cambios en las instrucciones del procedimiento o a una alteración de los factores. Si dicha alteración aparece indicada en el embalaje del test, actualice los datos del instrumento de acuerdo con los facilitados en las instrucciones del procedimiento incluidas dentro de dicho embalaje.

Para realizar actualizaciones desde Internet, consulte sección 5.5.5.4, página 73.



1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal y seleccione un programa.
2. Pulse **Opciones del programa** y, a continuación, **Edición**.



Aparecerá la lista de datos del test correspondiente.

El procedimiento del test correspondiente contiene los nuevos datos (longitud de onda, factores, rangos de medición, factor de conversión para la fórmula química, etc.).

3. Seleccione la línea que corresponda del resumen de datos y pulse **Edición**.
4. Pulse **OK** y, a continuación, **Memorizar** tras editar el test.

5.4.10.3 Programación de un nuevo test



1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal.
2. Pulse **Opciones del programa** y, a continuación, **Nuevo**.
3. Con el teclado alfanumérico, introduzca el número de programa que se indica en la metódica.

Se muestra un resumen de los datos del test que se va a programar.

El procedimiento del test correspondiente contiene los nuevos datos (longitud de onda, factores, rangos de medición, factor de conversión para la fórmula química, etc.).

4. Seleccione la línea que contenga la especificación del test que se ha de programar y, a continuación, pulse **Edición** e introduzca los datos en las líneas de programa adecuadas.
5. Pulse **OK** y, a continuación, **Memorizar** tras editar el test.

5.4.11 Adición de programas almacenados a la lista Programas Favoritos

El menú "Favoritos" simplifica la selección de pruebas al crear una lista de las pruebas más frecuentemente usadas de los Programas almacenados y los Programas del usuario.



1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal. Aparecerá la lista "Programas almacenados".
2. Seleccione el programa pulsándolo o eligiendo **Seleccionar por número** para buscarlo por número.
3. Pulse **Agregar a Favoritos** y pulse **OK** para confirmar.

El programa ya se puede seleccionar en el menú **"Programas Favoritos"** del Menú Principal.

5.5 Programas de códigos de barras


Un lector de código de barras especial en el compartimento de cubetas 1 lee automáticamente el código de barras de la cubeta/vial de 13 mm cuando ésta completa una rotación sencilla. El instrumento usa la identificación del código de barras para establecer automáticamente la longitud de onda correcta para el análisis y calcula el resultado de inmediato con la ayuda de los factores almacenados.

Asimismo, las mediciones se graban en diez posiciones distintas durante la rotación. Se ejecuta un programa de eliminación de valores extremos y, a continuación, se calcula la media de los valores medidos. Se detectan los errores y las contaminaciones de las cubetas y las cubetas redondas y, por lo tanto, se determina un resultado muy preciso.

5.5.1 Realizar una prueba del código de barras



1. Introduzca el protector de luz en el compartimento de cubetas (2).
2. Prepare la prueba de códigos de barra de acuerdo con la especificación de proceso e inserte la cubeta en el compartimiento de cubetas (1).
 - Cuando una cubeta codificada se ubica en el compartimiento de células #1 (Figura 3, página 19), el programa de lectura correspondiente se activa de forma automática en el menú Principal.

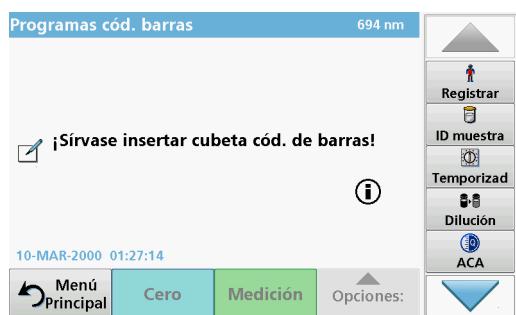

- Si no es así, pulse **Programas de códigos de barras** en el Menú Principal e introduzca una cubeta cero (dependiendo del procedimiento) en el compartimiento de cubetas (1).

Nota: Para obtener más información sobre la Guía de ayuda (ícono "Información"), consulte [Apéndice A, página 145](#).



La medición comienza automáticamente y se muestran los resultados.

Nota: Para definir una dilución simple, presione la tecla **Dilución** en la barra de herramientas.

Para evaluar otros test de cubetas y otros parámetros, introduzca la cubeta preparada en el compartimiento de cubetas y compruebe los resultados.

Nota: La barra de control que se muestra a la derecha de la pantalla muestra la relación del resultado de la lectura para el rango de medición. La barra negra muestra el resultado de la medición independientemente del factor de dilución introducido.

5.5.2 Selección de la fórmula de evaluación química


La fórmula química del resultado del test de varios parámetros se puede seleccionar de forma individual.

1. En la pantalla de resultados, pulse la unidad (p. ej., mg/l) o la representación química de la fórmula de evaluación (p. ej., PO₄³⁻-P).

Aparecerá una lista de fórmulas de evaluación disponibles.

2. Seleccione la fórmula deseada en la lista. Pulse **OK** para confirmar.

Otra forma de cambiar el ajuste estándar consiste en los siguientes pasos:

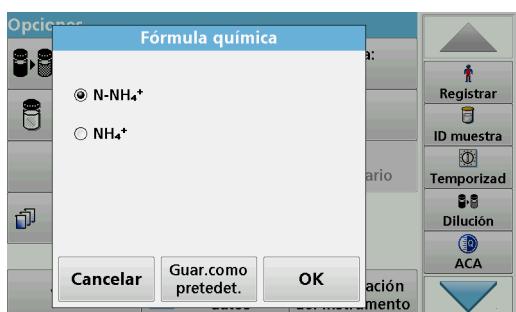

1. En la pantalla de resultado, pulse **Opciones>Más>Fórmula química**.

Aparecerá una lista de fórmulas de evaluación disponibles.

2. Seleccione la fórmula química y pulse **OK** para confirmar.

Nota: Aparecerá la fórmula química seleccionada, pero no pasará a ser la predeterminada. Para cambiar el valor por defecto, consulte sección 5.5.2.1.

5.5.2.1 Cambio de la configuración predeterminada de la fórmula química

1. Introduzca la cubeta cero o la cubeta de muestra (correspondiente al procedimiento) en el compartimento de cubetas.
2. En la pantalla de resultado, pulse **Opciones>Más>Fórmula química**.
3. Aparecerá una lista de fórmulas de evaluación disponibles. Seleccione la nueva configuración predeterminada.
4. Pulse **Guardar como predet..**

El resultado actual y el resto de las medidas aparecerán en la nueva fórmula química.

5.5.3 Ajustes de datos específicos de la muestra y del test

Pulse **Opciones** para cambiar los ajustes específicos del test o la muestra.

Programas estándar



Tabla 5 Opciones de programas de código de barras

Opciones	Descripción
Más	Para otras opciones
Memorizar: Encendido/Apagado	Memorizar: Encendido almacena automáticamente todos los datos de las mediciones Memorizar: Apagado no almacena ningún dato de las mediciones.
Abs % Trans	Para cambiar a las lecturas de transmitancia (%) o absorbancia
Icono Enviar datos / Enviar datos	Para enviar datos a una impresora, equipo o dispositivo de memoria USB (USB A) o red.
Icono del temporizador	Funciona como un cronómetro. Garantiza que las fases del análisis están correctamente calculadas (p. ej., se pueden especificar con exactitud los tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.). Cuando ha transcurrido el tiempo especificado, se emite un sonido. El uso del temporizador no influye en el programa de medición.
Factor de dilución: Encendido/Apagado	Se puede introducir un factor de dilución para tener en cuenta ciertas propiedades. El número introducido en el mensaje que solicita el factor de dilución se multiplicará por el resultado para compensar el ajuste. Por ejemplo, si la muestra se ha diluido por un factor de 2, ingrese 2. Se desactivará la configuración predeterminada del factor de dilución. Nota: Cuando hay una dilución en curso, la pantalla muestra el icono de dilución. Nota: Si se utilizan muestras no diluidas, ajuste el factor de dilución en Apagado.
Fórmula química	Algunas de las pruebas y métodos almacenados permiten seleccionar la fórmula química y el rango de medida.
Blanco de reactivo	La función "Blanco de reactivo" está disponible para varios test de códigos de barras. Permite la adición o sustracción del valor de blanco de reactivo a las lecturas posteriores. El valor de blanco de reactivo cambia la curva de calibración en el eje y sin modificar la forma o pendiente de la curva. El efecto corresponde a un corte del eje y de la línea recta de calibración. Esto queda aclarado mediante la siguiente fórmula: concentración = [factor de conc. * Abs] - (blanco de reactivo)
Edición	Para modificar un programa existente.
Información de lote	Aquí se almacenan todos los datos de fabricación relevantes.
Guardar como programa del usuario	Para almacenar los parámetros como un Programa del usuario, consulte sección 6.1, página 75 .
Determinación múltiple	Esta opción permite la determinación múltiple de una muestra.
Recuperación de datos de mediciones	Recuperación de datos de mediciones guardados, barridos de longitudes de onda o cinéticas en el tiempo, véase sección 5.3, página 43 .
Modo Configuración del instrumento	Para ver los datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27 .

5.5.4 Blanco de la muestra



La turbidez y color de la matriz de muestra pueden falsear los resultados de un análisis fotométrico. Los factores de interferencia provienen de la muestra o se crean por reacciones con los reactivos.

La influencia de la turbidez o el color se puede eliminar o reducir tomando una medición del blanco de la muestra.

Una vez realizada la medición de la muestra, se introduce en el compartimento de cubetas una cubeta especial (LCW919) con el blanco de muestra. La medición es automática. El valor de la medida de la muestra se corrige mediante la suma o resta del valor en blanco. El resultado aparece en pantalla con el icono de corrección de blanco.

Algunos test de códigos de barras no requieren la determinación de un valor de blanco de muestra, ya que la turbidez y el color se tratan durante el procedimiento del test.

Nota: Para obtener más información sobre la Guía de ayuda (ícono "Información"), consulte [Apéndice A, página 145](#).

5.5.5 Actualización y edición de tests de código de barras

5.5.5.1 Actualización de test de códigos de barras con el embalaje del test (no disponible en todos los modelos)

Con los datos suministrados en el código de barras, el instrumento ajusta de forma automática los factores y la longitud de onda de la medición. Si se detecta una desviación en los datos del código de barras con respecto a los datos almacenados, será necesario realizar una actualización de datos en el instrumento y se mostrará el mensaje de error "¿Nº control de cód. barras? ¡Actualice datos del programa!" .



1. Coloque el embalaje del test de códigos de barras con el símbolo RFID frente al módulo RFID del instrumento. Un sonido indica que la transferencia de datos se ha realizado correctamente; el test se evalúa automáticamente.



Si el embalaje se coloca frente al módulo RFID por segunda vez, en la pantalla aparece la información de lote actual del test. A continuación, se puede realizar el test de acuerdo con el procedimiento.


5.5.5.2 Actualización manual de un test de código de barras

Nota: La modificación de un test requiere en muy pocos casos una actualización de las especificaciones del mismo.

Los diversos tipos de datos que determinan un test de código de barras se describen en [Tabla 6](#).

Tabla 6 Opciones de actualización de programas

Punto del programa	Descripción
Nombre	Nombre del parámetro de análisis
Versión	Aquí se introduce una abreviatura asignada por el usuario, el número de versión, etc.
Proceso de medida	Definición exacta del test: El número de longitudes de onda en las que se realizan las mediciones, el número de mediciones de absorbancia necesarias, las teclas que se deben utilizar, cualquier periodo de espera entre mediciones, etc.
Fórmula	Definición de las fórmulas de evaluación con las que se calcula el resultado del análisis
Variables	El número de variables que aparecen en la pantalla depende de la definición del proceso de medida y las fórmulas. Introducción de los valores numéricos de las longitudes de onda, factores, constantes, etc.
Temporizador 1, Temporizador 2, Temporizador 3, Temporizador 4	Esta función se puede emplear para introducir abreviaturas y tiempos definidos para hasta cuatro temporizadores. Seleccione la línea pertinente en el resumen de datos y pulse Edición . Los temporizadores se activan o desactivan con las casillas de verificación situadas en el lado izquierdo de la pantalla. En la columna siguiente se pueden seleccionar, en una lista, los nombres que describen el procedimiento correspondiente. En la tercera columna se introducen los tiempos correspondientes a cada temporizador activo.

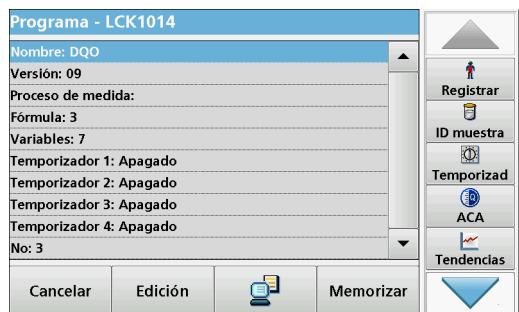

Introducción del nombre

Compruebe previamente el procedimiento para determinar si en efecto hace falta cambiar este punto.

1. Seleccione la línea de **Nombre** y pulse **Edición**. Con el teclado alfanumérico, introduzca el nombre que se indica en el procedimiento.
2. Pulse **OK** para confirmar.

Nombre: LCK101A
Versión: 09
Proceso: abc ABC DEF GHI CE
Fórmula: #% JKL MNO PQR ←
Variable: 123 STU VWX YZ →
Tempo: No: 3
Cancelar OK

Introducción de la versión

1. Seleccione la línea de **Versión** y pulse **Edición**. Con el teclado alfanumérico, introduzca el nombre que se indica en el procedimiento.
2. Pulse **OK** para confirmar.

Nombre: LCK101A
Versión: R1.006
Proceso: Registrar
Fórmula: ID muestra
Variable: Temporizad
Tempo: ACA
Tempo: Tendencias
Tempo: No: 3
Cancelar Edición OK

Introducción del proceso de medida

Para obtener información detallada sobre la introducción del proceso de medida, consulte [sección 6.1.2, página 85](#).

Compruebe previamente el procedimiento para determinar si en efecto hace falta cambiar este punto.

1. Seleccione la línea **Proceso de medida** en el resumen de datos y pulse **Edición**.
2. Presione **Edición**, seleccione la secuencia que se debe editar y presione **Borrar**.
3. Pulse **Nuevo** y, con el teclado alfanumérico, introduzca el proceso que se indica en el procedimiento.

Nombre: LCK101A
Versión: Fórmula
Proceso: Registrar
Fórmula: ID muestra
Variable: Temporizad
Tempo: ACA
Tempo: Tendencias
Tempo: No: 3
Cancelar Edición OK

Introducción de la fórmula, las unidades de concentración, la denominación, los rangos de medición

Para obtener información detallada sobre la introducción de la fórmula, consulte [sección 6.1.2, página 85](#).

Compruebe previamente el procedimiento para determinar si en efecto hace falta cambiar esta información.

1. Seleccione la línea **Fórmula** en el resumen de datos y pulse **Edición**.
2. Seleccione la fórmula; pulse **Edición** e introduzca los datos (consulte el procedimiento) (para C1=, C2=, unidades, nombre, límites del rango de medida, etc.). Pulse **OK** para confirmar la introducción.

Nombre: LCK101A
Versión: Variables
Proceso: Registrar
Fórmula: ID muestra
Variable: Temporizad
Tempo: ACA
Tempo: Tendencias
Tempo: No: 3
Cancelar Edición OK

Introducción de las variables (factores, longitud de onda y factores de conversión)

Para obtener información detallada sobre la introducción de las variables, consulte [sección 6.1.2, página 85](#).

Compruebe previamente el procedimiento para determinar si en efecto hace falta cambiar este punto.

1. Seleccione la línea **Variables** del resumen de datos y pulse **Edición**.

Programas estándar

2. Seleccione la variable, pulse **Edición** e ingrese los datos (consulte la especificación del proceso) con el teclado alfanumérico (para F1, F2, λ 1, U1 etc.). Confirme cada introducción pulsando **OK**.

Abreviaturas de las variables:

F1: Factor 1

F2: Factor 2

λ1: Longitud de onda 1

U1: Factor de conversión 1 para la primera fórmula química

U2: Factor de conversión 2 para fórmulas químicas adicionales, etc.




Temporizador 1, Temporizador 2, Temporizador 3, Temporizador 4:

Los temporizadores se activan o desactivan con las casillas de verificación situadas en el lado izquierdo de la pantalla. En la columna siguiente se pueden seleccionar, en una lista, los nombres que describen el procedimiento correspondiente. En la tercera columna se introducen los tiempos correspondientes a cada temporizador activo.

3. Cuando haya terminado la programación, pulse **Memorizar** y, a continuación, **Cancelar** para volver al menú "Programas del usuario".
4. Pulse **Inicio** para iniciar el test con los nuevos datos.

5.5.5.3 Comprobación/revisión manual de los datos de un test

Si, durante la actualización de los datos, se introdujo algún dato inexacto (p. ej., un rango de medida incorrecto) y éste no es reconocido mediante el código de barras de la cubeta, existe otra posibilidad para comprobar los datos del test y, si fuera necesario, modificarlos.

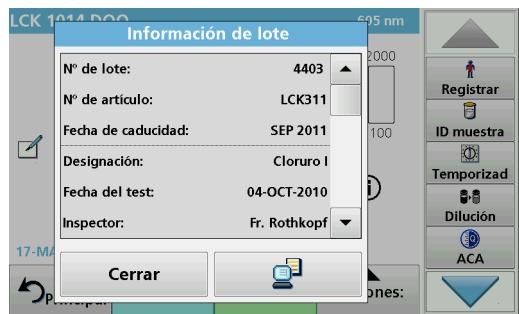

1. Introduzca el protector de luz en el compartimento de cubetas 2.

El instrumento tiene que estar en el "Menú Principal". Como alternativa, seleccione **Programas cód. barras** en el **Menú Principal**.

2. Introduzca la cubeta cero o la cubeta de muestra (correspondiente al procedimiento) en el compartimento de cubetas (1).
3. Pulse **Opciones>Más>Editar**.


En pantalla aparecerá un resumen de datos con las especificaciones del test que se va a modificar.

4. Compare los datos visualizados con los datos indicados en el procedimiento y cámbielos de acuerdo con la información proporcionada en el procedimiento.

5.5.5.4 Actualización a través de Internet

Actualización por medio de una memoria USB

Para obtener el software para la actualización a través de Internet en www.hach-lange.com:

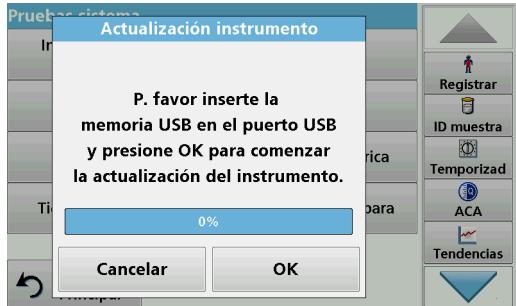

1. Visite <http://www.hach-lange.com>.
2. Seleccione el país y vaya a **Descargar>Software**.
3. Escriba **DR 3900** en "Búsqueda de documentos".
4. Desplácese al correspondiente archivo para descargar.
5. Abra el archivo ZIP y guarde los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB o en la PC. Los archivos deben descomprimirse antes de ser guardados en el dispositivo de almacenamiento masivo USB o en la PC.
6. Pulse **Actualización instrumento** en el menú "Pruebas del sistema".
7. Conectar la memoria USB al puerto USB (tipo A) del instrumento, consulte [sección 3.5, página 18](#).
8. Pulse **OK**. La conexión se establece automáticamente y se actualiza el software.
9. Pulse **OK** para volver al menú "Pruebas del sistema".

Actualización por medio de la función web

1. Conecte el instrumento a la red por medio de un cable Ethernet.
 2. Active la conexión a Internet seleccionando **Configuración del instrumento>PC e impresora**([sección 5.2.7.4, página 40](#)).
 3. Pulse **Función web** en la barra de herramientas.
 4. Pulse **Actualización instrumento**.
- La actualización se iniciará automáticamente.


Nota: Cuando el software del instrumento se haya actualizado, aparecerá un mensaje que solicita el reinicio del instrumento.



5.5.5.5 Programación de un nuevo test

1. El instrumento debe estar en el "Menú Principal" o pulse **Programas cód. barras** en dicho menú.
2. Introduzca la cubeta cero o la cubeta de muestra (correspondiente al procedimiento) en el compartimento de cubetas.

Programas estándar

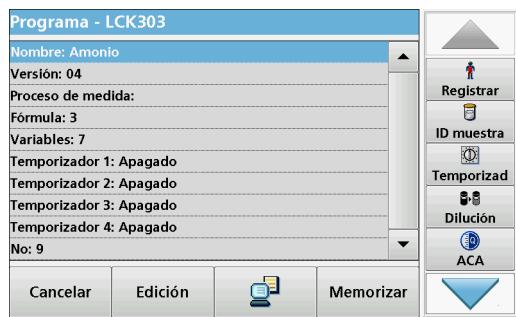

Aparece el mensaje "Programa no disponible", seguido de un resumen de los datos con las especificaciones del test que se va a revisar.

El procedimiento del test correspondiente contiene los nuevos datos (longitud de onda, factores, rangos de medición, factor de conversión para la fórmula química, etc.).

3. Seleccione las líneas que contienen las especificaciones del test a programar y pulse **Edición**.
4. Para finalizar la programación, pulse **Memorizar** y, a continuación, **Cancelar** para volver al Menú Principal.
5. Pulse **Inicio** para iniciar el test con los nuevos datos.

Sección 6 Programas avanzados

6.1 Programas del usuario

Los programas del usuario ofrecen la posibilidad de realizar análisis personalizados.

La base de datos "Programas del usuario" está vacía en el momento de la expedición del instrumento de fábrica y se utiliza para alojar los programas creados por el usuario según sus propias necesidades. Los programas del usuario con cubetas redondas de 13 mm sólo se pueden utilizar con las cubetas vacías LCW906. Éstos son ejemplos de algunas posibilidades de introducción:

- Programación de procedimientos propios del usuario. Para poder programar el procedimiento de análisis, primero hay que desarrollarlo. El usuario debe definir o determinar las secuencias del programa, las fórmulas de absorbancia, las longitudes de onda de medición, los factores, los límites de los rangos de medida, etc.
 - Tests modificados
 - Asignación de programas del usuario al menú "Favoritos", que contiene los test que se utilizan con más frecuencia.
 - Creación de una selección específica de métodos y tests.
1. Seleccione **Programas del usuario** en "Menú Principal"
 2. Seleccione **Opciones del programa**.

El menú **Opciones del programa** contiene las siguientes opciones de introducción y edición ([Tabla 7](#)):



Tabla 7 Opciones del programa para programas del usuario

Opciones	Descripción
Nuevo	Seleccione Nuevo cuando desee programar un nuevo Programa del usuario. Nota: Cuando se selecciona Opciones del programa por primera vez, sólo está disponible la opción Nuevo . Las demás opciones permanecen inactivas (aparecen en gris) hasta que se ha creado el primer programa.
Agregar a Favoritos	Seleccione Agregar a Favoritos para agregar un programa del usuario existente a la lista Favoritos.
Edición	Pulse Edición para modificar un programa existente.
Borrar	Pulse Borrar para eliminar un programa de la lista de programas del usuario. Este programa se borrará también de la lista de favoritos.

6.1.1 Programación de un método de usuario

Todas las fases de introducción y su importancia y opciones se explican en las siguientes secciones.

1. Seleccione **Nuevo** en el menú "Opciones del programa".



Número del programa:

El número de programa es un número específico de la prueba, mediante el cual se puede recuperar posteriormente el programa de la lista de selección en el menú **Programas del usuario** o en el menú **Favoritos**.


2. Con el teclado alfanumérico, introduzca un número de programa entre 9000 y 9099. Aparecerá automáticamente el número más bajo disponible.
3. Pulse **OK**.

Nota: Si un número de programa ya se ha asignado a otro programa del usuario, aparece un mensaje que le pregunta si desea sustituir el programa actual. Si pulsa **OK**, el programa existente se sobrescribe.



Nombre del programa:

4. Con el teclado alfanumérico, introduzca un nombre de programa. La longitud máxima del nombre deberá ser de 28 caracteres.
5. Presione **Atrás** para volver al punto anterior del programa o **Siguiente** para continuar con el ingreso de los datos del programa.

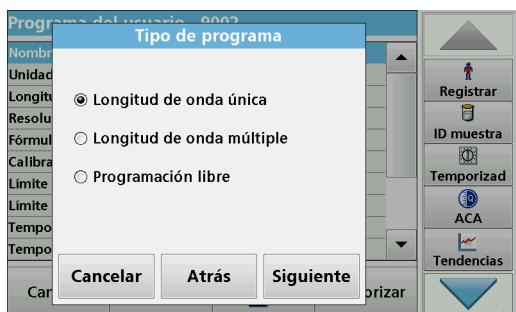

Tipo de programa:

6. Seleccione el tipo de programa que desee ([Tabla 8](#)) y pulse **Siguiente**.
7. Si se seleccionan las opciones **Longitud de onda única** ([sección 6.1.1.1, página 77](#)) o **Longitud de onda múltiple** ([sección 6.1.1.2, página 78](#)), defina los parámetros de programación:
 - Unidad
 - Longitud de onda
 - Fórmula de cálculo
 - Longitud de onda λ_x
 - Factor de concentración K_x
 - Solución de la concentración
 - Fórmula química
 - Ecuación de calibración

Para obtener más información acerca de los parámetros de programación libres, consulte [sección 6.1.2, página 85](#).

Tabla 8 Descripciones del programa

Tipo de programa	Descripción
Longitud de onda única	Mediciones en una longitud de onda definida
Long. de onda múltiple	En este modo los valores de absorbancia se pueden medir en hasta cuatro longitudes de onda y los resultados se pueden procesar matemáticamente para obtener sumas, diferencias y relaciones.
Programación libre	El alto nivel de flexibilidad da lugar a opciones individuales para crear un programa de usuario. La programación libre es una forma avanzada de test o programación de métodos.

6.1.1.1 Configuración de Longitud de onda única

Se pueden definir los siguientes parámetros al seleccionar el modo de longitud de onda único:

Unidades:

1. Seleccione la unidad deseada de la lista
2. Presione **Continuar**.

Nota: Es posible agregar unidades de medición que no estén incluidas en esta lista mediante el programa de edición en **Opciones del programa, Edición**. Seleccione **Unidades, Edición** y, a continuación, **Nuevo**.

Longitud de onda (tipo de programa Longitud de onda única):

1. Introduzca la longitud de onda medida.

La longitud de onda introducida debe estar en el rango que abarca de 320–1100 nm.

2. Pulse **Continuar**.

Resolución de la concentración (número de posiciones decimales)

1. Seleccione el número de posiciones decimales deseado que se va a mostrar después de la coma decimal en la lista.
2. Pulse **Continuar**.

Fórmula química:

1. Introduzca la fórmula química utilizada en la pantalla para representar el parámetro de análisis.
2. Pulse **Continuar**.

6.1.1.2 Configuración de Longitud de onda múltiple

Al seleccionar el modo Longitud de onda múltiple, se pueden definir los siguientes parámetros:

Unidades:

1. Seleccione la unidad deseada de la lista
2. Presione **Continuar**.

*Nota: Las unidades específicas del usuario que no estén incluidas en esta lista se pueden agregar mediante el programa de edición, en **Opciones del programa, Edición**. Seleccione **Unidades, Edición** y, a continuación, **Nuevo**.*

Fórmula de absorbancia (tipo de programa Long. de onda múltiple):

Defina las longitudes de onda y los coeficientes utilizados en la fórmula. La fórmula de absorbancia define el cálculo para la medición de la longitud de onda múltiple.

1. Pulse **Fórmula**.
2. Seleccione la fórmula que corresponda a la programación en la lista.
3. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Lista de fórmulas de absorbancia disponibles

A_1 es la absorbancia en la longitud de onda 1,

A_2 es la absorbancia en la longitud de onda 2, y así sucesivamente

K_1 es el factor en la longitud de onda 1,

K_2 es el factor en la longitud de onda 2, y así sucesivamente

En el caso de que se tenga que realizar una resta, los factores se pueden introducir con el signo "menos".

Longitud de onda λ_x :

1. Pulse los botones λ_x .

La fórmula de cálculo da el número de longitudes de onda.

2. Introduzca las longitudes de onda deseadas.

3. Si fuera necesario, repita esta operación hasta que haya introducido todos los valores para la fórmula.

La longitud de onda ingresada debe estar en el rango de 320–1100 nm.

4. Pulse **OK** para confirmar.

Factor de concentración K_x

El factor de concentración K_x es un factor de multiplicación que sirve para convertir los valores de absorbancia en valores de concentración.

1. Pulse los botones K_x .

La fórmula de cálculo da el número de factores de concentración.

2. Introduzca el factor deseado.

3. Si fuera necesario, repita esta operación hasta que haya introducido todos los valores para la fórmula.

4. Pulse **OK** para confirmar.

5. Pulse **Continuar**.

Nota: Se pueden introducir valores de hasta 5 dígitos. Es posible utilizar hasta 4 posiciones decimales.

Resolución de la concentración (número de posiciones decimales)

1. Seleccione el número de posiciones decimales deseado que se va a mostrar después de la coma decimal en la lista.

2. Pulse **Continuar**.

Fórmula química:

1. Introduzca la fórmula química utilizada en la pantalla para representar el parámetro de análisis.

2. Pulse **Continuar**.

Programas avanzados

6.1.1.3 Configuración de la calibración para modos de longitud de onda única y múltiple


Para calibrar un método se determinan los valores de absorbancia de varias soluciones patrón de concentración conocida.

Para crear y guardar una curva de calibración, introduzca **valores, patrones de medición o fórmulas** ([Tabla 9](#)).

Tabla 9 Configuración de calibración

Opción	Descripción
Introducir valores	Para crear una tabla de calibración, introduzca los valores de concentración y los valores de absorbancia correspondientes de las soluciones patrón que se van a medir. Los valores de absorbancia se aplican en un diagrama con respecto a las concentraciones de las soluciones patrón. La curva de calibración se presenta de forma gráfica (página 80).
Medir patrones	Para crear una tabla de calibración, introduzca los valores de concentración de las soluciones patrón que se van a medir y, a continuación, determine los valores de absorbancia correspondientes midiendo las soluciones patrón. Los valores de absorbancia se aplican en un diagrama con respecto a las concentraciones de las soluciones patrón. La curva de calibración se presenta de forma gráfica (página 81).
Introducir fórmula	Si es posible determinar la curva de calibración a partir de la relación matemática entre la concentración y la absorbancia a través de la regresión lineal u otra adaptación de la curva, la fórmula correspondiente (lineal, polinómica de 2º o 3º orden) se puede seleccionar en una lista y se pueden introducir los factores correspondientes (página 83).

Calibración por "Introducir valores"

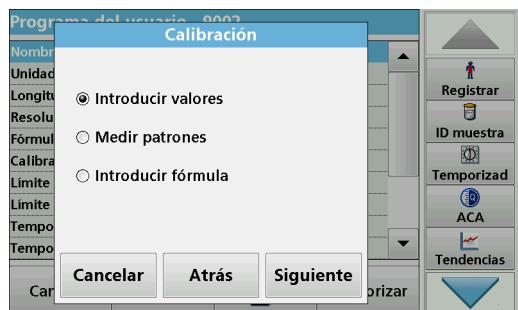

1. Seleccione **Introducir valores**.

2. Pulse **Continuar**.



3. Pulse **+**.

4. Introduzca la concentración estándar.


5. Pulse **OK** para confirmar.

6. Introduzca el valor de absorbancia correspondiente.

7. Pulse **OK** para confirmar.

8. Si fuera necesario, repita esta operación hasta que haya introducido todos los valores.

Nota: Para cambiar un valor de la tabla, marque la fila correspondiente. Pulse la tecla de la unidad (por ejemplo, **mg/l**) o **Ext.** Introduzca el valor cambiado.

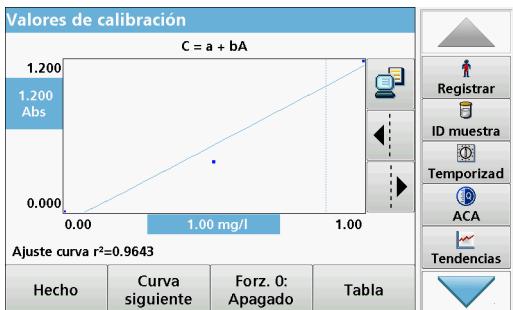

9. Pulse **Gráfico**.

Los datos introducidos se muestran como una curva de calibración.

Nota: El coeficiente de correlación (r^2) se indica a la izquierda, debajo del sistema de ejes.

La curva lineal corresponde al ajuste de patrón.

10. Pulse **Siguiente gráfico**.

La presentación cambia a la curva polinómica del segundo orden.

11. Pulse **Siguiente gráfico**.

La presentación cambia a la curva polinómica del tercer orden.

12. Pulse **Fuerza 0**:

para cambiar el ajuste de **Apagado** a **Encendido**. Entonces, la curva atravesará el origen del sistema de coordenadas.


Nota: Esto puede tener como resultado un efecto adverso en el coeficiente de correlación (r^2).

13. Pulse **Tabla** para regresar a la tabla de valores.

14. Cuando haya completado la tabla y seleccionado el tipo de curva, pulse **Hecho** si aparece el gráfico o **Salir** si aparece la tabla.

Vaya a [sección 6.1.1.4, página 83](#).

Calibración mediante "Medir patrones"

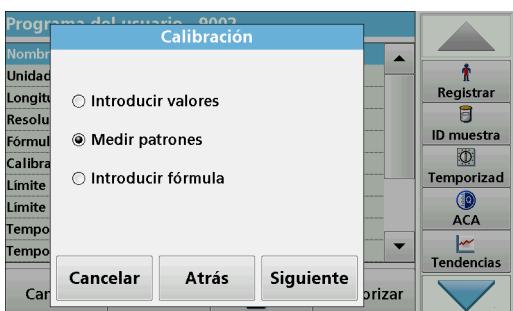

1. Pulse **Medir patrones**.

2. Pulse **Continuar**.

3. Pulse **+**.

4. Introduzca la concentración estándar.

5. Pulse **OK** para confirmar.

6. Si fuera necesario, repita esta operación hasta que haya introducido todos los valores. Se pueden introducir 24 valores como máximo.

Nota: Para cambiar un valor de la tabla, marque la fila correspondiente. Pulse la tecla de la unidad (por ejemplo, **mg/l**). Introduzca el valor cambiado.

7. Introduzca la solución cero en el compartimento de cubetas.
 8. Pulse **Cero**.
 9. Marque la fila con la primera concentración de patrón e inserte la celda correspondiente.
 10. Pulse **Medición**.
 11. Si es preciso, repita la operación hasta que se midan todas las soluciones patrón.

Los datos ingresados y medidos aparecerán en la tabla.

Nota: Si desea borrar una concentración de patrón, seleccione la línea correspondiente y pulse el ícono **Borrar**.

El icono del temporizador que aparece en la pantalla ayuda a garantizar, en caso necesario, que las fases del análisis están correctamente calculadas (p. ej., se pueden especificar con exactitud los tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.). Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo especificado, se emite una señal acústica. El uso del temporizador no influye en el programa de medición.

Valores de calibración

$C = a + bA$

1.200

1.200
Abs

0.000

0.00 1.00 mg/l 1.00

Ajuste curva $r^2=0.9643$

Hecho	Curva siguiente	Forz. 0: Apagado	Tabla
-------	-----------------	------------------	-------

- ## 12. Pulse Gráfico.

Los datos introducidos y medidos se muestran como una curva de calibración.

Nota: El coeficiente de correlación (r^2) se indica a la izquierda, debajo del sistema de ejes.

La curva lineal corresponde al ajuste de patrón.

- ### 13. Pulse Siguiente gráfico.

La presentación cambia a la curva polinómica del segundo orden.

- #### 14. Pulse Siguiente gráfico.

La presentación cambia a la curva polinómica del tercer orden.


15. Pulse **Fuerza 0**: para cambiar el ajuste de **Apagado** a **Encendido**. Entonces, la curva atravesará el origen del sistema de coordenadas.

Nota: Esto puede tener como resultado un efecto adverso en el coeficiente de correlación (r^2).

16. Pulse **Tabla** para regresar a la tabla de valores.

17. Cuando haya completado la tabla y seleccionado el tipo de curva, pulse **Hecho** si aparece el gráfico o **Salir** si aparece la tabla. Vaya a [sección 6.1.1.4, página 83](#).

Calibración mediante "Introducir fórmula"

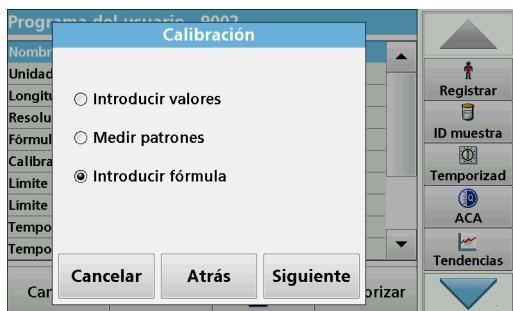

1. Pulse **Introducir fórmula**.

2. Pulse **Continuar**.



3. Pulse la tecla Fórmula.

Aparecerá una lista de fórmulas disponibles (lineal y polinómica de segundo o tercer orden). Dependiendo de la fórmula seleccionada, pueden introducirse hasta 4 coeficientes.

4. Pulse la fórmula correspondiente.

De acuerdo con la fórmula seleccionada, se muestran los factores deseados (a, b, c...).


5. Pulse las teclas de los factores e introduzca los valores correspondientes.

6. Pulse **OK** para confirmar cada introducción de factor.

Nota: Los coeficientes pueden ser de 5 dígitos y tener un signo positivo o negativo.

7. Pulse **OK** para confirmar.

6.1.1.4 Almacenamiento de un programa del usuario

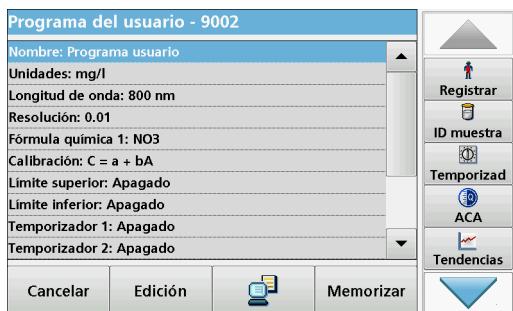

Ha finalizado la introducción de los datos básicos. La pantalla muestra un resumen de los datos variables del programa.

- Si necesita introducir más especificaciones o cambiar las existentes, seleccione la línea correspondiente y pulse **Edición**.
- Seleccione **Memorizar** para guardar los datos.

6.1.1.5 Parámetros y funciones adicionales definidos por el usuario

Además de los datos básicos anteriormente definidos, se pueden definir parámetros y funciones adicionales para los programas del usuario:

- límites superior e inferior del rango de medida
- funciones de temporizador
- fórmulas químicas



Límites superior e inferior del rango de medida

Existe la posibilidad de introducir un valor de medición máximo (superior) y mínimo (inferior). Aparecerá un mensaje de error si la medición está por encima del límite superior o por debajo del inferior.

1. Marque la fila **Límite superior** o **Límite inferior**.
2. Pulse **Edición**.
3. Pulse **Encendido**.
4. Pulse **0.000** e introduzca el límite del rango de medida.
5. Pulse **OK** para confirmar.



Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3 / Temporizador 4:


Con esta función, se pueden definir como temporizadores hasta cuatro intervalos de tiempo. A los temporizadores se les pueden asignar descripciones de cada fase de trabajo (por ejemplo, agitar, esperar y remover).

1. Marque la fila **Temporizador x**.
2. Pulse **Edición**.

Para activar o desactivar los temporizadores, utilice la casilla de verificación del área inferior de la pantalla.



3. Active un temporizador.
4. Pulse **Temporizador**.
5. Seleccione la designación en la lista mostrada que describa el proceso correspondiente y confirme con **OK**.
6. Pulse **00:00**.
7. Introduzca el intervalo de tiempo deseado (en mm:ss) y confirme con **OK**.

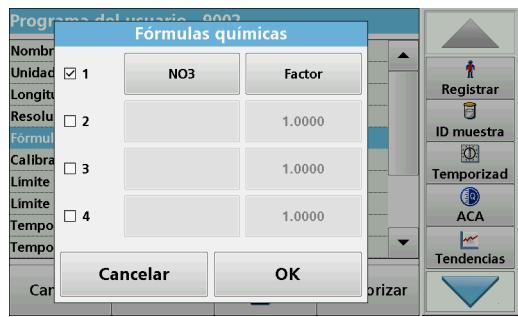

Fórmula química 2 / Fórmula química 3 / Fórmula química 4:

Si se ha definido una **fórmula química 1**, pueden introducirse hasta tres fórmulas adicionales alternativas.

1. Marque la fila **Fórmula química x**.
 2. Pulse **Edición**.
- Para activar o desactivar la fórmula química, utilice la casilla de verificación del área izquierda de la pantalla.
3. Pulse la tecla izquierda para introducir otra fórmula química.
 4. Pulse **OK** para confirmar.

5. Pulse la tecla derecha para introducir el factor de conversión para esta fórmula química adicional.
6. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse **Memorizar** para guardar los datos del programa. Pulse **Cancelar** para volver al Menú Principal.

6.1.2 Tipo de programa "Programación libre"

Programación libre es una opción avanzada para la introducción de métodos originales desarrollados por el usuario. El resumen de los datos contiene las especificaciones de los test programados. Cada opción de introducción se puede activar pulsando en la fila correspondiente y se puede cambiar con **Edición** (consulte [Tabla 10](#)).

1. Seleccione **Nuevo** en el menú "Opciones del programa".

Número del programa:

El número de programa es un número específico de la prueba, mediante el cual se puede recuperar posteriormente el programa de la lista de selección en el menú **Programas del usuario** o en el menú **Favoritos**.

2. Introduzca un número de programa entre 9000 y 9099. Aparecerá automáticamente el número más bajo disponible.
3. Pulse **OK**.


Nota: Si un número de programa ya se ha asignado a otro programa del usuario, aparece un mensaje que le pregunta si desea sustituir el programa actual. Si pulsa **OK**, el programa existente se sobrescribe.

Nombre del programa:

4. Con el teclado alfanumérico, introduzca un nombre de programa. La longitud máxima del nombre deberá ser de 28 caracteres.
5. Presione **Atrás** para volver al punto anterior del programa o **Siguiente** para continuar con el ingreso de los datos del programa.

Tipo de programa:

6. Seleccione **Programación libre** y, a continuación, pulse **Continuar**.



7. Seleccione la línea que contiene el punto del programa que se debe editar o definir y pulse **Edición**.

Tabla 10 Definiciones de los puntos del programa

Punto del programa	Descripción
Nombre	Nombre del parámetro de análisis
Versión	Aquí se introduce una abreviatura o número de versión asignado por el usuario.
Proceso de medida	Definición exacta del test: El número de longitudes de onda en las que se realizan las mediciones, el número de mediciones de absorbancia necesarias, las teclas que se deben utilizar, cualquier periodo de espera entre mediciones, etc.
Fórmula	Definición de las fórmulas de evaluación con las que se calcula el resultado del test.
Variables	El número de variables que aparecen en la pantalla depende de la definición del proceso de medida y las fórmulas. Introducción de los valores numéricos de las longitudes de onda, factores, constantes, etc.
Temporizador 1, Temporizador 2, Temporizador 3, Temporizador 4	Esta función se puede emplear para introducir abreviaturas y tiempos definidos para hasta cuatro temporizadores. Seleccione la línea pertinente en el resumen de datos y pulse Edición . Los temporizadores se activan o desactivan con las casillas de verificación situadas en el lado izquierdo de la pantalla. En la columna siguiente se pueden seleccionar, en una lista, los nombres que describen el procedimiento correspondiente. En la tercera columna se introducen los tiempos correspondientes a cada temporizador activo.

6.1.2.1 Proceso de medida


El proceso de medida define la manipulación y las mediciones del test:

- ¿En cuáles y con cuántas longitudes de onda se deben realizar las mediciones?
- ¿Cuántas mediciones de absorbancia se deben completar?
- ¿Cuándo se deben completar la medición cero y la medición de muestra?
- ¿Es necesario incluir tiempos de espera entre mediciones?
- ¿Deben repetirse las secuencias individuales del programa?

Los elementos de una secuencia de medición, como las mediciones cero y de muestra y los temporizadores (tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.) se definen de forma individual.


6.1.2.2 Introducción de un nuevo elemento de una secuencia de medición

Nota: Todos los componentes del proceso de medida se deben introducir en el orden en que se completarán.

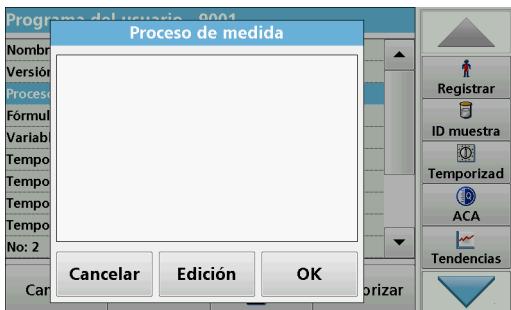

1. Marque la fila **Proceso de medida** en el resumen de datos.
2. Pulse **Edición**.
3. Pulse **Edición**.
4. Pulse **Nuevo**.

Contenido y definición de las teclas

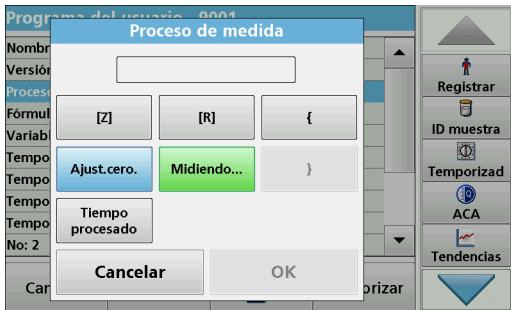

Tecla [Z] / Ajust.cero

1. Pulse **[Z]** para programar una medición cero.
2. Pulse **OK** para confirmar.
3. Pulse **Nuevo**.
4. Pulse **Ajust.cero** e introduzca la longitud de onda para la que se va a realizar la medición cero.
5. Pulse **OK** y confirme la introducción.
6. Pulse **OK**.
7. Si se van a realizar mediciones cero en varias longitudes de onda, repita los pasos empezando por 1 para cada longitud de onda.

Nota: Aparecerá la secuencia de medición introducida.




Tecla Temporizador

1. Pulse **Nuevo**.
2. Pulse **Temporizador** para introducir los tiempos de espera, reacción o manipulación.
3. Pulse **OK** y confirme la introducción.
4. Pulse **OK**.

Nota: Este intervalo de tiempo se integra en el proceso de medida.

Nota: Aparecerá la secuencia de medición introducida.

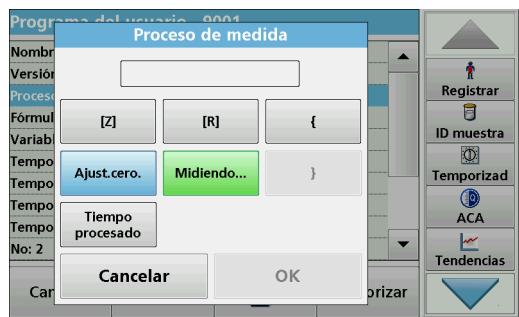

Tecla [R] / Midiendo...

1. Pulse **Nuevo**.
2. Pulse la tecla **[R]** para programar una medición de la sustancia que se va a analizar.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Pulse **Nuevo**.
5. Pulse **Medición...** e introduzca la longitud de onda para la que se va a realizar la medición.
6. Pulse **OK** y confirme la introducción.
7. Pulse **OK**.
8. Si se van a realizar mediciones en varias longitudes de onda, repita los pasos empezando por 1 para cada longitud de onda.

Nota: Aparecerá la secuencia de medición introducida.



Tecla { }

Los elementos de la secuencia de medición que se van a repetir se colocan entre llaves.

La llave izquierda **{** marca el inicio de la secuencia que se ha de repetir y la llave derecha **}** marca su final.

Nota: La tecla que muestra la llave derecha permanece inactiva hasta que se introduce la llave izquierda.

1. Para iniciar la secuencia de repetición, pulse **Nuevo**.
2. Pulse **{**.
3. Pulse la tecla que define la secuencia que se ha de repetir: **[Z]** o **[R]**.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse **Nuevo**.
6. Pulse **Ajust.cero** o **Medición...**, e introduzca la longitud de onda para la que se va a producir la medición.
7. Pulse **OK** y confirme la introducción.
8. Pulse **OK**.
- Defina los pasos adicionales que se van a incluir en la secuencia de repetición.
9. Al final de la secuencia de repetición, pulse **Nuevo**.
- Defina el último paso que se va a incluir en la secuencia de repetición. **No** pulse **OK**.
10. Pulse **}**.

11. Pulse **OK**.

Nota: Si una acción como una medición cero se repite en distintas etapas de la secuencia de medición, la serie de acciones se enumera de forma secuencial (p. ej., Z1, Z2, etc.).

**Borrado de un elemento de una secuencia de medición**

1. Marque la fila correspondiente.
2. Pulse **Borrar**.

Se borrará el elemento.

Inserción de un elemento de una secuencia de medición


1. Marque la fila situada **debajo** de la secuencia de medición que se va a insertar.
 2. Pulse **Nuevo**.
- Se puede introducir un nuevo elemento en la posición seleccionada.
3. Cuando se complete la introducción, pulse **OK** en la pantalla "Proceso de medida".
- El proceso de medida se muestra en la información general.
4. Pulse **OK**.

6.1.2.3 Introducción de la fórmula de calibración (fórmula de evaluación)


La fórmula de calibración (fórmula de evaluación) define el cálculo y la visualización de los resultados intermedios y finales. Los elementos definidos con anterioridad de la secuencia de medición constituyen la base para el cálculo de las concentraciones.

Introduzca la fórmula de calibración C1


1. Marque la fila **Fórmula** en el resumen de datos.
2. Pulse **Edición**.
3. Marque la fila **C1: Apagado**.
4. Pulse **Edición**.

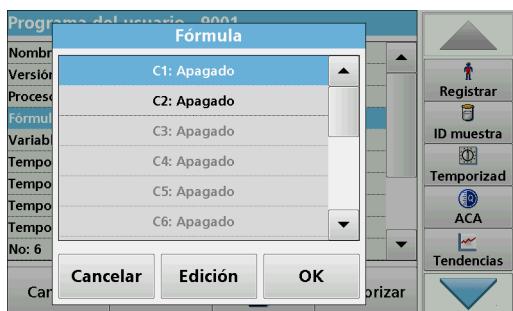

Programas avanzados

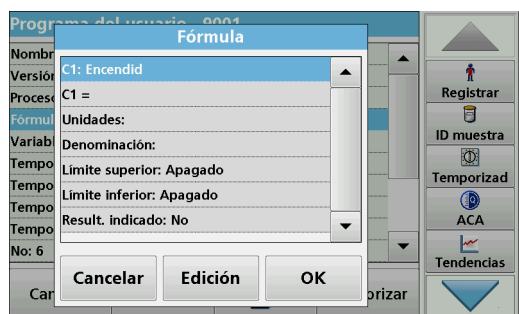

5. Marque **C1: Out.**
6. Pulse **Edición.**
- La pantalla cambia a **C1: Encendido.**
7. Marque la siguiente fila **C1=** para definir la fórmula.
8. Pulse **Edición..**

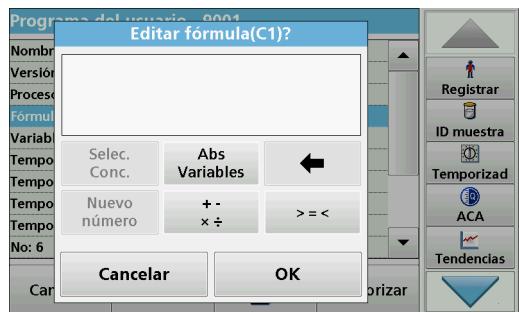

Consulte [Tabla 11](#) para obtener información detallada sobre las teclas Editar fórmula.

Nota: La fórmula de evaluación aumenta sucesivamente en la pantalla, en función de la introducción de datos.


Nota: La tecla de flecha borra el elemento de la fórmula introducido más recientemente.

Tabla 11 Descripción de las teclas que se usan en la edición de las fórmulas

Pantalla	Tecla	Descripción
	Abs/Variables	Pulse la tecla Abs/Variables para seleccionar en la lista que aparece en pantalla el elemento deseado de la secuencia de medición definida y, por tanto, la correspondiente longitud de onda de la medición, para que todo ello se pueda tener en cuenta en la fórmula.
	Nuevo número	Pulse Nuevo número para introducir un nuevo factor o constante.

Tabla 11 Descripción de las teclas que se usan en la edición de las fórmulas(Continuación)

Pantalla	Tecla	Descripción
	+ - ÷ ×	<p>Presione + - ÷ × para ingresar una operación matemática.</p> <p>Seleccione la operación y pulse OK para confirmar.</p> <p>Las operaciones matemáticas disponibles dependen de la fórmula definida.</p> <p>Es decir, las funciones como "()" o "ln"/"log", entre otras, sólo están activas si un término del paréntesis o el cálculo de un logaritmo es matemáticamente admisible en la fórmula definida (aplicable a las operaciones matemáticas básicas).</p> <p>Están disponibles las siguientes operaciones matemáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • + (suma) • - (resta) • ÷ (división) • × (Multiplicación) • ^ (exponente) • Ln (logaritmo neperiano) • Log (logaritmo común)
	>=<	<p>Pulse \\>=< para incluir condiciones/vínculos/declaraciones lógicas en la fórmula. Están disponibles las siguientes funciones:</p> <p>= (igual a), < (menor que), > (mayor que), <= (menor o igual que), >= (mayor o igual que), IF, THEN, ELSE</p> <p>Una vez introducida por completo la fórmula de evaluación C1, pulse OK para confirmar. Pulse de nuevo OK para volver a la pantalla Fórmula.</p> <p>Cuando haya introducido y confirmado la fórmula C1, se pueden indicar el nombre del parámetro, los límites superior e inferior del rango de medida y la pantalla de resultado (sí, no).</p>



Introducción de la siguiente fórmula de calibrado (C2 o Cn)

1. Marque **C2:Out**.
 2. Pulse **Edición**.
 3. Marque **C2:Out**.
 4. Pulse **Edición**.
- La pantalla cambia a **C2: Encendido**.
5. Marque la siguiente fila **C2=** para definir la fórmula.
 6. Pulse **Edición**.

Además de las teclas descritas [Tabla 11](#), sólo hay otra función disponible:



Seleccione Conc. tecla

1. Si se debe tener en cuenta una fórmula ya definida, en este caso C1, en la fórmula para C2, pulse **Selecc. Conc.**
2. Introduzca la numeración de la ecuación (p. ej., 1 para C1).
3. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

Ahora Cn se puede vincular a una operación matemática.

Nota: Las concentraciones de Cn que han de calcularse se enumeran de forma secuencial: C1, C2, C3, etc.

Nota: Una vez definida la fórmula Cn, la lista Fórmula se amplía automáticamente en Cn+1.

6.1.2.4 Introducción de variables



1. Marque la fila **Variables** en el resumen de datos.

2. Pulse **Edición**.

3. Seleccione la variable que se va a editar.

4. Presione **Edición** e ingrese los datos (consulte las especificaciones del proceso) (para F1, F2, λ1, U1 etc).

5. Pulse **OK** para confirmar cada introducción.

Abreviaturas de las variables:

F1: Factor 1

F2: Factor 2

λ1: Longitud de onda 1

U1: Factor de conversión 1 para la primera fórmula química


U2: Factor de conversión 2 para el resto de fórmulas químicas, etc.

6.1.2.5 Memorización de un programa del usuario de programación libre

1. Pulse **Memorizar** para guardar los datos introducidos.

Estos se pueden almacenar en cualquier punto de datos (secuencia de medición, fórmula, temporizador, etc.).

6.1.3 Selección de un programa del usuario

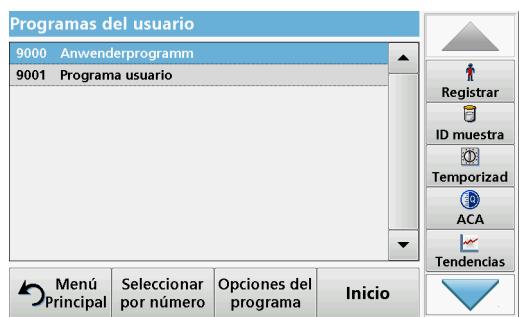

1. Pulse **Programas del usuario** en el Menú Principal.

Se muestra por orden alfabético una lista de programas del usuario con números de programa.


Nota: Utilice la barra de desplazamiento para moverse rápidamente por la lista.

Nota: Seleccione el programa pulsándolo o eligiendo **Seleccionar por número** para buscarlo por número.


2. Pulse **Inicio** para ejecutar el programa.

6.1.4 Adición, edición y borrado de programas del usuario de la lista de favoritos

Los métodos y test más utilizados del menú "Programas del usuario" también se pueden agregar a la lista de favoritos para simplificar su selección.

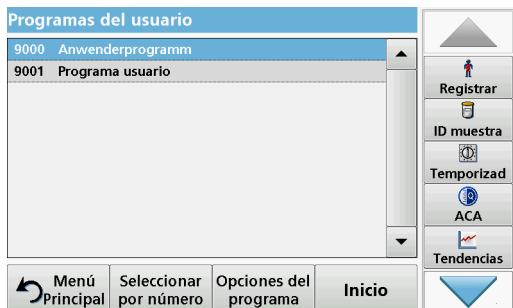

1. Presione **Programas de usuario** en el menú Principal.
Aparecerá la lista Programas del usuario.
2. Seleccione el programa pulsándolo o eligiendo **Seleccionar por número** para buscarlo por número.

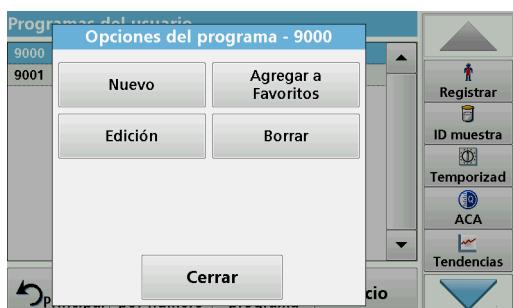


3. Pulse **Opciones del programa**.
Utilice **Agregar a Favoritos** para agregar el programa seleccionado a la lista de favoritos.
Utilice **Edición** para editar el programa seleccionado.
Utilice **Borrar** para borrar el programa seleccionado.
Nota: Si se borra el programa almacenado de Programas del usuario, también desaparecerá de Programas favoritos.

6.1.4.1 Agregar a Favoritos



1. Presione **Agregar a Favoritos**.
2. Pulse **OK** para confirmar.
El programa se agrega a Favoritos.

6.1.4.2 Edición

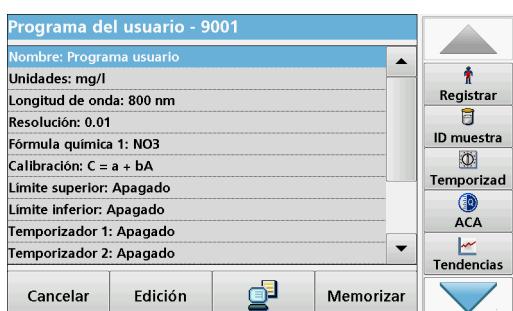

1. Pulse **Edición**.
2. Pulse **OK** para confirmar.
Se muestra la información general sobre los datos con las especificaciones de la prueba programada. Para obtener más información sobre las opciones de introducción, consulte [sección 6.1.2, página 85](#).

Programas avanzados

6.1.4.3 Borrar un programa



1. Pulse **Borrar**.

2. Pulse **OK** para confirmar.

El programa se borra de la lista de programas del usuario.

Nota: Si se borra el programa almacenado de **Programas del usuario**, también desaparecerá de **Programas favoritos**.

6.2 Favoritos

Los métodos y tests más utilizados de los menús **Programas almacenados** y **Programas del usuario** también se pueden agregar a la lista de Programas favoritos para simplificar su selección.

Para agregar **Programas almacenados** o **Programas del usuario** a la lista de programas favoritos, consulte [sección 6.1.4, página 93](#).

6.2.1 Recuperación de un programa favorito



1. Pulse **Programas favoritos** en el Menú principal.

Aparecerá la lista "Programas Favoritos".


2. Realice la selección pulsando sobre el programa deseado.

Nota: Utilice la barra de desplazamiento para moverse rápidamente por la lista.

Nota: Pulse **Seleccionar por número** para buscar el programa por su número. Utilice el teclado alfanumérico para introducir el número de test (número de programa) y confirme la introducción pulsando **OK**.

3. Pulse **Inicio**.

6.2.2 Borrado de un programa favorito

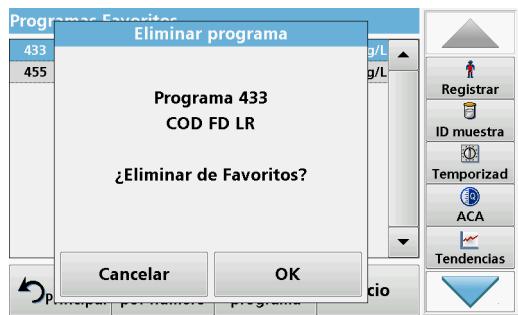

1. Pulse **Programas favoritos** en el Menú principal.

Aparecerá la lista "Programas Favoritos".

2. Realice la selección pulsando sobre el programa deseado.

Nota: Utilice la barra de desplazamiento para moverse rápidamente por la lista.

Nota: Pulse **Seleccionar por número** para buscar el programa por su número. Utilice el teclado alfanumérico para introducir el número de test (número de programa) y confirme la introducción pulsando **OK**.

3. Pulse **Eliminar programa**.

4. Pulse **OK** para confirmar.

Nota: Si se borra un **Programa favorito**, permanecerá de forma permanente en los **Programas del usuario** o en los **Programas almacenados**.

Nota: Si se borra el programa almacenado de los **Programas del usuario**, también desaparecerá de **Programas Favoritos**.

6.3 Adición de patrón: supervisión y comprobación de resultados

La exactitud de las mediciones (su correspondencia con la concentración real del analito en la muestra) y su repetibilidad (correspondencia de los resultados obtenidos en la medición de varias muestras con la misma concentración del analito) se pueden determinar o mejorar mediante el método de adición de patrón

Este método sirve para detectar errores específicos de la muestra:

- El análisis se vió afectado por substancias o interferencias en la muestra (efecto matriz de muestra),
- un dispositivo de medición defectuoso,
- reactivos impuros.

Método:

Agregue a la muestra una cantidad definida (concentración) de la sustancia que se va a analizar como una solución patrón. La tasa de detección (concentración de la solución patrón agregada) debe acercarse al 100 %.

$$\text{Tasa de detección} = \frac{\text{Medición de adición de patrón correcta}}{\text{Valor expandido después de adición de patrón correcta}}$$

Tasa de detección	Conclusión
100 %	La probabilidad de que los resultados de la medición sean correctos es alta.
≠ 100 %	<p>Conjetura: el análisis se vió afectado por substancias o interferencias en la muestra (efecto matriz de muestra),</p> <p>Ánalysis para determinar si se ha producido el efecto de matriz de muestra:</p> <p>Utilice agua destilada en lugar de la muestra. Agregue solución patrón como se describe en el procedimiento.</p>
Tasa de detección	Conclusión
100 %	Los iones de la muestra están interfiriendo en el análisis y provocan la obtención de falsos resultados.
≠ 100 %	No existe interferencia de los iones.

Medidas para identificar otros factores de interferencia:

Lista de control:

1. Comprobación de si el procedimiento se está completando correctamente:
 - a. ¿Se agregan los reactivos en el orden correcto?
 - b. ¿Transcurre tiempo suficiente para el desarrollo del color?
 - c. ¿Se utilizan los objetos de cristal adecuados?
 - d. ¿Están limpios?
 - e. ¿Requiere el test que la muestra esté a una temperatura determinada?
 - f. ¿Se encontraba el pH de la muestra en el rango adecuado?
 - g. ¿Es el volumen de la pipeta correcto?
2. Compruebe los reactivos. Repita las adiciones de patrón utilizando reactivos nuevos.

Tasa de detección	Conclusión
100 %	Los reactivos utilizados en principio estaban defectuosos. Comprobación de la solución patrón: Repita el procedimiento de adición de stándar con una solución estándar recién preparada y agua destilada.
Tasa de detección	Conclusión
100 %	La solución patrón utilizada en principio era deficiente.

Si el problema no se resuelve con ninguna de estas mediciones, póngase en contacto con el fabricante.

6.3.1 Realización de una adición de patrón

Lleve a cabo la adición de patrón siguiendo el procedimiento correspondiente.

Existen dos métodos distintos:


Máx. Volumen (adición de patrón)

Se agrega de manera incremental un volumen definido de solución patrón de una concentración conocida a una muestra previamente analizada y la muestra se vuelve a medir después de cada adición de patrón.

Volumen de muestra:


Se agrega un volumen definido de una solución patrón de concentración conocida al volumen de la muestra especificado en la metódica; la muestra se mide tras cada adición. En la mayoría de los casos, se preparan tres soluciones patrón distintas y se repite la metódica con cada una de ellas.

Nota: Las unidades y fórmulas químicas utilizadas para la muestra se usan para las soluciones patrón. Asegúrese de que utiliza las unidades correctas para las posteriores introducciones.

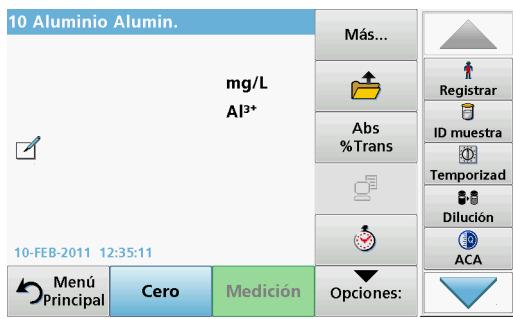


Volumen de método máximo/volumen de muestra

1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal.
2. Seleccione el programa correspondiente.
3. Pulse **Inicio**.
4. Analice una muestra sin agregar solución patrón según las instrucciones del Manual de procedimientos. Una vez completada la medición, deje la cubeta de muestra en el compartimento de cubetas de muestra.

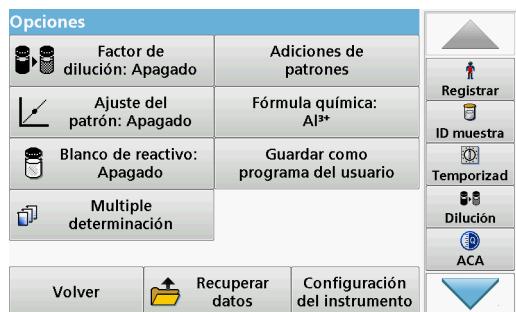


5. Pulse **Opciones**||>**Más**||>**Adición de patrón**.

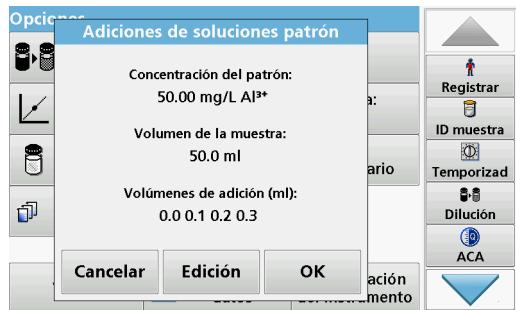


Aparecerá un resumen de los datos de la metódica de adición de soluciones patrón.

6. Pulse **OK** para aceptar los valores para la concentración del patrón, el volumen de muestra (total) y el volumen de adición de soluciones patrón.
7. Pulse **Edición** para cambiar estos valores.

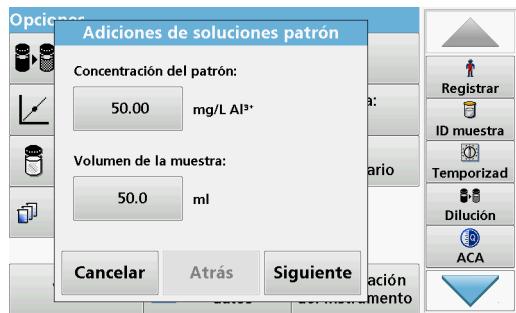

8. Pulse la tecla del valor para cambiarlo. Utilice el teclado alfanumérico para cambiar el valor.
9. Pulse **OK** para confirmar.

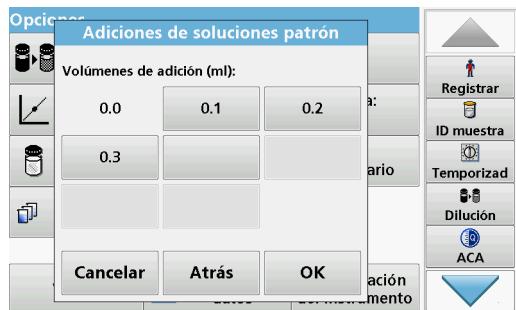

10. Pulse las teclas para cambiar los valores de adición de patrón. Utilice el teclado alfanumérico para introducir los nuevos datos.
11. Pulse **OK** para confirmar.

Adiciones de soluciones patrón		
ml	mg/L	%
Patrón	Al ³⁺	Recuperación
0.0	0.035	100
0.1	0.034	25.7
0.2	0.182	78.1
0.3	0.186	55.8

Volver
Cero
Medición
Gráfico

Registrar
ID muestra
Temporizad
Dilución
ACA

Descripción de la tabla de mediciones


- La **primera** columna muestra el volumen de adición de patrón. 0 ml representa las muestras sin patrón añadido.
- La **segunda** columna muestra la medición de las muestras con y sin patrón añadido.
- La **tercera** columna muestra la tasa de detección del patrón añadido.

Nota: La línea resaltada en negro está activa.

La medición de la muestra en el instrumento, sin patrón añadido, se muestra automáticamente en 0 mL.

12. Prepare la solución de adición de patrón como se describe en el procedimiento.
13. Pulse en el volumen de adición de patrón en la tabla.
14. Inserte la cubeta con el volumen de adición correspondiente en el compartimento de cubetas.
15. Pulse **Medición**.

Repita el procedimiento con el resto de soluciones de adición de patrón.

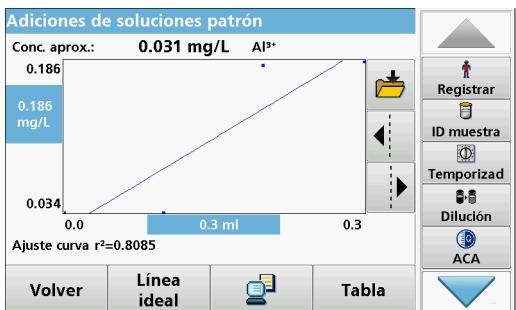

16. Una vez medidas todas las soluciones de adición de patrón, pulse **Gráfico**.

Aparecerá la línea de regresión de los puntos de datos de adición de patrón.

El coeficiente de correlación r^2 indica la cercanía de los puntos de datos a la línea.

Si el coeficiente de correlación es igual a 1, la curva es lineal.

La concentración que se muestra sobre la curva representa la concentración estimada de la muestra sin agregar el patrón.

Nota: En el menú Gráfico, el nombre que aparece en la tecla **Gráfico** cambia a **Tabla**. Pulse **Tabla** para visualizar de nuevo todos los datos de la tabla.

17. Presione **Línea ideal** para mostrar la relación entre las incorporaciones y la línea ideal (tasa de detección del 100 %).

6.4 Longitud de onda única (medidas de absorbancia, concentración y transmitancia)

El modo Longitud de onda única se puede utilizar de tres formas. Para medidas de muestras a una longitud de onda única, el instrumento se puede programar para medir la absorbancia, la transmitancia (%) o la concentración del analito.

- Medidas de absorbancia: La luz absorbida por la muestra se mide en unidades de absorbancia.

- La transmitancia (%) mide el porcentaje de luz original que atraviesa la muestra y alcanza el detector.
- La activación del factor de concentración permite la selección de un multiplicador específico para la conversión de las lecturas de absorbancia a concentración. En un gráfico de concentración en función de la absorbancia, el factor de concentración es la parte descendente de la línea.


6.4.1 Configuración del modo Longitud de onda única

1. En el Menú Principal, pulse **Longitud de onda única**.
2. Pulse **Opciones** para configurar los parámetros.




Tabla 12 Opciones de Longitud de onda única

Opciones	Descripción
Más	Para otras opciones.
Recuperación de símbolos de datos de mediciones	Recuperar datos de mediciones guardados, barridos de longitud de onda o cinéticas en el tiempo, consulte sección 5.3, página 43 .
%Trans/Ext (% Trans/Abs)	Para cambiar a las mediciones de transmitancia (%), concentración o absorbancia.
λ Longitud de onda	Para introducir el ajuste de longitud de onda. Utilice el teclado alfanumérico para introducir las longitudes de onda de la medición. La longitud de onda introducida debe estar en el rango de 320–110 nm.
Icono del temporizador	Funciona como un cronómetro. Garantiza que las fases del análisis están correctamente calculadas (p. ej., se pueden especificar con exactitud los tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.). Cuando ha transcurrido el tiempo especificado, se emite un sonido. El uso del temporizador no influye en el programa de medición.
Factor de concentración	Factor de multiplicación para convertir los valores de absorbancia en valores de concentración.
Resolución de la concentración	Para seleccionar el número de posiciones decimales.
Guardar como programa del usuario	Para almacenar los parámetros como un Programa del usuario, consulte sección 6.1, página 75 .
Recuperación de datos de mediciones	Recuperar datos de mediciones guardados, barridos de longitud de onda o cinéticas en el tiempo, consulte sección 5.3, página 43 .
Modo Configuración del instrumento	Datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27 .

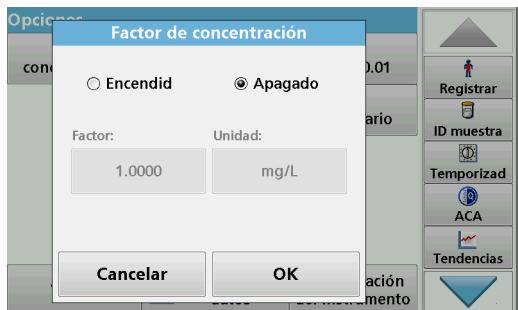

Factor de concentración:

1. Pulse **Factor de concentración: Apagado** en el menú "Opciones" .
2. Pulse **Encendido** para seleccionar esta función.
3. Pulse Factor e introduzca el factor.
4. Pulse **Unidad** y seleccione las unidades correspondientes a la concentración en la lista.
5. Pulse **OK** para confirmar.

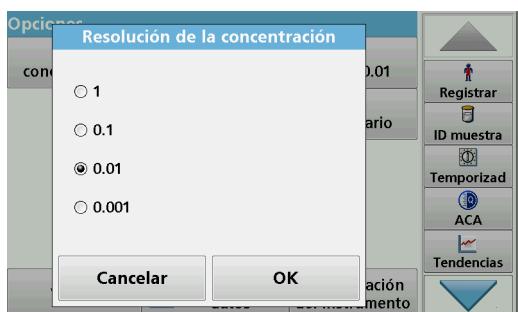

Resolución de la concentración:

1. Pulse **Resolución de la concentración** en el menú "Opciones" .
2. Seleccione la resolución.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. A continuación, pulse **Volver** para regresar a la pantalla de resultados.

6.4.2 Toma de mediciones de longitud de onda única (medición puntual)



1. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas.
2. Pulse **Cero**.
*Nota: La tecla **Medición** sólo estará activa después de haber completado la medición cero.*
3. Introduzca la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas.
4. Pulse **Medición**.
5. Para el almacenamiento de los datos, consulte sección 5.3.1, página 43.

6.5 Modo Long. de onda múltiple: mediciones con más de una longitud de onda

En este modo los valores de absorbancia se pueden medir en hasta cuatro longitudes de onda y los resultados se pueden procesar matemáticamente para obtener sumas, diferencias y relaciones.

- **Medidas de absorbancia:** La luz absorbida por la muestra se mide en unidades de absorbancia.
- **La transmitancia (%)** mide el porcentaje de luz original que atraviesa la muestra y alcanza el detector.

- La activación del factor de concentración permite la selección de un multiplicador específico para la conversión de las mediciones de absorbancia a concentración. En un gráfico de concentración en función de la absorbancia, el factor de concentración es la parte descendente de la línea. La concentración se calcula mediante un factor único introducido por el usuario para cada longitud de onda.


6.5.1 Ajuste del modo de medición a distintas longitudes de onda

En el Menú Principal, pulse **Long. de onda múltiple**. Pulse **Opciones** para configurar los parámetros.



Tabla 13 Opciones de configuración de longitud de onda múltiple

Opciones	Descripción
Más	Para otras opciones.
Recuperación de símbolos de datos de mediciones	Recuperar datos de mediciones guardados, barridos de longitud de onda o cinéticas en el tiempo, consulte sección 5.3, página 43 .
%Trans/Ext (%) Trans/Abs)	Para cambiar a las mediciones de transmitancia (%), concentración o absorbancia.
λ Longitud de onda	Para introducir el ajuste de longitud de onda. Utilice el teclado alfanumérico para introducir las longitudes de onda de la medición. La longitud de onda introducida debe estar en el rango que abarca de 320–1100 nm.
Icono del temporizador	Funciona como un cronómetro. Garantiza que las fases del análisis están correctamente calculadas (p. ej., se pueden especificar con exactitud los tiempos de reacción, tiempos de espera, etc.). Cuando ha transcurrido el tiempo especificado, se emite un sonido. El uso del temporizador no influye en el programa de medición.
Factor de concentración	Factor de multiplicación para convertir los valores de absorbancia en valores de concentración.
Resolución de la concentración	Para seleccionar el número de posiciones decimales.
Fórmula de absorbancia	Base de cálculo para la evaluación de muestras
Guardar como programa del usuario	Para almacenar los parámetros como un Programa del usuario, consulte sección 6.1, página 75 .
Recuperación de datos de mediciones	Recuperación de datos de medidas guardados, barridos de longitudes de onda o cinéticas en el tiempo, consulte sección 5.3, página 43 .
Modo Configuración del instrumento	Datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27 .

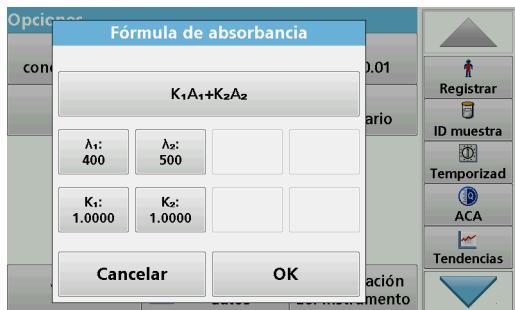

1/ Fórmula de absorbancia:

1. Pulse **Fórmula de absorbancia**.
2. La fórmula seleccionada en la tecla superior determina el número de longitudes de onda y las teclas de los coeficientes que aparecerán más abajo.
3. Pulse la tecla para cambiar la fórmula de cálculo.
4. Seleccione una fórmula en la lista.
5. Pulse **OK**.

Al seleccionar una fórmula nueva, el número de variables cambia para coincidir con ella.

Las siguientes formulas se encuentran disponibles:

$K_1 A_1 + K_2 A_2$
 $K_1 A_1 + K_2 A_2 + K_3 A_3$
 $K_1 A_1 + K_2 A_2 + K_3 A_3 + K_4 A_4$
 $K_1 A_1 / K_2 A_2$
 $(K_1 A_1 + K_2 A_2) / K_3 A_3$
 $(K_1 A_1 + K_2 A_2) / (K_3 A_3 + K_4 A_4)$

A_1 se refiere a la absorbancia a una longitud de onda 1

A_2 se refiere a la absorbancia a una longitud de onda 2, etc.

K_1 se refiere al coeficiente a una longitud de onda 1

K_2 se refiere al coeficiente a una longitud de onda 2, etc.

En el caso de que se tenga que realizar una resta, los factores se pueden introducir con el signo "menos".




6. Para cambiar la longitud de onda, presione la tecla **?x**.
7. Introduzca el factor de longitud de onda deseado utilizando el teclado alfanumérico.
8. Pulse **OK** para confirmar la selección.




9. Para cambiar un coeficiente, pulse una de las teclas "**K_X**".
10. Introduzca el coeficiente deseado utilizando el teclado alfanumérico.
11. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Nota: Se pueden introducir valores de hasta 5 dígitos. Es posible utilizar hasta cuatro posiciones decimales.

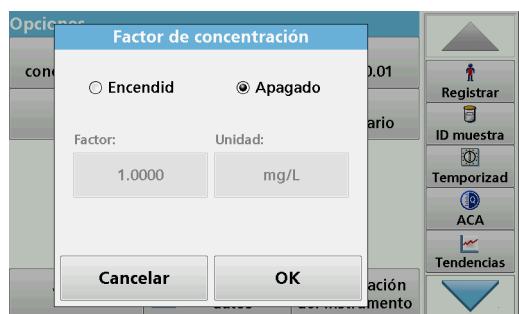

Factor de concentración:

1. Pulse **Factor de concentración: Apagado** en el menú "Opciones".
2. Pulse **Encendido** para seleccionar esta función.
3. Pulse **Factor**.
4. Introduzca el factor con el que se va a multiplicar la medición de la absorbancia.
5. Pulse **Unidad**.
6. Seleccione la unidad de concentración correspondiente en la lista.
7. Pulse **OK** para confirmar.

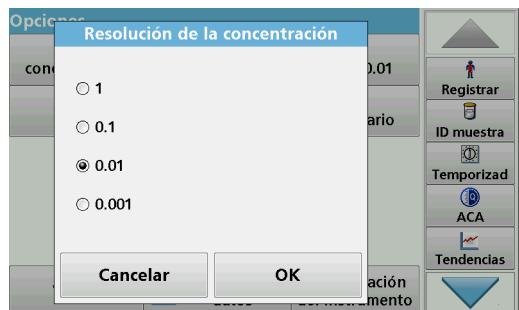

Resolución de la concentración:

1. Pulse **Resolución de la concentración** en el menú "Opciones".
2. Seleccione la resolución.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Pulse **Volver** para regresar a la pantalla de resultados.

6.5.2 Realización de una medición en modo Long. de onda múltiple



1. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas.
2. Pulse **Cero**.
*Nota: La tecla **Medición** no se activa hasta que se ha completado la medición cero.*
3. Introduzca la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas.
4. Pulse **Medición**.
5. Para el almacenamiento de los datos, consulte sección 5.3.1, página 43.

6.6 Modo Barrido de longitud de onda: registro de espectros de absorbancia y transmisión

En el modo Barrido de longitud de onda se mide la absorbancia de la luz en una solución para un espectro de longitud de onda definido. Mientras se está realizando el barrido, se debe cerrar la cubierta del compartimento de cubetas. Por lo tanto, no es posible realizar un barrido del compartimento de cubetas redondas.

Los resultados se pueden visualizar como curva, transmitancia porcentual (%T) o absorbancia (Abs). Los datos recopilados se pueden imprimir como tabla o curva.

Es posible realizar cambios de formato en estos datos. Estos incluyen funciones como la de escala y zoom. Se determinan unos valores máximos y mínimos que se muestran como tabla.

El cursor se puede colocar en cualquier punto de la curva para leer los valores de absorbancia y transmitancia o la longitud de onda. Los datos asociados a cada punto de datos también se pueden visualizar en forma de tabla.

6.6.1 Configuración del barrido de longitud de onda

En Menú Principal, pulse **Barrido de longitud de onda**. Pulse **Opciones** para configurar los parámetros.



Tabla 14 Opciones durante el barrido de longitud de onda

Opción	Descripción
Más	Se muestran más opciones.
Icono de carpeta	Para memorizar los datos de los barridos.
Referencia: Apagado/Encendido	En la lista de barridos memorizados que aparece, se selecciona un registro para su uso como barrido de referencia o superpuesto. Se puede seleccionar o mostrar en el fondo para compararlo con el barrido real medido. <i>Nota: Esta opción sólo está disponible cuando existen barridos memorizados con el mismo rango y fase de longitud de onda.</i>
λ	Ingresar el espectro de longitud de onda el intervalo de barrido
Seleccionar vista	Permite al usuario cambiar la pantalla entre las tablas de datos de barrido (longitud de onda/absorbancia) y el gráfico de la curva. <i>Nota: "Seleccionar vista" se activa tras la primera medición.</i>
Modo Cursor	Para seleccionar Trazo o Pico/Valle . La selección de esta opción de menú determina a qué puntos del gráfico se desplaza el cursor.
Enviar datos	Para enviar datos a una impresora, PC o memoria USB (tipo A).
Integral: Encendido/Apagado	La integral ofrece el área y la derivada de la integral proporciona la función original.



Tabla 14 Opciones durante el barrido de longitud de onda(Continuación)

Opción	Descripción
Escala y Unidades	Escala: En el modo de escala automática, el eje "y" se ajusta automáticamente de forma que se visualice el barrido total. El modo de escala manual permite la visualización de secciones del barrido. Unidades: Se debe elegir entre absorbancia o transmitancia.
Recuperación de datos de mediciones	Recuperación de datos de mediciones guardados, barridos de longitudes de onda o cinéticas en el tiempo, véase sección 5.3, página 43 .
Modo Configuración del instrumento	Datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27 .



λ Configuración de la longitud de onda

1. Pulse la tecla λ del menú "Opciones" para seleccionar el rango y la fase de longitud de onda.
2. Pulse la tecla superior izquierda para seleccionar la longitud de onda inferior.
3. Introduzca la longitud de onda inferior.
4. Pulse **OK** para confirmar.
5. Pulse la tecla superior derecha para seleccionar la longitud de onda superior.
6. Introduzca la longitud de onda superior.
7. Pulse **OK** para confirmar.

Nota: No seleccione la misma longitud de onda mínima y máxima.

8. Seleccione la fase de longitud de onda adecuada.

Nota: La selección del intervalo influye en la duración y la resolución del barrido de longitud de onda. Los barridos con una resolución alta tardan más en realizarse que los que tienen una resolución baja. Cuanto mayores sean los incrementos de los intervalos seleccionados, más rápido se realiza el barrido. En cambio, la resolución de los datos determinados se reduce. Se puede emprender un máximo de 780 mediciones durante un barrido.

Nota: La longitud de onda máxima se ajusta automáticamente si la diferencia entre la longitud de onda máxima y mínima no es un múltiplo del intervalo.

9. Pulse **OK** para volver al modo de barrido.

Los parámetros seleccionados se visualizan en el eje "x" del gráfico.



Seleccionar vista (tabla de visualización)

1. Realización de un barrido de longitud de onda (sección 6.6.2, página 108)
2. Pulse **Mostrar tabla** en el menú "Opciones".
3. Aparecerá una tabla con los resultados.
4. Para volver al gráfico, pulse **Opciones** y, a continuación, **Ver Gráfico**.



Modo Cursor

1. Pulse **Modo Cursor: Trazo** en el menú "Opciones". La selección de esta opción determina los datos que se visualizarán en la tabla.
2. Seleccione **Trazo** o **Pico/Valle**.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Pulse **Volver** para regresar al modo de barrido.




Integral

La integral se aplica al rango de longitud de onda completa del barrido.

1. Pulse **Integral: Apagado** en el menú "Opciones".
2. Seleccione **Encendido** para visualizar la integral.
3. Para hallar la integral u otros rangos de longitud de onda, cambie de nuevo el barrido y el rango de longitud de onda.
4. Pulse **OK** para confirmar.
5. Pulse **Volver** para regresar al modo de barrido.

Nota: La integral aparecerá en lugar de la fecha en la pantalla.

Nota: Para la próxima medición de barrido, la integral aparecerá como **Encendido**.

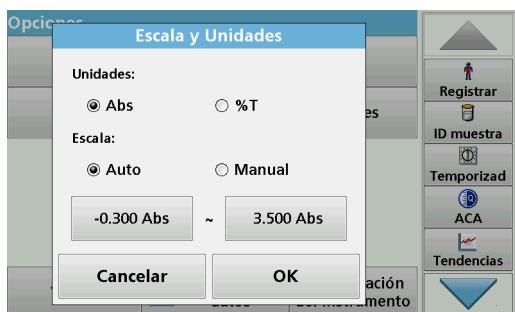

Escala y Unidades

1. Pulse **Opciones>Más..>Escala y Unidades**.
2. Seleccione las unidades adecuadas (**Abs** o **%T**).
3. Seleccione **Auto** o **Manual** para la escala en el eje "y" del gráfico.

Nota: Al seleccionar la escala manual, los valores límite y_{\min} e y_{\max} se pueden introducir utilizando el teclado alfanumérico. El gráfico se ajusta para mostrar sólo los valores situados dentro del rango seleccionado. Si

se selecciona la escala automática, el instrumento establece automáticamente los límites de forma que se pueda visualizar el rango total.

4. Pulse **OK**.
5. Pulse **Volver** para regresar al modo de barrido.

6.6.2 Realizar un barrido de longitud de onda

Después de seleccionar todos los parámetros de barrido, registre un punto de referencia (medición cero inicial). Si se cambia un parámetro de barrido, se debe registrar un nuevo punto de referencia. Una vez barrido el punto de referencia, el instrumento está listo para escanear una o más muestras.



1. Seleccione en el menú principal la opción **Barrido de longitud de onda**.
2. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas y cierre la cubierta.

Nota: El compartimento de cubetas debe estar cerrado por medio de la cubierta durante el barrido. Por lo tanto, no se pueden realizar barridos con cubetas redondas de 13 mm.



3. Pulse **Cero**.
4. Introduzca la cubeta de análisis preparada en el compartimento de cubetas y cierre la cubierta.
5. Pulse **Medición**.

Bajo el gráfico, aparece la pantalla "Leyendo..." y se muestra de forma continua un gráfico de los valores de absorción o transmisión



El barrido de longitud de onda habrá finalizado si

- el gráfico aparece a tamaño completo,
- la escala del eje "x" se produce automáticamente,
- las funciones del cursor en la barra de exploración vertical aparecen resaltadas.
- suena una señal


6.6.2.1 Exploración del gráfico del barrido de longitud de onda o un análisis de barrido de longitud de onda

Tabla 15 Exploración del barrido de longitud de onda

Función del cursor/ Función de zoom	Descripción
Icono de curva (Selección del modo Cursor)	Selección de Pico/Valle en modo Cursor (el cursor se desplaza por los valores de absorbancia mínimo y máximo) o Trazo en modo Cursor (el cursor se mueve por los puntos de datos del escaneado).
Teclas de flecha	Las teclas de flecha (izquierda/derecha) se usan para desplazar el cursor (según el modo seleccionado) al siguiente punto de datos. Los datos del punto de datos (valor de transmitancia o longitud de onda/absorbancia) aparecen resaltados en los ejes "x" e "y". Nota: Pulse cualquier punto de la curva para visualizar los datos asociados.
Icono de zoom	Esta función se usa para ampliar la sección de la curva donde se sitúa el cursor. El tamaño original de la curva se puede restablecer presionando de nuevo el icono del zoom.

6.6.3 Trabajo con barridos de referencia

Existen dos opciones para trabajar con **Barrido de referencia**:

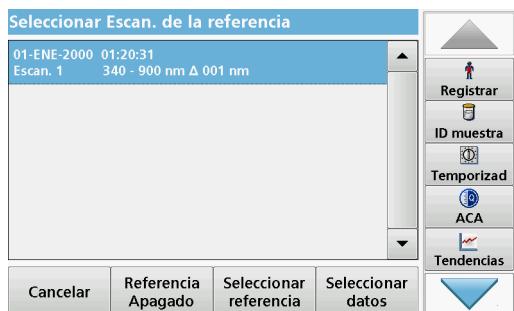

Primera opción:

1. Pulse **Referencia: Apagado** en el menú "Opciones" para seleccionar otro barrido y así visualizarlo en la misma pantalla que el barrido actual. Resalte el número de barrido correspondiente y presione **Resaltar referencia**.

Nota: Una vez que se haya seleccionado un barrido de referencia, la tecla **Referencia: apagado** en el menú "Opciones" se convierte en **Referencia: encendido**.

Nota: Sólo se pueden visualizar los barridos con el mismo rango y fase de longitud de onda mediante la opción de superposición. Este proceso se puede repetir hasta visualizar todos los barridos que coincidan.


2. La curva de referencia aparece en naranja. El valor de absorbancia o transmitancia y la longitud de onda asociada se resaltan en gris.

Nota: Aparece un cuadro negro y naranja en la esquina superior izquierda de la pantalla. El cuadro naranja está relacionado con el barrido de referencia y el negro con el barrido de longitud de onda actual.

3. Para realizar la medición del barrido de la longitud de onda, consulte [sección 6.6.2, página 108](#).

- Las curvas de barrido de longitud de onda representadas se visualizan en negro.
- El valor de absorbancia o transmitancia y la longitud de onda asociada se resaltan en negro.
- Asimismo, la pantalla muestra la diferencia entre la curva de barrido de longitud de onda y la curva de referencia con respecto a la longitud de onda.

4. Pulse el cuadro negro o naranja situado en la esquina superior izquierda para cambiar del barrido de longitud de onda real al de referencia.

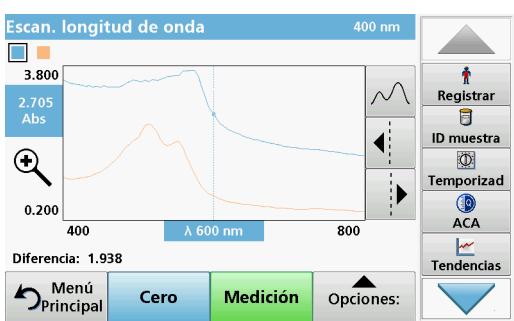



Segunda opción:

1. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas. Pulse **Cero**.
2. Introduzca la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas. Pulse **Medir**.
 - Las curvas de barrido de longitud de onda representadas se visualizan en negro.
 - El valor de absorbancia o transmitancia y la longitud de onda asociada se resaltan en negro.
3. Pulse **Opciones** y, a continuación, **Referencia: Apagado** en el menú "Opciones" para seleccionar otro barrido y así visualizarlo en la misma pantalla que el barrido actual. Seleccione el número de barrido adecuado y pulse **Seleccionar referencia**.

*Nota: Después de seleccionar un barrido de referencia, la tecla **Referencia: Apagado** del menú "Opciones" cambia a **Referencia: Encendido**.*

Nota: Sólo se pueden visualizar los barridos con el mismo rango y fase de longitud de onda mediante la opción de superposición. Este proceso se puede repetir hasta visualizar todos los barridos que coincidan.

4. La curva de referencia aparece en naranja. El valor de absorbancia o transmitancia y la longitud de onda asociada se resaltan en naranja.
 - Asimismo, la diferencia del valor de absorbancia o transmisión entre los dos barridos (medido y de referencia) se indica o resalta en cada posición del cursor.

Nota: Una casilla azul y naranja se muestra en la esquina izquierda de la pantalla. El cuadro naranja está relacionado con el barrido de referencia y el negro con el barrido de longitud de onda actual.

5. Pulse el cuadro negro o naranja situado en la esquina superior izquierda de la pantalla para cambiar del barrido de longitud de onda real al de referencia.

6.7 Cinéticas en el tiempo de absorbancia/transmitancia

El modo Cinéticas en el tiempo se usa para recopilar datos de absorbancia o transmitancia para un intervalo de tiempo especificado por el usuario. Estos datos se pueden mostrar en formato gráfico o tabular. Mientras se está realizando el barrido, se debe cerrar la cubierta del compartimento de cubetas. Por lo tanto, no es posible realizar un barrido del compartimento de cubetas redondas.

6.7.1 Parámetros de configuración de Cinéticas en el tiempo


1. Pulse modo **Cinéticas en el tiempo** en el Menú Principal.

2. Pulse **Opciones** para configurar los parámetros.



Tabla 16 Opciones de Cinéticas en el tiempo


Opciones	Descripción
Más	Para otras opciones.
Icono de carpeta	Para memorizar los datos de los barridos.
Tiempo e Intervalo	Para introducir el tiempo total para la recopilación de datos y el intervalo de tiempo entre la recopilación de los puntos de datos.
1	Para introducir la configuración de longitud de onda.
Ver tabla	Para visualizar las lecturas de absorbancia, transmitancia o concentración. Se puede cambiar tras la recopilación de datos de la muestra.
Escala y Unidades	Escala: En el modo de escala automática, el eje "y" se ajusta automáticamente de forma que se visualice el barrido total. El modo de escala manual permite la visualización de secciones del barrido. Unidades: Se debe elegir entre absorbancia o transmitancia.
Enviar datos	Para enviar datos a una impresora, PC o memoria USB (tipo A).
Recuperación de datos de mediciones	Recuperación de datos de mediciones guardados, barridos de longitudes de onda o cinéticas en el tiempo, véase sección 5.3, página 43.
Configuración del instrumento	Datos básicos del instrumento, consulte sección 5.2, página 27.

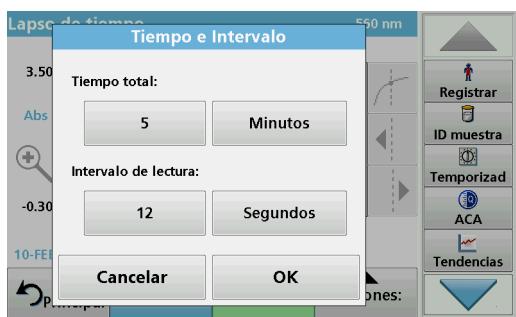

Tiempo e Intervalo:

1. Pulse **Tiempo e Intervalo** en el menú "Opciones".
2. Introduzca el tiempo total y el intervalo de medición.
3. Pulse **OK** para confirmar.

Nota: En total, se pueden emprender un máximo de 500 mediciones durante un barrido. Para seleccionar un tiempo total y un intervalo de tiempo que pueda provocar que se exceda este número de mediciones, el intervalo de tiempo se define automáticamente y se desactiva la tecla **OK**.

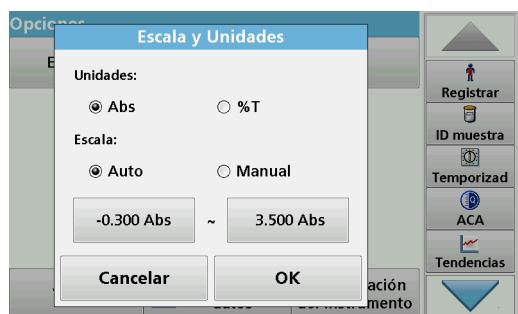

Escala y Unidades:

1. Pulse **Escala y Unidades** en el menú "Opciones".
2. Seleccione **Abs** o **%T** como unidades.
3. Seleccione Auto o Manual para la escala en el eje "y" del gráfico.
4. Pulse **OK** para confirmar.
5. Pulse **Volver** para regresar al modo de barrido.

6.7.2 Medición de cinética en el tiempo




Una vez seleccionados todos los parámetros del barrido, el instrumento se debe ajustar a cero. Posteriormente, se puede analizar la muestra.

1. Introduzca la cubeta de solución cero en el compartimento de cubetas y cierre la cubierta.
 2. Pulse **Cero**.
- La lectura de blanco aparece en la pantalla.
3. Introduzca la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas y cierre la cubierta.
 4. Pulse **Medición**.

El instrumento comenzará a recopilar los datos de cinéticas en el tiempo (datos cinéticos).

Nota: Durante la medición, las teclas **Cero** y **Medición** cambian a **Marcar** e **Interrumpir**.

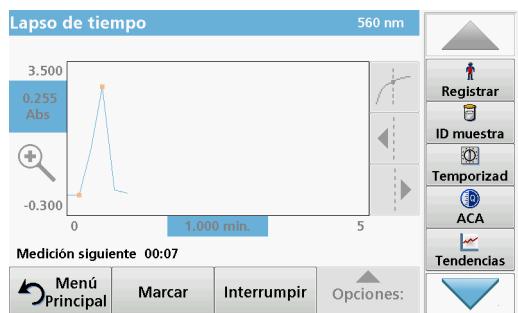

- **Seleccione Marcar** para marcar el siguiente punto de datos recopilado. El instrumento no utiliza esta marca, pero está disponible para el usuario y puede indicar un evento significativo, como la adición de una muestra u otro reactivo. La marca también aparece en la tabla.
- **Seleccione Interrumpir** para interrumpir la toma de lecturas de muestras.

6.7.3 Análisis de los datos de cinética en el tiempo

Después de recopilar los datos de la cinética en el tiempo, se pueden llevar a cabo las siguientes manipulaciones en los datos gráficos:



El programa de **Cinéticas en el tiempo** está completo si

- los instrumentos emiten un pitido después de que transcurra todo el tiempo
- el gráfico aparece a tamaño completo,
- la escala del eje "x" se produce automáticamente,
- las funciones del cursor en la barra de exploración vertical aparecen resaltadas.

6.7.3.1 Exploración de un escaneado de tiempo o un análisis de escaneado de tiempo

Después de haber realizado un escaneado de tiempo, los datos de tiempo y absorbancia/transmitancia se visualizan en forma de curva.

En el lugar de la curva en el que esté ubicado el cursor, se resaltarán el tiempo transcurrido hasta dicho punto y la absorbancia correspondiente.


Tabla 17 Exploración del escaneado de tiempo

Función del cursor/ Función de zoom	Descripción
Icono de curva (Selección del Modo Cursor)	Modo Delta: Se selecciona un segundo cursor. La posición del cursor fijo estaba definida con anterioridad en el Modo Cursor Puntual. Utilice el cursor activo para seleccionar cualquier punto de la curva de mediciones. La diferencia con el cursor fijo se muestra en la curva. Los valores delta están igualmente seleccionados y aparecen en los ejes "x" e "y". El gradiente de la curva y el coeficiente de correlación (r^2) entre los puntos del cursor en el Modo Delta se muestran bajo la curva.
	Modo Cursor, Puntual: El cursor se desplaza a cada punto de medición seleccionado del barrido.
Teclas de flecha	Las teclas de flecha (izquierda/derecha) se usan para desplazar el cursor (según el modo seleccionado) al siguiente punto de datos. Los datos del punto de datos (valor de transmitancia, absorbancia o longitud de onda) aparecen resaltados en los ejes "x" e "y". Nota: Pulse cualquier punto de la curva para visualizar los datos asociados.
Icono de zoom	Esta función se usa para ampliar la sección de la curva donde se sitúa el cursor. El tamaño original de la curva se puede restablecer presionando de nuevo el icono del zoom.

6.8 Pruebas del sistema



1. Pulse **Pruebas del sistema** en el Menú Principal.



El menú "Pruebas del sistema" contiene información del instrumento y varios test de rendimiento.


6.8.1 Información del instrumento



1. Pulse **Información del instrumento** en el menú "Pruebas del sistema".
2. Aparecerán el modelo, el número de serie y la versión del software.

6.8.2 Actualización del software del instrumento


Para obtener el software para la actualización a través de Internet en www.hach-lange.com.

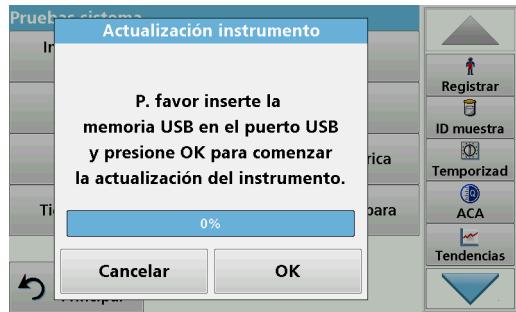

1. Visite <http://www.hach-lange.com>.
 2. Seleccione un país y vaya a **Descargar>Software**.
 3. Escriba **DR 3900** en "Búsqueda de documentos".
 4. Desplácese al correspondiente archivo para descargar.
 5. Abra el archivo ZIP y guarde los archivos en el dispositivo de almacenamiento USB o en la PC. Los archivos deben ser descomprimidos antes de ser guardados en el dispositivo de almacenamiento USB o en la PC.
 6. Pulse **Actualización de instrumento** en el menú "Verificación de sistema".
 7. Conectar la memoria USB al puerto USB (tipo A) del instrumento, consulte [sección 3.5, página 18](#).
 8. Pulse **OK** para confirmar.
- La conexión se establece automáticamente y se actualiza el software.
9. Pulse **OK** para volver al menú "Pruebas del sistema".

Nota: Tras la actualización del instrumento, aparecerá un mensaje que indica que lo reinicie.

6.8.3 Pruebas ópticas

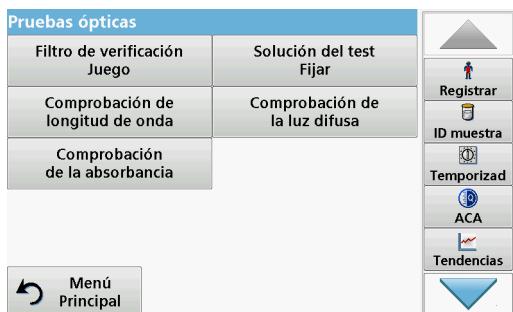

1. Pulse **Pruebas ópticas** en el menú "Pruebas del sistema".

El menú "Pruebas ópticas" contiene programas para la verificación de la exactitud de la longitud de onda, la luz difusa y la exactitud fotométrica.

Un conjunto de filtros de prueba (kit de verificación) [Sección 9, página 141](#) con seis filtros de vidrio de precisión, con valores especificados y con instrucciones está disponible como ayuda para completar verificaciones generales de instrumentos en el lugar de trabajo.

6.8.3.1 Kit de verificación

El Kit de verificación (consulte [Sección 9, página 141](#)) está diseñado para la supervisión periódica de la luz dispersa, la exactitud fotométrica y la exactitud de longitud de onda de los espectrofotómetros.

Si los resultados sobrepasan las tolerancias permitidas (indicadas en el certificado de control de calidad), póngase en contacto con el fabricante.



1. Pulse **Kit de verificación** en el menú "Pruebas ópticas".

2. Pulse **Valores nominales**.



3. Pulse **Edición**.


Una guía automática de menú solicita los valores (filtros, longitud de onda, valores nominales y tolerancias) indicadas en el certificado de control de calidad, para las siguientes especificaciones:

- Luz difusa
- Exactitud fotométrica
- Exactitud de longitud de onda


4. Pulse **OK** cuando haya completado todos los valores y aparezca el resumen.



5. Pulse **Verificación**.
6. Introduzca el adaptador de cubeta A ([Figura 3, página 19](#)) en el compartimento de cubetas (2).

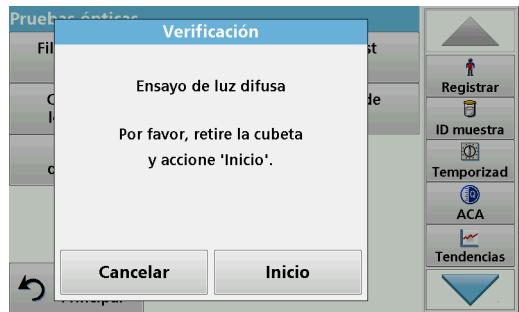

7. Retire todas las cubetas restantes del compartimento de cubetas.
8. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
9. Pulse **Inicio**.

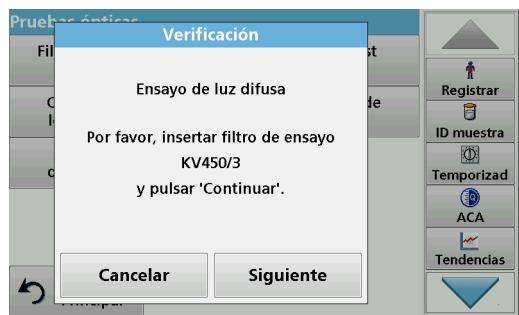

10. Siga las instrucciones de la pantalla y coloque diversos filtros, uno detrás de otro, en el orden que se indica.
11. Pulse **Siguiente** tras introducir un filtro.



Después de la última medición, se visualizarán los resultados.

12. Pulse el icono de **PC e Impresora** para enviar los datos a la memoria USB, el PC o la impresora.

Los archivos se memorizarán automáticamente como archivos CSV (valor separado por comas). El nombre del archivo se indicará como: "Verification.csv".

6.8.3.2 Test de soluciones


El set del test de soluciones (consulte [Sección 9, página 141](#)) sirve de control de calidad rutinario para comprobar la exactitud fotométrica del espectrofotómetro correspondiente.

Si los resultados sobrepasan las tolerancias permitidas (indicadas en el certificado de control de calidad), póngase en contacto con el fabricante.



1. Pulse **Test de soluciones** en el menú "Pruebas ópticas".


2. Pulse **Valores nominales**.

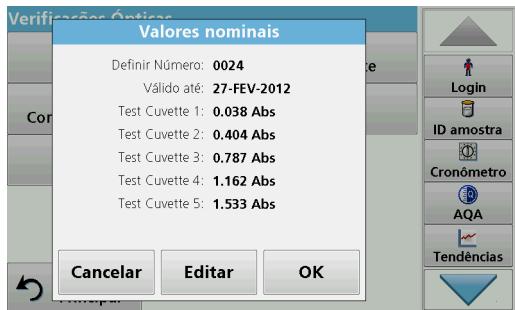


3. Pulse **Edición**.

Una guía automática de menú solicita los valores (filtros, longitud de onda y valores nominales, mínimos y máximos) indicados en el certificado de control de calidad, para las siguientes especificaciones:


4. Pulse **OK** cuando haya completado todos los valores y aparezca el resumen.

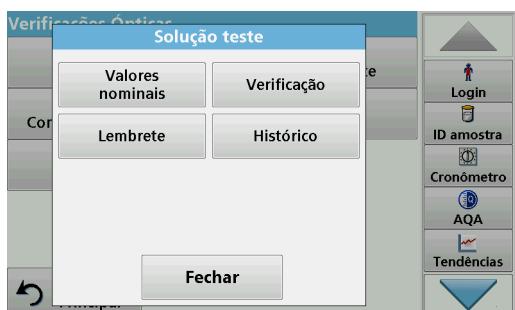


5. Pulse **Verificación**.

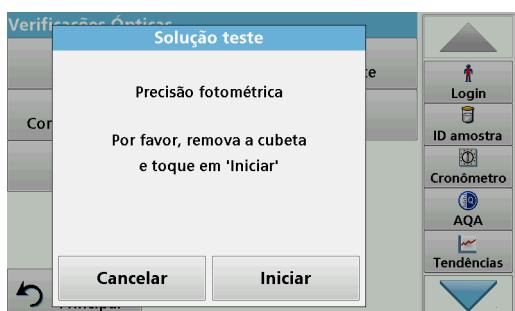

6. Quite todas las cubetas y pulse **Inicio**.




7. Introduzca la cubeta de muestra 1 (Figura 3, página 19) en el compartimento de cubetas (1) y pulse **Seguinte**.
8. Siga las instrucciones indicadas en el cuadro de diálogo.



9. Tras la quinta cubeta del test, la exactitud fotométrica se muestra en un registro.

6.8.3.3 Comprobación de longitud de onda

La prueba Comprobación de longitud de onda se usa para verificar la exactitud de la longitud de onda a 807 nm.



1. Pulse **Comprobación de longitud de onda** en el menú "Pruebas ópticas".
2. Introduzca el adaptador (A) para cubetas rectangulares de 10 mm en el compartimento de cubetas (2).
3. Coloque la cubeta (Neodimio/BG20/2) en el adaptador de cubetas.
4. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
5. Pulse **Inicio**.




Aparecerá el resultado.


6. Compare el resultado con los valores requeridos de la cubeta de análisis.
7. Pulse **Cancelar** para regresar a Pruebas ópticas.

6.8.3.4 Comprobación de la luz difusa

La prueba Comprobación de la luz difusa se utiliza para medir la luz difusa del instrumento a 340 nm.

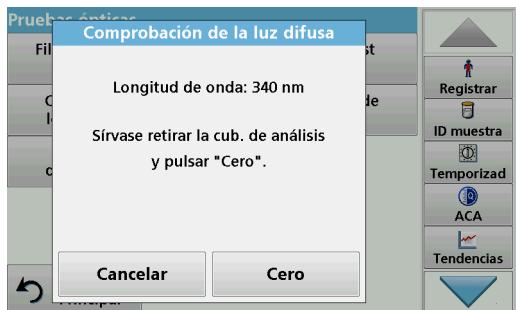

1. Pulse **Comprobación de la luz difusa** en el menú "Pruebas ópticas".
2. Quite las cubetas o cubetas de análisis del compartimento de cubetas.
3. Coloque el adaptador (A) para cubetas rectangulares de 10 mm en el compartimento de cubetas (2).
4. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
5. Pulse **Cero**.
6. Introduzca la cubeta de análisis en el compartimento de la cubeta (2).
7. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
8. Pulse **Inicio**.

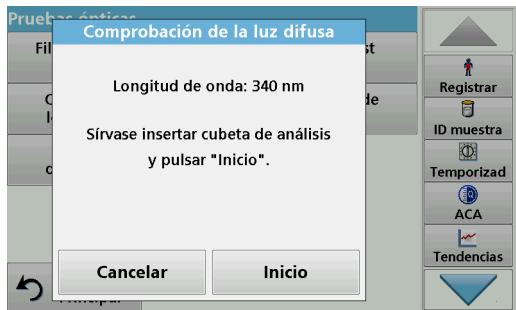


El valor medio se calcula a partir de tres mediciones consecutivas de la absorbancia.

Aparecerá el resultado.


9. Compare el resultado con el valor requerido de la cubeta de análisis.
10. Pulse **Cancelar** para regresar a Pruebas ópticas.

6.8.3.5 Comprobación de la absorbancia

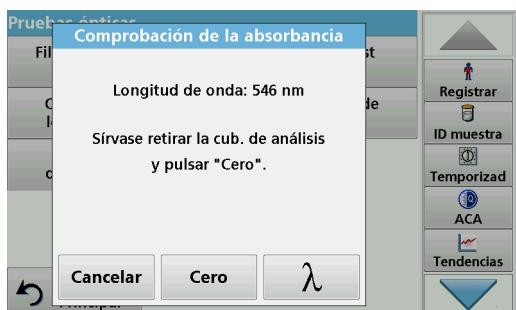

La prueba Comprobación de la absorbancia se utiliza para verificar la exactitud y repetibilidad fotométrica del instrumento.

1. Presione **Comprobación de la absorbancia** en el menú "Pruebas ópticas".
2. Presione λ para ingresar la longitud de onda.
3. Pulse **OK** para confirmar.
4. Retire todas las cubetas del compartimento de cubetas.
5. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
6. Pulse **Cero**.

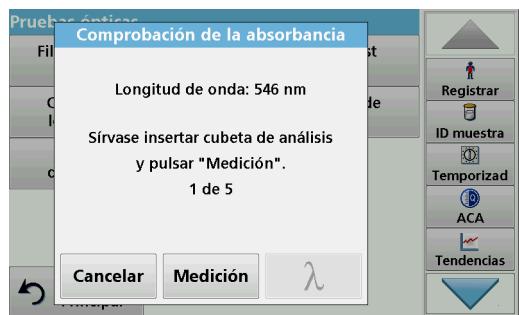


7. Coloque la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas.
8. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
9. Pulse **Medición**.
10. Retire la cubeta de análisis.
11. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
12. Pulse **Cero**.
13. Coloque la cubeta de análisis en el compartimento de cubetas.
14. Cierre la cubierta del compartimento de cubetas.
15. Pulse **Medición**.
16. Repita este procedimiento hasta que se hayan obtenido 5 mediciones de comparación.



- Aparecerá el resultado.
17. Compare el resultado con los valores requeridos de la cubeta de análisis.
 18. Pulse **Cancelar** para regresar a Pruebas ópticas.

6.8.4 ACA: Aseguramiento Calidad Analítica

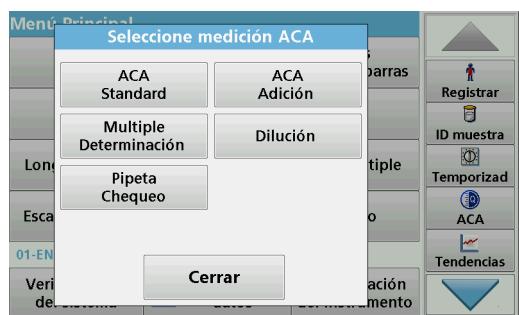

1. Presione **ACA** en el menú Pruebas del sistema para configurar las medidas ACA o **ACA** en la barra de herramientas hacia la derecha de la pantalla, para realizar la medida ACQA.

El menú ACA de Pruebas del sistema contiene el programa para comprobar la calidad analítica. Aquí se realiza la configuración, por ejemplo, el método de trabajo individual que se controla mediante soluciones estándar o las sensibilidades transversales de los análisis identificados por las soluciones de incorporación estándares, por determinaciones múltiples y por diluciones.

Existen soluciones estándares y completas disponibles como accesorios opcionales para un control individual completo ([Sección 9, página 141](#)).

6.8.4.1 Configuración del estándar ACA

El método de trabajo, los fotómetros y los accesorios se pueden verificar por medio del análisis de una solución patrón.

1. Pulse **Standard ACA**

Se abre una pantalla con conjuntos de estándares (no disponible en todos los modelos) y, de forma alternativa, se puede definir un estándar individual.
 2. Seleccione **Opciones>Nuevo** para definir un nuevo patrón.

Nota: Si aún no se ha definido ninguno, en algunos modelos el teclado alfanumérico aparece directamente.
 3. Introduzca el **nombre** de la solución estándar y confirme con **OK**.
 4. Introduzca la **unidad de concentración** y el **intervalo de confianza** tocando los campos correspondientes.
 5. Presione **OK** para confirmar el ingreso.

NO3

Concent. Stndard: Unidad:

Interv. confianza:


Cancelar
OK

6. Se muestran en la pantalla todas las soluciones estándar ingresadas.
 7. Seleccione **Opciones>Editar** para cambiar los ajustes.

Standard ACA	
LCA701	▼
LCA702	
LCA703	
LCA704	
LCA705	
LCA706	
LCA707	
LCA708	
LCA709	
NO3	100 ± 5.00 mg/l ▼
Volver <apagado> Opciones: Seleccione	
 Registrar  ID muestra  Temporizador  ACA  Tendencias	

8. Seleccione **Opciones>Borrar** para borrar el patrón.
Seleccione **Opciones>Nuevo** para definir un nuevo patrón.

Programas avanzados

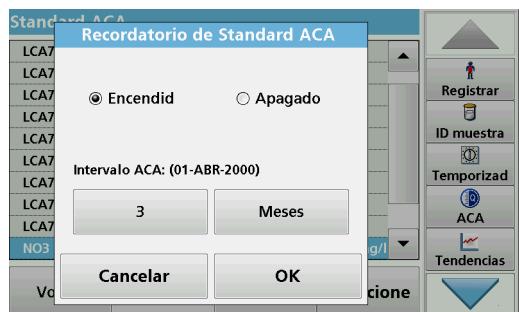


9. Seleccione **Opciones>Recordatorio** para ingresar un intervalo automático cuando sea necesario realizar un análisis del patrón.

10. Pulsar **Encendido**.




11. Seleccione el intervalo adecuado. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

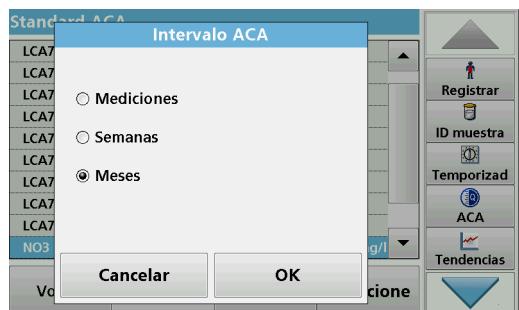

12. Seleccione una unidad para el intervalo. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

6.8.4.2 Adición ACA

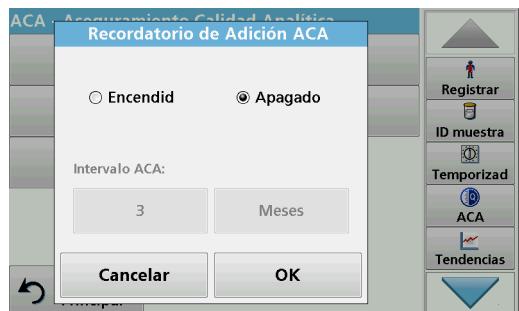

El análisis de una solución de incorporación permite realizar una comprobación de errores e interferencias en la muestra.

1. Pulse **Adición ACA**.

2. Pulsar **Encendido**.

ACCA - Aseguramiento Calidad Análisis

Meses

3_

7 8 9 CE

4 5 6 ←

0 1 2 3

Cancelar OK

- Introduzca el intervalo deseado y el sistema emitirá automáticamente un mensaje que solicita agregar un análisis. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

ACCA - Aseguramiento Calidad Análisis

Intervalo ACA

Mediciones

Semanas

Meses

Cancelar OK

- Defina la unidad necesaria para el intervalo. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

6.8.4.3 Determinación múltiple

ACCA - Aseguramiento Calidad Análisis

Determinación múltiple ACA

Recordatorio: <apagado>

Mediciones: 2 Tolerancia [%]: 10

Cancelar OK

- Pulse **Determinación múltiple**.
- Presione Recordatorio <Apagado>.
- Pulsar **Encendido**.
- Seleccione el intervalo adecuado. Pulse **OK** para confirmar la introducción.
- Seleccione una unidad para el intervalo. Pulse **OK** para confirmar la introducción.

ACCA - Aseguramiento Calidad Análisis

Mediciones:

2_

7 8 9 CE

4 5 6 ←


0 1 2 3

Cancelar OK

- Introduzca el número de mediciones para las determinaciones múltiples. Pulse **OK** para confirmar.
- Introduzca la tolerancia en porcentaje. Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse **OK** para confirmar todas las introducciones.

Programas avanzados


6.8.4.4 Dilución

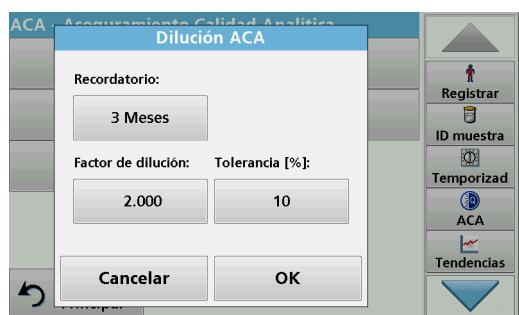


1. Pulse **Dilución**.
2. Pulse **Encendido**.
3. Seleccione el intervalo adecuado. Pulse **OK** para confirmar la introducción.
4. Seleccione una unidad para el intervalo. Pulse **OK** para confirmar la introducción.
5. Introduzca el factor de dilución. Pulse **OK** para confirmar.
6. Introduzca la tolerancia en porcentaje. Pulse **OK** para confirmar.
7. Pulse **OK** para confirmar todas las introducciones.

6.8.4.5 Realización de una medida ACA

Si se estableció una función de recordatorio, una vez que transcurrió el intervalo establecido, se emite el requisito para realizar una medida ACA.

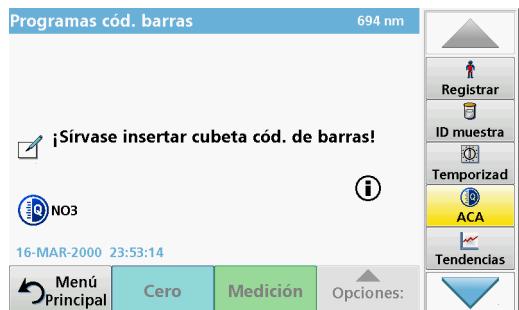

1. Seleccione la medida ACA requerida, por ejemplo una medida estándar aquí.
2. Realice la medida estándar mediante el **programa almacenado** o el **programa de código de barras**.
3. En la ventana de la medición, aparece un símbolo ACA y la tecla ACA de la barra de herramientas aparece de color amarillo.
4. La medida ACA se muestra en un registro como **Aprobado** o **Fallido**.

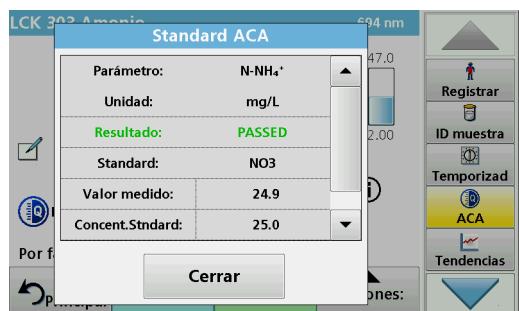


6.8.4.6 Set de chequeo de pipetas

Esta función y los accesorios opcionales sirven para analizar la exactitud de las pipetas. Para realizarlo, siga las instrucciones del correspondiente set.

6.8.5 Backup de instrumento

Antes de la siguiente fecha de inspección, "Backup de instrumento" ofrece la oportunidad de almacenar todos los

programas, datos de mediciones, ID de usuario, contraseñas y todos los datos ajustables en una memoria USB.

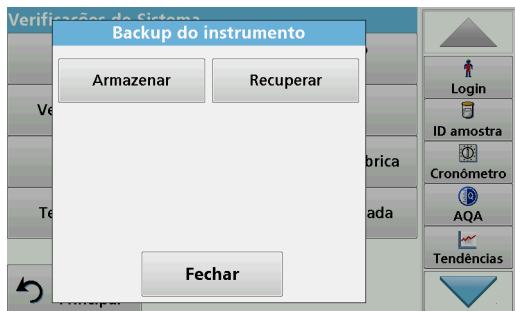

1. Pulse **Backup de instrumento** en el menú "Pruebas del sistema".
2. Introduzca la memoria USB (consulte [sección 3.5, página 18](#)).
3. Pulse **Memorizar** para iniciar un backup.



Si el archivo se ha almacenado, aparecerá el mensaje "Backup de instrumento se almacenó".

4. Pulse **OK** para volver al menú "Pruebas del sistema".



Recuperación de datos de backup:


Nota: *Todos los datos actuales se sobrescribirán al recuperar el archivo de backup.*

1. Pulse **Backup de instrumento** en el menú "Pruebas del sistema".
2. Introduzca la memoria USB con la copia de seguridad (consulte [sección 3.5, página 18](#)).
3. Pulse **Recuperar** para copiar los datos.
4. El informe "¿Restaurar copia de seguridad de instrumento a partir de S/N XXXXXXXX?" indica la versión de la copia de seguridad. Pulse **OK** para confirmar.
5. Reinicie el instrumento luego de que se haya completado el backup.



Programas avanzados

6.8.6 Menú Servicio

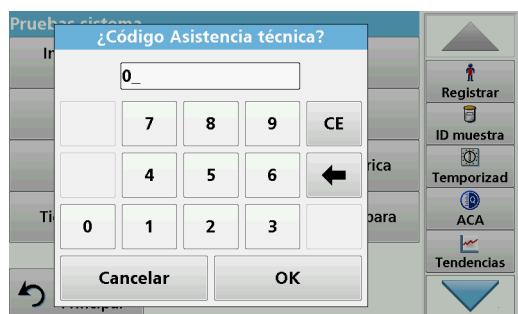

Para utilizar el menú Servicio, es necesario un código de servicio. Este menú está reservado exclusivamente para el departamento de Service.

6.8.7 Tiempos de servicio

Para garantizar que se realiza una inspección regular, se puede introducir una referencia de memoria automática para los tiempos de servicio. Después del encendido del instrumento, esta referencia de memoria se activará y se indicará en el momento adecuado.



1. Pulse **Tiempos de servicio** en el menú "Pruebas del sistema".
2. Active la casilla de verificación **Encendido**.
3. Pulse **Última inspección**.
4. Introduzca la fecha de la última inspección.
5. Pulse **OK** para confirmar la selección.



6. Active el campo de opciones bajo **Siguiente inspección**.
7. Seleccione un intervalo de tiempo para la siguiente inspección.
8. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Cuando se cumple el plazo del siguiente servicio, se muestra el informe "**Plazo del siguiente servicio**" cuando se enciende el instrumento.

9. Presione **OK** para volver al menú principal.

Comuníquese con el fabricante para programar la fecha de realización del siguiente servicio.

6.8.8 Tiempo de funcionamiento de las lámparas

El tiempo de funcionamiento de la lámpara proporciona información acerca de los ciclos de encendido de las lámparas.



Después de sustituir una lámpara, en la pantalla se restablecerán a cero los ciclos de encendido.

1. Pulse **Histórico de la lámpara** en el menú "Pruebas del sistema".
2. Pulse **Resetear** para restablecer los datos de la lámpara.
3. Pulse **OK** para volver al menú "Pruebas del sistema".

6.9 Barra de herramientas



El lado derecho de la pantalla contiene un barra de herramientas con varios programas. Muchos de estos programas también se pueden abrir por medio de un menú, pero la operación es la misma.

6.9.1 Inicio de sesión



Utilice esta función para ingresar hasta 30 iniciales de operador diferentes (hasta 10 caracteres cada una) en el instrumento. Esta característica ayuda a registrar al usuario que mide cada muestra. Para leer una descripción detallada, consulte [sección 5.2, página 27](#).

6.9.2 ID de la muestra



Utilice esta opción para introducir hasta 100 etiquetas de identificación de muestras diferentes (de hasta 20 caracteres cada una) en el instrumento. El ID de la muestra se puede utilizar para detallar la ubicación de la muestra u otra información específica de la muestra, por ejemplo. Para leer una descripción detallada, consulte [sección 5.2.2, página 29](#).

Programas avanzados

6.9.3 Temporizador



Utilice esta función para activar un temporizador en cualquier momento.

1. En la barra de herramientas, pulse **Temporizador**.
2. Introduzca el tiempo deseado y confirme con **OK**.



La cuenta atrás comienza automáticamente.

3. Pulse **Cerrar** para que el temporizador funcione en segundo plano.
Pulse **Cancelar** para detener el temporizador.
4. Cuando el temporizador finaliza, se emite un sonido.

6.9.4 ACA



El menú "ACA" contiene los programas para probar la calidad analítica. Por ejemplo, controla el método de trabajo individual con soluciones patrón o las sensibilidades cruzadas de los análisis identificadas por soluciones de adición, determinaciones múltiples y diluciones. Para obtener una descripción detallada, consulte [sección 6.8.4, página 120](#).

6.9.5 Tendencias

Utilice esta función para abrir una curva ya cargada de los valores de medición almacenados de cada parámetro o ubicación de la muestra. La concentración del parámetro correspondiente se muestra de manera gráfica a lo largo del tiempo. Para leer una descripción detallada, consulte [sección 5.3.4.1, página 52](#).

6.9.6 Link2SC

Link2SC permite intercambiar valores de medición entre las sondas de proceso en continuo y el DR3900. De esta forma, se pueden verificar los datos en continuo y se pueden corregir las sondas de proceso.

Los datos en continuo se envían al DR 3900 en un "archivo de trabajo". Una vez producidos los valores de medición del

laboratorio, el archivo de trabajo se envía de nuevo al controlador para que se corrija la sonda correspondiente.

La transferencia de datos se realiza a través de la tarjeta de memoria o de la red (LAN). Para obtener una descripción detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento de Link2SC.

6.9.7 Sitio web de DR3900

Utilice esta función para abrir un sitio web de Internet en una conexión de red existente. Aquí se pueden encontrar las actualizaciones de software actuales, así como la documentación e información de DR 3900.

El etiquetado de la tecla varía de un modelo a otro y puede variar de la ilustración en estas instrucciones.

⚠ ATENCIÓN

Posibles peligros químicos y biológicos en la piel y los ojos.
Las tareas descritas en esta sección deben ser efectuadas por personal cualificado.

AVISO

Quite todas las cubetas que queden en el instrumento. Deseche las cubetas o su contenido de forma autorizada.

7.1 Requisitos de limpieza

⚠ ATENCIÓN

Posibles peligros químicos, quemaduras y daños en los ojos.
Antes de limpiarlo, siempre desconecte el instrumento de la fuente de alimentación.

AVISO

Nunca utilice disolventes como trementina, acetona o productos similares para limpiar el instrumento, incluida la pantalla y los accesorios.

7.1.1 Espectrofotómetro

- Limpie la carcasa, los compartimentos de cubetas y todos los accesorios únicamente con un paño suave húmedo. También se puede usar una solución jabonosa.
- No deje restos de agua en los compartimentos de cubetas.
- No introduzca cepillos u objetos afilados en el compartimento de cubetas nº 1 para no dañar los componentes mecánicos.
- Seque las partes limpiadas con cuidado con un paño suave de algodón.

7.1.2 Pantalla

- No raye la pantalla. Nunca toque la pantalla con bolígrafos, lápices u objetos con punta.
- Limpie la pantalla con un paño de algodón suave, sin aceites ni pelusa. También se puede usar líquido limpiador de ventanas diluido.

7.1.3 Cubetas

⚠ ATENCIÓN

Possible peligro por exposición química o biológica.

Utilice los procedimientos de laboratorio correctos si existe el riesgo de exposición a productos químicos.


1. Despues de utilizarlas, limpie las cubetas de cristal con sustancias de limpieza.
2. Luego, enjuague las cubetas varias veces con agua corriente y, a continuación, concienzudamente con agua desionizada.

Nota: Las cubetas de vidrio que han sido utilizadas para disolventes orgánicos (como cloroformo, benceno, tolueno, etc.) se deben lavar con acetona antes de ser tratadas con productos de limpieza. Asimismo, es necesario otro enjuague con acetona como fase final del tratamiento antes de secar las cubetas.

7.2 Sustitución de la lámpara

⚠ ATENCIÓN

Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte el instrumento de la fuente eléctrica antes de cambiar la lámpara.

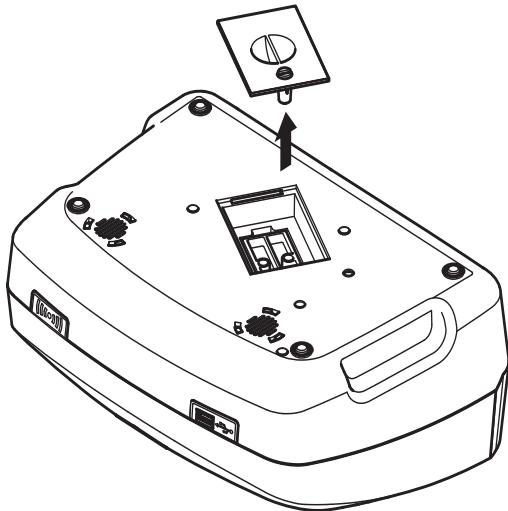


1. Apague el instrumento.
2. Quite el cable de alimentación eléctrica del instrumento.
3. Gire el instrumento para poder acceder a su parte inferior para trabajar en él.
4. Utilice un destornillador de cabeza plana para quitar los tornillos de la cubierta de la lámpara.
5. Retire la cubierta.

AVISO

Peligro de quemadura.

Espere hasta que la lámpara se enfrie. El contacto con la lámpara caliente puede provocar quemaduras.

6. Utilice un destornillador de estrella para quitar los dos tornillos del soporte de la lámpara.

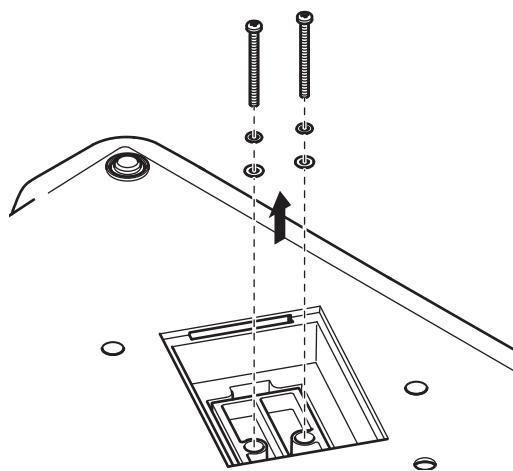

7. Levante el soporte de la lámpara hacia arriba.
8. Gire el soporte de la lámpara para que en conector con la guía de cable apunten hacia adelante.
9. Empuje el deslizador de la abrazadera todo lo posible a la derecha (paso 1).
10. Sujete el conector con la lámpara, quitándolo del soporte de la lámpara (paso 2).
11. Suelte el conector de la lámpara (paso 3).


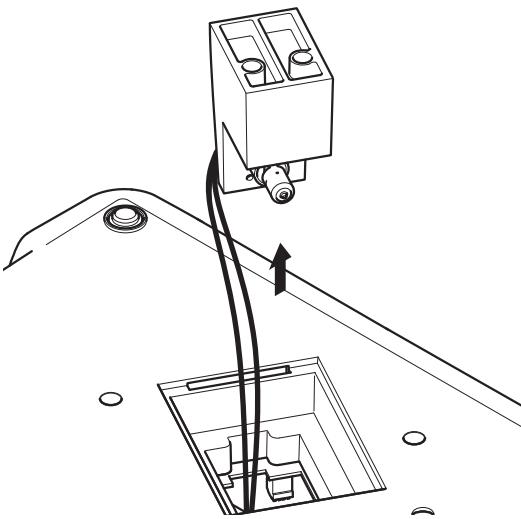


Figura 8 Sustitución de la lámpara

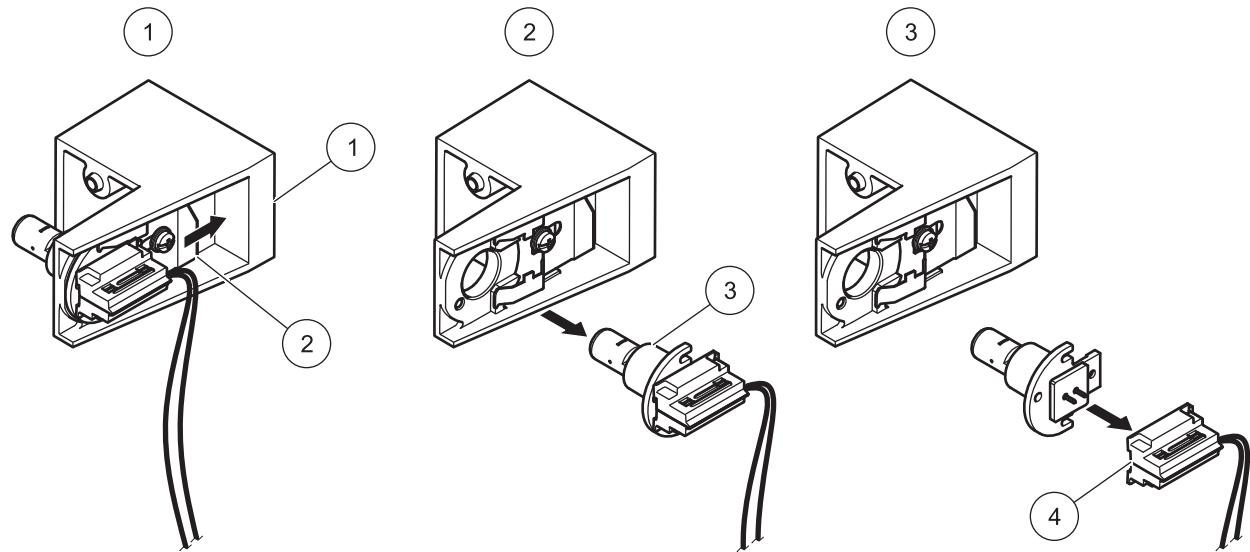

1 Soporte de la lámpara	3 Lámpara
2 Deslizador de abrazadera	4 Conector

Para colocar una lámpara nueva, realice el procedimiento a la inversa.

AVISO


Para sujetar la lámpara, utilice únicamente el soporte de la lámpara. Evite tocar el vidrio, ya que las sustancias de la piel pueden fundirse en la bombilla y acelerar el proceso de envejecimiento de la lámpara.

1. Conecte una nueva lámpara al conector.
 2. Instale la lámpara con el conector en el soporte de la lámpara.
 3. Fije la lámpara con el deslizador de abrazadera. Para ello, empuje el conector hacia abajo y empuje el deslizador de la abrazadera todo lo posible hacia la izquierda.
 4. Instale el soporte de la lámpara en el instrumento.
- Nota: Tenga cuidado de que la guía de cable no pellizque el cable de la lámpara.*
5. Utilice un destornillador de estrella para apretar los dos tornillos del soporte de la lámpara.
 6. Vuelva a colocar la tapa de la lámpara.
 7. Utilice un destornillador de cabeza plana para apretar los tornillos de la cubierta.
 8. Conecte el cable de alimentación al instrumento.
 9. Restablezca el tiempo de funcionamiento de la lámpara [sección 6.8.8, página 126](#).


7.3 Cambio del compartimento de cubetas reemplazable

Si hay mucha suciedad, se puede cambiar el compartimento de cubetas (2) completo.

1. Apague el instrumento.
2. Quite el cable de alimentación eléctrica del instrumento.
3. Utilice un destornillador de estrella para quitar los dos tornillos de la base del compartimento de cubetas.

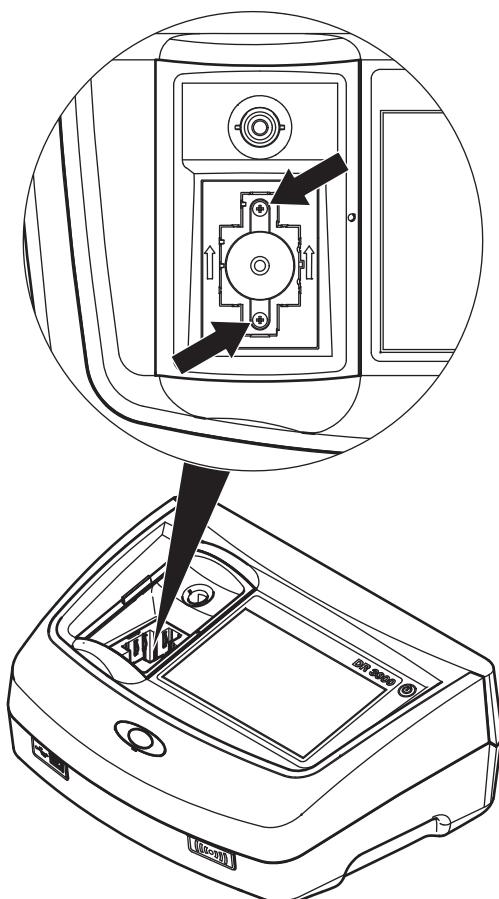

4. Levante el receptáculo de las cubetas hacia arriba y luego sáquelo.
5. Coloque el nuevo receptáculo de forma que la ranura de guía de los rodillos de presión quede a la izquierda.
6. Utilice un destornillador de estrella para apretar los dos tornillos en la base del compartimento de cubetas.
7. Conecte el cable de alimentación al instrumento.

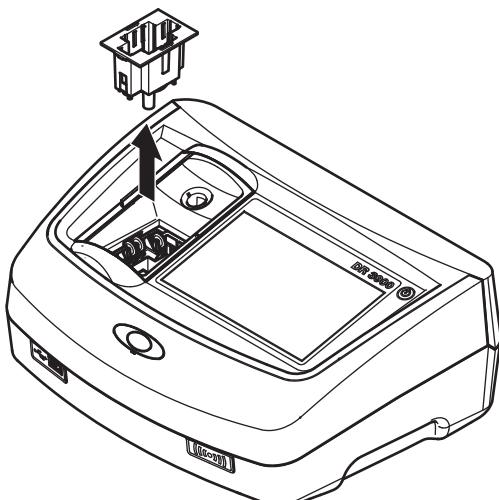

Sección 8 Solución de problemas

Error mostrado	Definición	Resolución
¡Atención! Inserte el protector de luz	Las mediciones con cubetas de código de barras suelen requerir protector de luz.	Introduzca el protector de luz. Pulse OK .
Etiqueta del código de barras no leída	Código de barras defectuoso.	Vuelva a introducir la cubeta. Si no se reconoce el código de barras, póngase en contacto con el fabricante o su representante.
Se produjo un error al cargar los datos del instrumento.		Vuelva a iniciar el procedimiento o comuníquese con la asistencia técnica.
Se produjo un error al leer la memoria USB.		Vuelva a iniciar el procedimiento o comuníquese con la asistencia técnica.
Se produjo un error al escribir en la memoria USB.		Vuelva a iniciar el procedimiento o comuníquese con la asistencia técnica.
Compruebe el último fichero de actualización.	Error durante la actualización.	Compruebe la memoria USB.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente.	Error durante la actualización.	
Compruebe la configuración de red.		
Compruebe la conexión.		
Cierre la tapa.		Tápela.
Inserte la memoria USB.		Introduzca una memoria USB en un puerto USB A del instrumento.
Compruebe la conexión y contacte con su administrador.	Error de configuración de red o FTP.	
No es posible corregir el valor blanco	La corrección del valor de blanco no es posible con LCW919.	
Actualización del instrumento. Archivo perdido.	Error durante la actualización.	Compruebe la memoria USB.
Actualización del instrumento. Archivo dañado.	Error durante la actualización.	Vuelva a guardar el archivo de actualización y repita el procedimiento.
Se recomienda realizar una verificación del sistema completa	La comprobación de los valores de aire ha fallado.	Apague el instrumento y vuélvalo a encender. Si la verificación del sistema no es correcta, póngase en contacto con el fabricante o su representante.
Introducción no válida	Contraseña incorrecta.	¿Ha olvidado la contraseña? Póngase en contacto con el fabricante o su representante.
¡Absorbancia >3.5!	La absorbancia medida es superior a 3,5.	Diluya la muestra y vuelva a realizar la medición.
Fallo ¿Nº de control del cód. de barras? Actualice datos del programa	Desviación respecto a los datos almacenados.	Actualice datos del programa
Error al llamar a la dirección IP local.	Configuración de red: el cliente DHCP no tiene conexión con el servidor DHCP.	Vuelva a introducir la dirección IP.

Solución de problemas

Error mostrado	Definición	Resolución
Error durante la configuración del gateway por defecto.	Configuración de red: el gateway por defecto no se puede configurar para una dirección IP fija.	Intente volver a crear la conexión.
¡Error durante la configuración de la unidad de red!	Error durante la configuración de la red.	Compruebe los ajustes.
Error durante la configuración de la máscara de subred.	Configuración de red: la máscara de subred no se puede configurar para una dirección IP fija.	Vuelva a introducir la máscara de subred.
Error al copiar desde la memoria USB.	Error durante la actualización	Vuelva a iniciar el procedimiento o póngase en contacto con el fabricante o su representante.
Error en la conexión FTP.	Error de FTP.	Asegúrese de que el instrumento esté conectado a la red.
Fallo Programa no accesible. Actualice los datos del programa	Test de código de barras no presente.	Actualice datos del programa
Falla Limpie la cubeta	El tubo está sucio y contiene partículas sin disolver	Limpie la cubeta; deje que las partículas se sedimenten.
Fallo ¡Programa de test interrumpido! Compruebe la lámpara Cierre la tapa. Error [xx]	El programa de test se interrumpe cuando se inicia el instrumento.	Compruebe la lámpara y, si fuera necesario, cámbiela. Cierre la tapa. Pulse Volver a empezar .
Fallo Programa de test interrumpido. Retire la cubeta Cierre la tapa.	El programa de test se interrumpe cuando se inicia el instrumento.	Retire la cubeta del compartimento de cubetas. Pulse OK .
Error Autocomprobac. interrumpida. Error de hardware. Error [x]	Fallo electrónico.	Comuníquese con la asistencia técnica y proporcioneles el número de error
Error ¡Demasiada luz ambiental! Ponga el equipo a la sombra o cierre la tapa	Los sensores del instrumento detectan demasiada luz en el ambiente.	Disminuya la luz ambiental. (Evite los rayos directos del sol). Cierre la tapa.
Para este programa no existe ninguna función de ayuda.		
¡Se ha superado la vida útil! ¿Utiliza productos químicos?		Possiblemente el análisis es erróneo. Utilice productos químicos nuevos.
¡No existe evaluación!	Error en la base de datos de tests / base de datos del usuario.	Revise la programación Comuníquese con la asistencia técnica
¡Sin código de barras!	No se ha encontrado el código de barras.	Vuelva a introducir la cubeta. Si no se reconoce el código de barras, póngase en contacto con el fabricante o su representante.
¡Ningún backup de instrumento disponible!		Compruebe la memoria USB.
¡Datos no válidos para este parámetro!	No es posible realizar el análisis de datos, no hay datos de mediciones.	Cambie la selección.

Error mostrado	Definición	Resolución
No se han encontrado datos válidos.	No es posible ver los datos en el registro de datos.	Cambie la selección.
No disponibles datos de mediciones.	Los ajustes del análisis de datos no se pueden configurar sin datos de mediciones.	Cambie la selección.
¡Rango de control no alcanzado!	No se han alcanzado los límites del análisis de datos.	Se trata de una advertencia. No se ha alcanzado el límite de control fijado.
¡Se ha superado el rango de control!	Se han superado los límites del análisis de datos.	Se trata de una advertencia. Se ha superado el límite de control.
¡Concentrac. demasiado alta!	La concentración calculada es mayor que 999999.	Diluya la muestra y vuelva a realizar la medición.
Por encima del rango de medida	La absorbancia medida es superior al rango de calibración del test.	Diluya la muestra y vuelva a realizar la medición.
Por debajo del rango de medida	La absorbancia medida es inferior al rango de calibración del test.	Si fuera posible, seleccione un test con un rango de medida más bajo o utilice una cubeta que tenga un camino mayor.
Possible interferencia por:	Comprobación de interferencias.	Possiblemente el análisis es erróneo debido a interferencias.
Possible interferencia de:	Comprobación de interferencias.	Possiblemente el análisis es erróneo debido a interferencias.
¡Siguiente inspección está pendiente!	El recordatorio de servicio está activado.	Comuníquese con la asistencia técnica para programar una revisión del instrumento. Para configurar el recordatorio de servicio, consulte sección 6.8.7, página 126 .
¡Resultado negativo!	El resultado calculado es negativo.	Compruebe la concentración de muestra.
Red apagada.	La Configuración de red se apaga cuando se accede a la página de inicio de Instrumentos a través de la barra lateral	Active la conexión en línea.
Servidor remoto inalcanzable.	Error durante la configuración de la red.	Asegúrese de que el instrumento esté conectado a la red.
¡Condiciones de iluminación inestables!		Evite la luz directa del sol en la ubicación de medición.
Memoria insuficiente para la actualización.	Error durante la actualización.	Seleccione una memoria con más espacio.
Verificación del sistema incorrecta.	Ha fallado la medición de los valores del aire.	Apague el instrumento y vuélvalo a encender. Si la prueba del sistema no es correcta, comuníquese con la asistencia técnica.
Temperatura demasiado alta. ¡No es posible realizar la medición!		Apague el instrumento y deje que se enfríe unos minutos. Si es necesario, llévelo a un lugar más frío.
El archivo de actualización es defectuoso.	Error durante la actualización.	Vuelva a guardar el archivo de actualización y repita el procedimiento.
Memoria USB no conectada.	No es posible realizar la actualización.	Compruebe la memoria USB.
Servidor Web inalcanzable.	No se puede encontrar la página de inicio de Instrumentos	Vuelva a intentar realizar la conexión más tarde. Asegúrese de que el instrumento esté conectado a la red.

Sección 9 Piezas de repuesto

9.1 Accesorios

Descripción	Cat. No.
Conjunto de 10 botellas SIP para el DR3900 con una cubeta redonda de 1 pulgada, UE	LQV157.99.10001
Dispositivo de lectura/escritura RFID LOC 100: repetidor para ubicación RFID, UE	LQV156.99.10001
Soluciones para chequeo de absorbancia DR/Check	2763900
Kit de verificación	LZV537
Test de soluciones	LZV810
Escáner de códigos de barras manual	LZV566
Memoria USB	LZV568
Tapa de protección de puerto USB	LZV881
Cable de extensión USB	LZV567
Tarjeta de memoria SD	LZY520
Lector de tarjetas de memoria SD/MMC, conexión USB	LZY522
Cable Ethernet, blindado, 2 mm de longitud.	LZV873
Cable de interfaz USB (PC)	LZV632
Cable cruzado	LZX998
Cubetas rectangulares de 1 pulgada, emparejadas, cristal (10 ml)	2495402
Cubetas rectangulares de 1 cm, emparejadas, cristal (3,5 ml)	2095100
Cubeta rectangular de 1 cm, cuarzo	2624410
Cubeta redonda de 1 pulgada, con tapa (10 ml)	2122800
Cubetas redondas de 13 mm con tapón de goma	LCW 906
Microcubeta rectangular de un solo uso de 1 cm (1,5 ml)	2629500
Cubetas de plástico rectangulares de 1 cm	2743400
Cubeta rectangular de 5 cm, cristal (17,5 ml)	2629250
Cubeta rectangular de 5 cm, cuarzo (17,5 ml)	2624450
Cubeta rectangular de 5 cm, plástico con tapa	LZP341
Cubeta semi-micro de 5 cm, cristal óptico especial	LZP269
Cubeta de flujo rectangular de 1 cm, cuarzo (450 µl)	LZV510
Cubeta de flujo rectangular de 5 cm, cuarzo (370 µl)	LZV649
Tapones de neopreno para cubetas rectangulares de una pulgada, pk 12	1480801

9.2 Piezas de repuesto

Descripción	Cat. No.
Lámpara halógena	LPZ440.99.00007
Adaptador de cubetas A para cubetas redondas de 1 pulgada y rectangulares de 1 cm	LZV846
Adaptador de cubetas B para cubetas rectangulares de 3 cm, sólo China	LZV847
Protector de luz	LZV849
Fuente de alimentación de sobremesa	LZV844
Cable de conexión EU	YAA080
Cable de conexión CH	XLH051
Cable de conexión GB	XLH057
Cable de conexión US	XLH055
Cable de conexión China/Australia	XLH069
Funda guardapolvo	LZV845
Compartimento de cubetas	LZV848

Sección 10 Garantía, responsabilidad y reclamaciones

El fabricante garantiza que el producto suministrado no contiene defectos de fabricación ni de materiales, y asume la obligación de reparar o sustituir toda pieza defectuosa de forma gratuita.

El período de garantía para los instrumentos es de 24 meses. Si se suscribe un contrato de servicio en los 6 meses siguientes a la adquisición, el período de garantía se ampliará a 60 meses.

Con la exclusión de posteriores reclamaciones, el proveedor es responsable de defectos como la carencia de las propiedades garantizadas como sigue: todas aquellas piezas que, dentro del período de garantía calculado desde el día de la transferencia del riesgo, se pueda demostrar que han pasado a ser inservibles o que sólo se puedan utilizar con importantes limitaciones debido a una situación presente o previa a la transferencia del riesgo, en concreto debido a un diseño incorrecto, materiales de mala calidad o un acabado inadecuado, se mejorarán o sustituirán, a discreción del proveedor. A discreción del proveedor, se subsanarán estas deficiencias o se cambiará el instrumento. La identificación de tales defectos se debe notificar al proveedor por escrito sin demora en los siete días posteriores a la misma. Si el cliente no realizara la notificación al proveedor, se considerará que el producto se aprueba a pesar del defecto. El proveedor rechaza toda responsabilidad por daños directos o indirectos.

Si durante el período de garantía se debe realizar trabajos de mantenimiento y/o de servicio específicos del equipo y definidos por el proveedor, y si esos requerimientos deben ser satisfechos por el cliente (mantenimiento) o por el proveedor (servicio) y no se llevaran a cabo, toda reclamación por daños quedará anulada debido a la falta de cumplimiento de los requerimientos especificados.

No se tramitarán otro tipo de reclamaciones, en concreto las derivadas de los posibles daños resultantes.

De esta cláusula se excluyen los fungibles y daños provocados a causa de errores en el manejo, la instalación o el uso incorrecto.

Los instrumentos del fabricante son de fiabilidad probada en muchas aplicaciones y, por lo tanto, se utilizan con frecuencia en los bucles de control automático para proporcionar el funcionamiento más económico posible del proceso relacionado.

Para evitar o limitar daños resultantes, se recomienda diseñar el bucle de control de modo que un fallo en un instrumento de lugar a un cambio automático en el sistema de control de copia de seguridad, que es la condición de funcionamiento más segura para el entorno y para el proceso.


Apéndice A Guía de ayuda

La Guía de ayuda es un conjunto de instrucciones detalladas del DR 3900 para la ejecución de un procedimiento o programa almacenado de acuerdo con las especificaciones del proceso. La Guía de ayuda está disponible para los test de HACH LANGE más comunes y para los test de reactivos de powder pillow de Hach.


A.1 Visualización de la Guía de ayuda de los programas almacenados



1. Pulse **Programas almacenados** en el Menú Principal para visualizar una lista alfabética de los programas almacenados con números de programa. Seleccione el test adecuado y pulse **Inicio**.

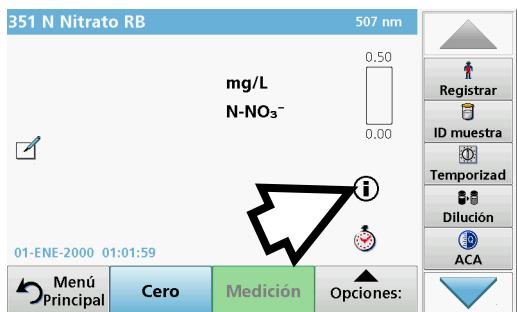

2. Pulse el ícono de información.

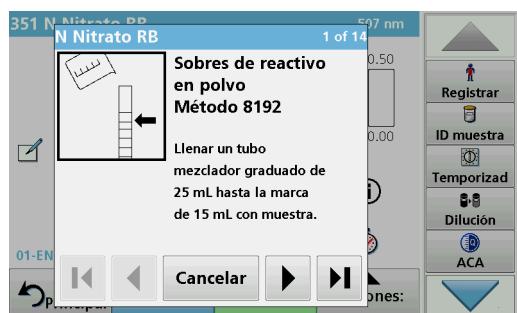


3. Aparecerá la primera fase de la metódica de acuerdo con el test o método seleccionado.

Nota: Utilice las teclas de flecha para navegar a las páginas anteriores o siguientes, o a la primera o última página.

4. Siga las descripciones detalladas que aparecen en la pantalla.




5. Si el método requiere un temporizador, pulse **Cancelar** y, a continuación, el ícono del temporizador.

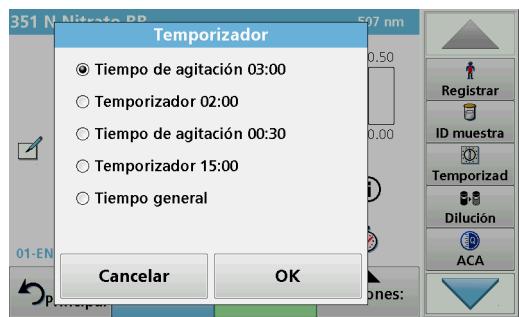


Aparecerá una lista de tiempos preestablecidos.

6. Seleccione el tiempo necesario.
7. Cuando finalice el temporizador, vuelva a la Guía de ayuda pulsando el ícono de información.
8. Se activará la siguiente pantalla de ayuda.
9. Pulse **Cancelar** para volver a la pantalla de medición del test o método.
10. Pulse el ícono de información para volver a la última página visitada de la Guía de ayuda y continuar con el test.


A.2 Visualización de la Guía de ayuda de los programas de códigos de barras

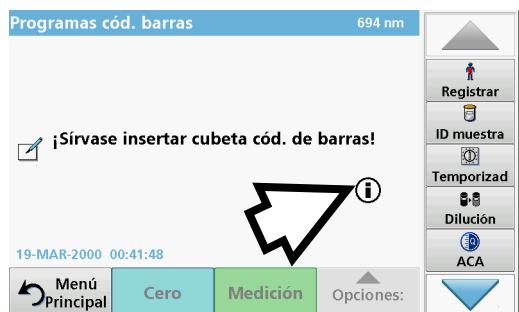

3. Pulse el ícono de información.

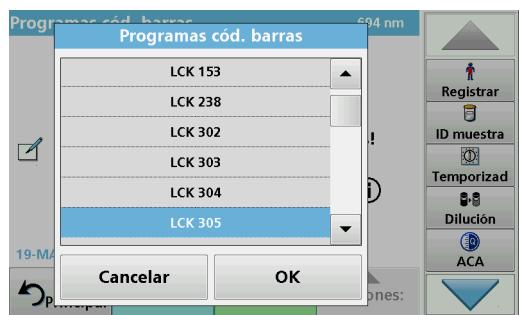


4. Se muestra la lista de pruebas de código de barra en orden numérico.
5. Seleccione la prueba correspondiente.

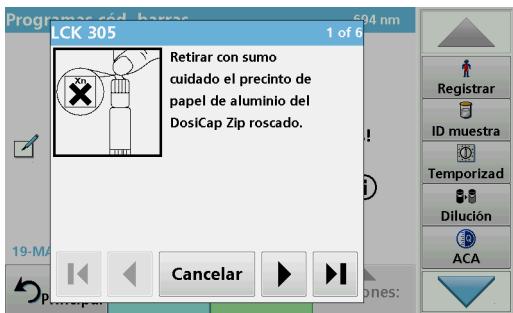

6. Prepare la prueba de código de barras según las especificaciones del proceso actual y siga las instrucciones paso a paso para el procedimiento.

Nota: Asegúrese de que se utilizan los valores del procedimiento actual.

Nota: Utilice las teclas de flecha para navegar a las páginas anteriores o siguientes, o a la primera o última página.

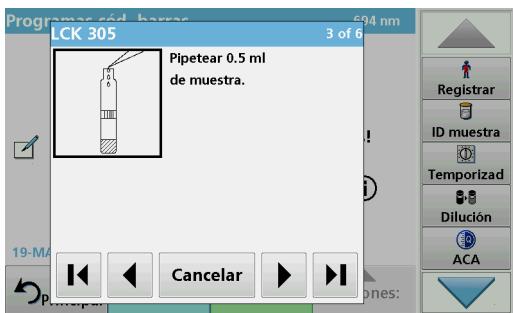

7. Pulse **Cancelar** para volver a la pantalla de medición del test.
8. Pulse el ícono de información para volver a la última página visitada de la Guía de ayuda y realizar el test.
9. Introduzca la cubeta cero o la cubeta de muestra (correspondiente al procedimiento) en el compartimento de cubetas.



La medición comienza automáticamente y aparecen los resultados.

Índice

A

- ACA 120
- Actualización 69, 70, 114
- Actualización de tests 64
- Actualización manual 64
- Adaptador de cubetas 19
- Adición de patrón 59, 95
- Ajuste del patrón 59, 61
- Ajustes de los filtros 45
- Ancho de banda espectral 9
- Asist. Tca. de fábrica 126

B

- Backup de instrumento 124, 125
- Barra de control 66
- Barra de herramientas 127
- Barrido de longitud de onda .. 26, 49, 50, 51, 104, 105, 106, 108
- Barrido de referencia 105, 109
- Blanco de la muestra 69
- Blanco de reactivo 59, 62, 68

C

- Calibración de longitud de onda 9
- Carpeta de datos 42
- Cinéticas en el tiempo .. 49, 50, 51, 110, 111, 112, 113
- Compartimento de cubetas (1) 18
- Compartimento de cubetas (2) 18
- Compartimento de cubetas reemplazable 134
- Comprobación de la absorbancia 119
- Comprobación de la deriva 126
- Comprobación de la luz difusa 118
- Comprobación de longitud de onda 118
- Comprobación del ruido 118
- Comunicación Ethernet 40
- Configuración de calibración 80
- Configuración de longitud de onda 111
- Configuración de red 40
- Configuración del instrumento 26, 27, 59, 68, 100, 102, 106, 111
- Configuración impresora 38
- Contraseña 32, 43
 - desactivación 35
- Controlador sc 129
- Cubetas 132
- Cubierta del compartimento de cubetas 16

D

- Datos 105
 - almacenamiento 43, 49
 - eliminación 43, 47, 49
 - enviando 111
 - enviar 45, 68
 - Programas almacenados 59
 - envío 43, 49
 - guardar 9, 43, 49
 - imprimir 39
 - recuperación 43, 49
- Datos básicos 58, 67
- Datos memorizados 44
- Desembalado del instrumento 15
- Diagnóstico de fallos 137
- Dirección IP 40

E

- Edición de tests 64
- Eliminación 11
- enviando 105
- Escala y Unidades 106, 107, 111, 112
- Especificaciones 9
- Espectro de longitud de onda 105
- Exactitud de longitud de onda 9
- Exactitud fotométrica 9

F

- Factor de concentración 100, 101, 102, 104
- Factor de dilución 59, 60, 68
- Favoritos 26, 65, 93, 94
 - borrado 94
 - edición 93
 - recuperación 94
- Fecha y hora 35
- Fórmula 70, 71
- Fórmula de absorbancia 102, 103
- Fórmula química 59, 61, 67, 68
- Fuente de alimentación de sobremesa 15
- Fuente de luz 9

G

- Garantía 143
- Gateway por defecto 41
- Guardar como programa del usuario .. 59, 68, 100, 102
- Guía de ayuda 145

Índice

I

ID de la muestra	29
creación	29
eliminación	31
ID del usuario	27
Idioma	23
Información de seguridad	11
Información del instrumento	114
Información general de producto/función	13
Información general del programa	26
Integral	105, 107
Interfaces	18, 37
Internet	74, 114

K

Kit de verificación	126
---------------------------	-----

L

Lamp, se refiere a VIS-Lamp	
Lámpara VIS	
Histórico de la lámpara	126
Limpieza	
Espectrofotómetro	131
Pantalla	131
Linealidad fotométrica	9
Link2SC	128
Lista de seguridad	32
Long. de onda múltiple	26, 78, 80, 101, 102, 103, 104
Longitud de onda	100, 102
Longitud de onda múltiple	102
Longitud de onda única	26, 77, 80, 99, 100
Luz difusa	9

M

Mantenimiento	131
Marcado	112
Máscara sub-red	41
Medición de cinética en el tiempo	112
Melodía de arranque	23
Menú Principal	26
Modo Cursor	105, 107
Modo de pantalla	9
Módulo RFID	12, 16

N

Nombre	70
Nombre del servidor	42

P

Pantalla	25, 131
Pantalla táctil	25
Pantalla y Sonido	36
PC e Impresora	38
PC e impresora	37, 39
Proceso de arranque	23
Proceso de medida	70, 71, 86
Programa de prueba	23
Programación	73, 76
Programación libre	86, 92, 93, 94
Programas almacenados	26, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68
Programas de código de barras	68
Programas de códigos de barras	26, 66, 67, 68, 69
Programas del usuario	9, 26, 75, 76
Protector de luz	20
Pruebas del sistema	26, 113, 118, 119, 124, 126
Pruebas ópticas	115, 118, 119, 126
Pruebas salida	126
Puerto Ethernet	18
Puerto USB de tipo A	16
Puerto USB de tipo B	17

R

Rango de longitud de onda	9, 106
Rango de medida fotométrico	9
Ratio	54
Reclamaciones	143
Recuperación de datos de mediciones	26
Recuperar datos	49, 59, 68, 100, 102, 106, 111
redes locales	40
Reproducibilidad de longitud de onda	9
Resolución de la concentración	100, 101, 102, 104
Resolución de longitud de onda	9
Responsabilidad	143

S

Secuencia de medición	86
Selección de longitud de onda	9
Seleccionar vista	107
Señales acústicas	36
Software	74, 114

T

Teclado alfanumérico	25
Temporizador	36, 59, 60, 68, 70, 72, 100, 102
Tiempo de servicio	126
Tiempo e Intervalo	111

Transcurso de tiempo	111	Ver tabla	111
V		Verificación del sistema	126
Variables	70, 71, 92	Verificaciones del sistema	23
Velocidad de barrido	9	Versión	70, 71

HACH COMPANY World Headquarters
P.O. Box 389, Loveland, CO 80539-0389 U.S.A.
Tel. (970) 669-3050
(800) 227-4224 (U.S.A. only)
Fax (970) 669-2932
orders@hach.com
www.hach.com

HACH LANGE GMBH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 2 11 52 88-320
Fax +49 (0) 2 11 52 88-210
info-de@hach.com
www.de.hach.com

HACH LANGE Sàrl
6, route de Compois
1222 Vésenaz
SWITZERLAND
Tel. +41 22 594 6400
Fax +41 22 594 6499

