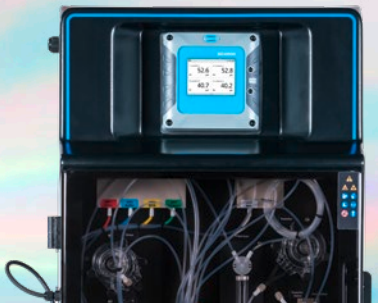

최소한의 노력으로 최대의 효과

업그레이드된 EZ sc 시리즈로 분석 수준 향상

비교:

EZ sc 대 EZ

신규





기능	EZ sc	EZ
간소화된 운영으로 효율성 향상 SC4500의 익숙한 인터페이스로 디자인 되어 사용자 교육을 최소화하고 기존 워크플로우에 통합됩니다.	✓	✗
사용자 친화적인 워크플로우 가이드 워크플로우는 매뉴얼에 대한 의존도를 줄여주므로 작업을 더 빠르게 완료하고 안전하고 정밀한 운영을 위한 사용자 맞춤형 접근 권한을 제공합니다.	✓	✗
향후 요구 사항에 맞게 조정 가능 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 샘플 범위에 적응할 수 있으며 필요에 따라 범위를 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.	✓	✗
더 높은 가동률을 위한 예측가능한 유지보수 시약 카운터와 비슷한 내장된 표시기를 통해 튜브, 소모품, 예비 부품 또는 기타 구성품을 교체해야 하는 시기를 알려줍니다. 분석기에는 조치가 필요한 시점을 알려주는 알람 기능이 있습니다.	✓	✗
고급 시스템을 통한 정밀 분석 고품질 시약 공급 시스템이 안정적인 시료 흐름을 보장하여 높은 정확도의 결과를 제공합니다.	✓	✓
서비스 보호 투자한 자산을 보호하고 안심 시켜주는 종합 서비스 플랜을 제공합니다.	✓	✓

신제품





	EZ sc	EZ
기술 사양		
희석 과정	표준 디스펜서(모든 유닛)	마이크로 펌프
치수(H x W x D)	691mm x 461mm x 311mm	691mm x 465mm x 330mm
필터를 위한 펌프	아니요(여과 패널에 펌프 통합)	예
아날로그 통신 출력	표준 4x 4-20mA, 8 x mA 출력 옵션	1,2,4,8 x 4-20 mA
디지털 통신 출력	Modbus (TCP/IP, RTU), PROFITNET, PROFIBUS DP, ETHERNET IP	Modbus(TCP/IP, RS485)
샘플 스트림 수	표준 1, 옵션 2,4,8	1,2,4,8
시약 교체		
시약 교체 일정	28일**	28일**
유지 관리 일정		
분석기 구성 요소 세척	설치 후 7일 후 30일 간격으로 업데이트	
튜빙 교체	90일 간격	
하드 튜빙 교체	필요에 따라	
마이크로 펌프 duckbills 교체	매년	
퓨즈 교체	필요에 따라	
디스펜서 밸브와 시린지 교체	매년	

*별도로 명시되지 않을 시